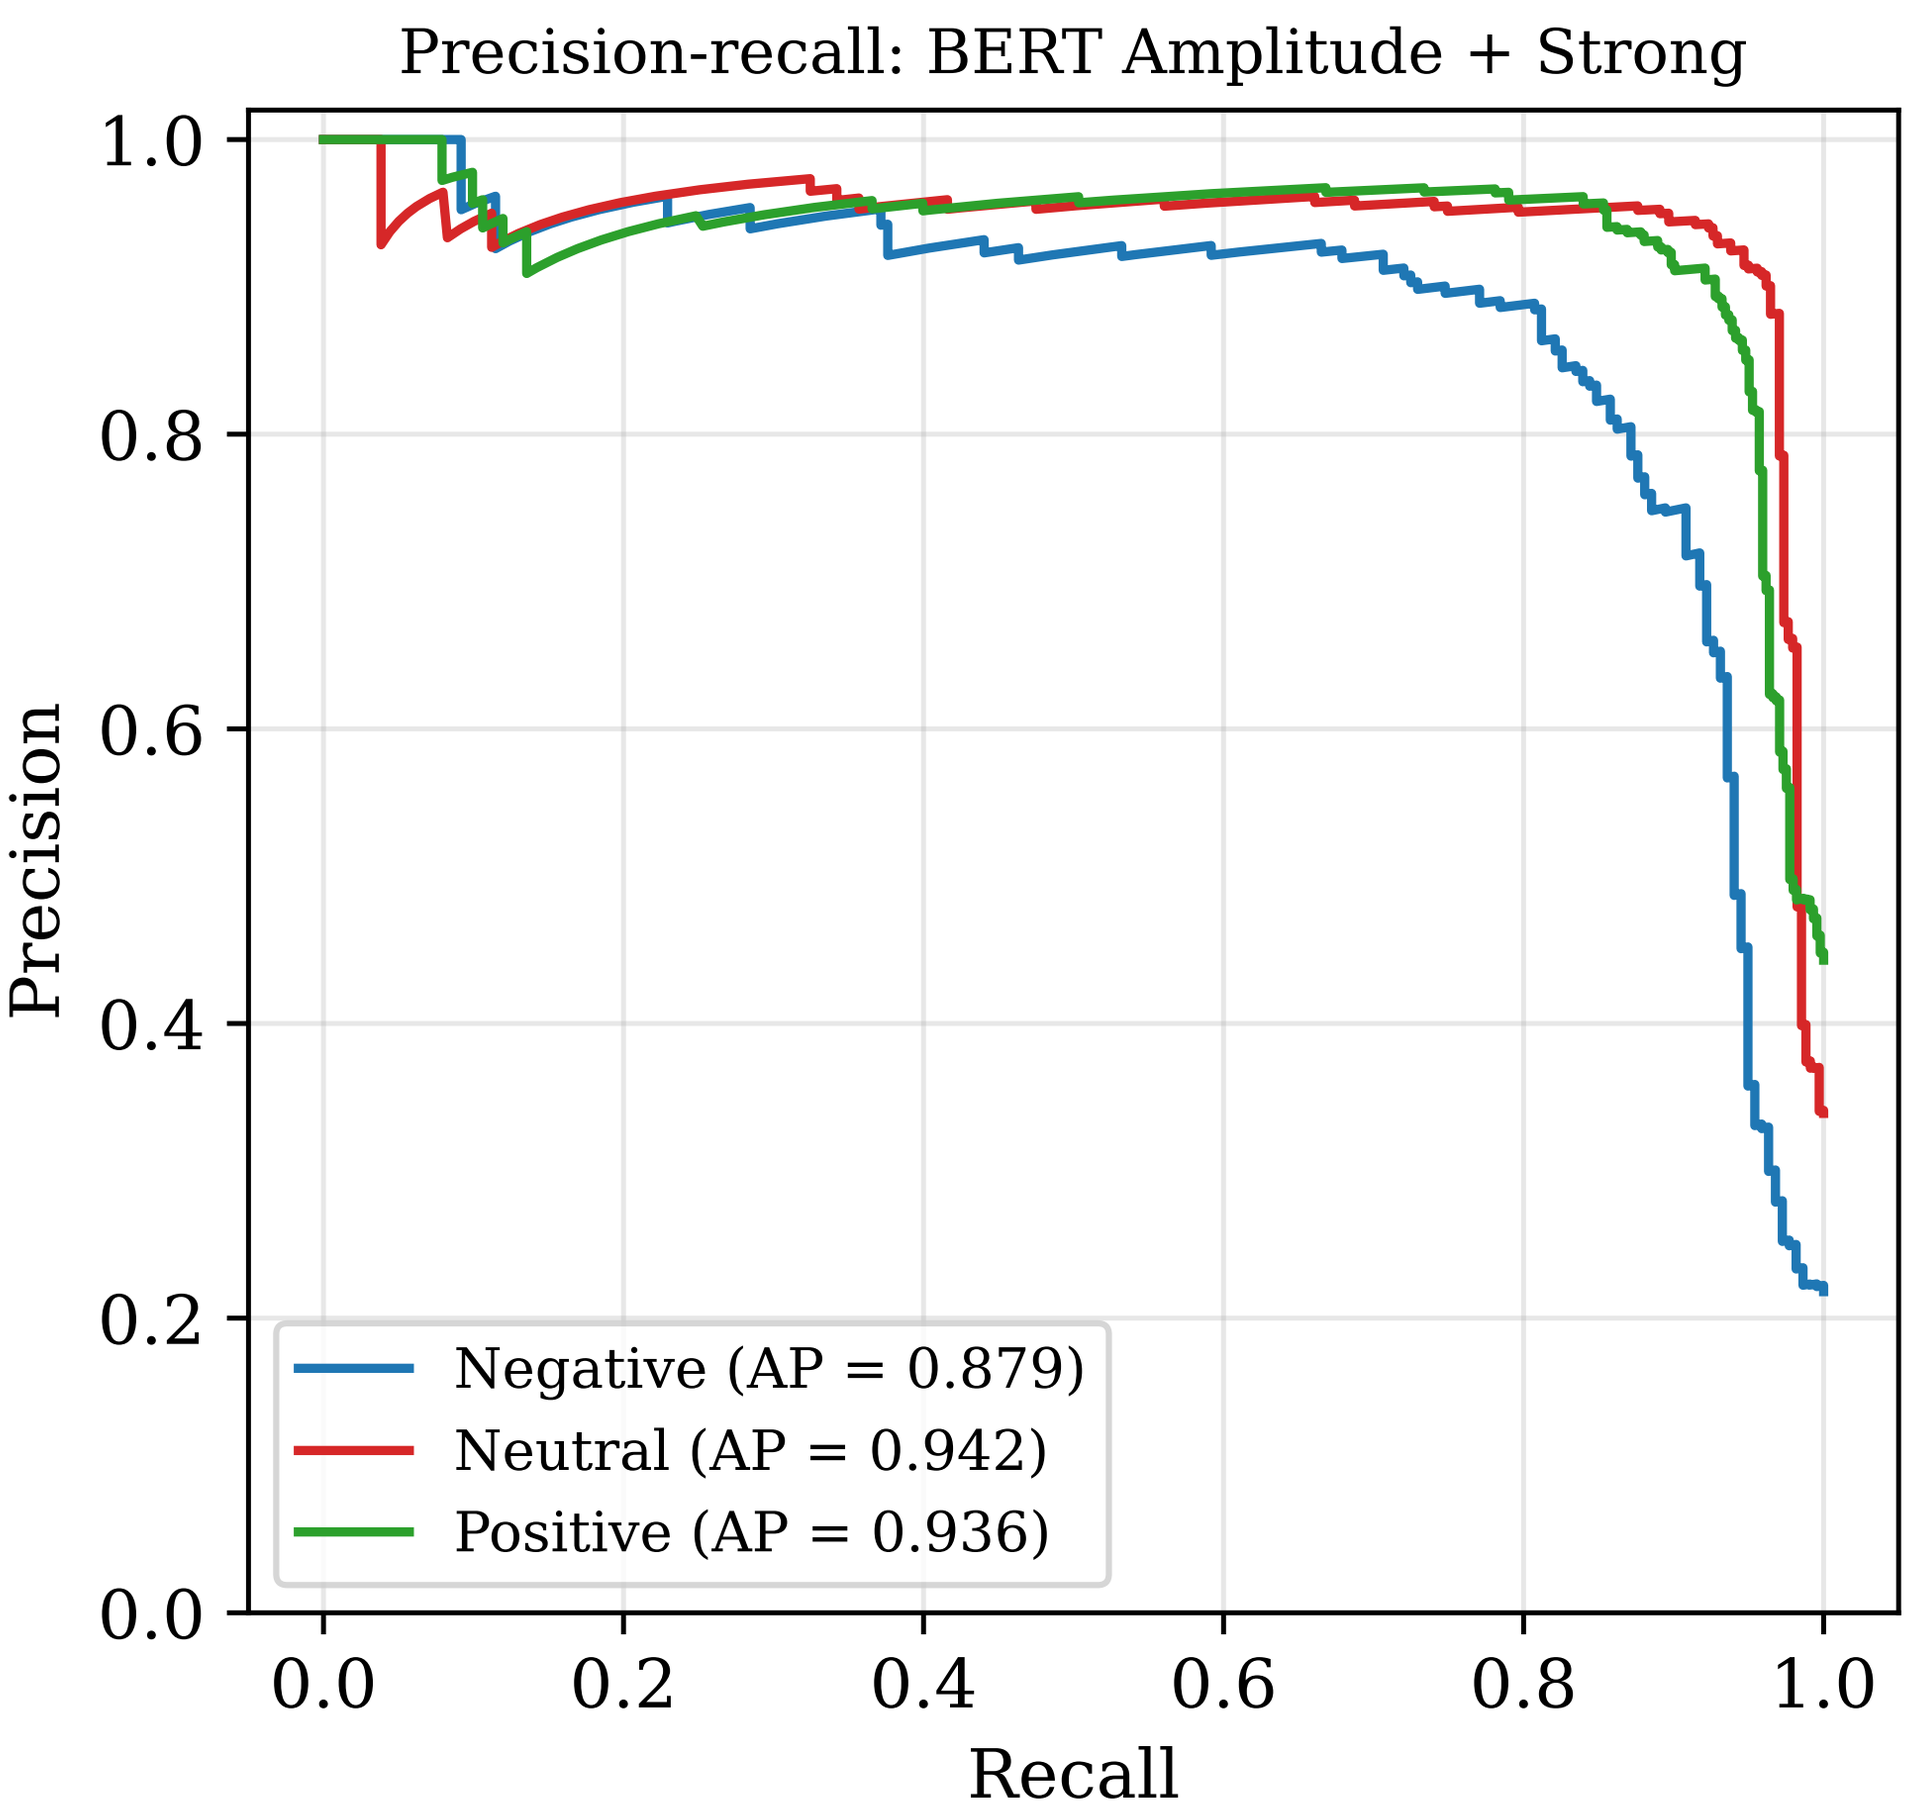
Precision-recall: BERT Amplitude + Strong
Precision
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Negative (AP = 0.879)
Neutral (AP = 0.942)
Positive (AP = 0.936)