

Vista la solicitud presentada por:

D./Dña. **MARIA DEL CARMEN PEREZ ROMERO**
Con DNI nº **48949300X**
y Titulación Académica: **TECNICA SUPERIOR**
IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO Y MEDICINA NUCLEAR


En aplicación de lo dispuesto en la Instrucción IS-17 del Consejo de Seguridad Nuclear de fecha 30 de enero de 2008 (B.O.E. 19 de Febrero de 2008), y de conformidad a lo establecido en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio (B.O.E. 18 de Julio de 2009), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en virtud de delegación de competencias del Pleno en la Presidenta por Acuerdo de 18 de marzo de 1998 (B.O.E. 14 de Mayo de 1998) ha resuelto en fecha 17 de Septiembre de 2025

**ACREDITAR AL SOLICITANTE PARA OPERAR,
BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN TITULADO DIRECTOR,
APARATOS DE RAYOS X CON FINES DIAGNÓSTICOS**

La presente acreditación se concede exclusivamente a efectos de protección radiológica, sin perjuicio de las titulaciones y requisitos que sean exigibles en cada caso en el orden profesional y por razón de las técnicas aplicadas.

El acreditado deberá seguir en sus actuaciones los procedimientos establecidos de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 del citado Real Decreto.

Madrid, 18 de Septiembre de 2025

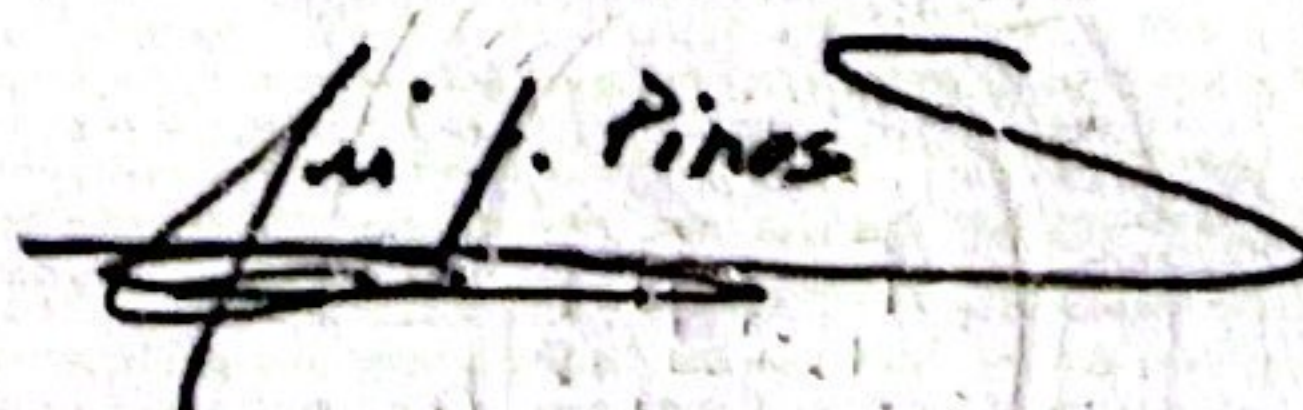

JEFA DE ÁREA DE LICENCIAS Y FORMACIÓN

María Jesús Pinos Cabezas