



Universidade de Brasília – UnB
Campus Gama – FGA
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

**COLETA SIMULTÂNEA DE ELETROENCEFALOGRAMA E
E RASTREAMENTO OCULAR: FERRAMENTA E ESTUDO DE CASO**

ANA PAULA SANDES DE SOUZA

Orientador: DR. GERARDO ANTONIO IDROBO PIZO



UNB – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

FGA – FACULDADE GAMA



Programa de
Pós-Graduação em
ENGENHARIA BIOMÉDICA

**COLETA SIMULTÂNEA DE ELETROENCEFALOGRAMA
E RASTREAMENTO OCULAR: FERRAMENTA E ESTUDO DE CASO**

ANA PAULA SANDES DE SOUZA

ORIENTADOR: DR. GERARDO ANTONIO IDROBO PIZO

**DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM
ENGENHARIA BIOMÉDICA**

PUBLICAÇÃO: 011A/2022

BRASÍLIA/DF, AGOSTO DE 2022

UNB – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

FGA – FACULDADE GAMA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

COLETA SIMULTÂNEA DE ELETROENCEFALOGRAMA

E RASTREAMENTO OCULAR: FERRAMENTA E ESTUDO DE CASO

ANA PAULA SANDES DE SOUZA

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO SUBMETIDA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA BIOMÉDICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, COMO PARTE DOS RE-
QUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM ENGENHARIA
BIOMÉDICA

APROVADA POR:

Dr. Gerardo Antonio Idrobo Pizo

(Orientador)

DR^a. Marília Miranda Forte Gomes

(Examinador interno)

Dr. Membro Externo

(Examinador externo)

FICHA CATALOGRÁFICA

SOUZA, ANA

Coleta Simultânea de Eletroencefalograma e Rastreamento Ocular: Ferramenta e Estudo de Caso [Distrito Federal], 2019.

43p., 210 × 297 mm (FGA/UnB Gama, Mestrado em Engenharia Biomédica, 2022).

Dissertação de Mestrado em Engenharia Biomédica, Faculdade UnB Gama, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica.

1. Neurociência Computacional

2. Eletroencefalograma

3. Rastreamento Ocular

4. Sincronização de Sinais

I. FGA UnB/UnB.

II. Título (série)

REFERÊNCIA

SOUZA, ANA (2022). Coleta Simultânea de Eletroencefalograma e Rastreamento Ocular: Ferramenta e Estudo de Caso. Dissertação de mestrado em engenharia biomédica, Publicação 011A/2022, Programa de Pós-Graduação, Faculdade UnB Gama, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 43p.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTOR: Ana Paula Sandes de Souza

TÍTULO: Coleta Simultânea de Eletroencefalograma e Rastreamento Ocular: Ferramenta e Estudo de Caso

GRAU: Mestre

ANO: 2022

É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta dissertação de mestrado e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação de mestrado pode ser reproduzida sem a autorização por escrito do autor.

anapaulasandes.s@gmail.com

Brasília, DF – Brasil

RESUMO

O eletroencefalograma (EEG) e o rastreamento ocular (ET, do inglês Eye Tracking) são formas não-invasivas de se observar o comportamento do sistema nervoso. Algoritmos classificatórios treinados com bases de dados compostas por mais de um tipo de dado fisiológico tendem a apresentar maior acurácia do que algoritmos treinados com datasets unimodais. Entretanto, o acesso a tais dados permanece restrito devido, dentre outros fatores, ao custo de equipamentos necessários para construção dos datasets. O presente estudo tem por objetivo propor uma ferramenta construída a partir de equipamentos comerciais capaz de gerar um dataset fisiológico de forma automatizada, constituído por dados de EEG e ET coletados de forma simultânea. A sincronização da ferramenta será analisada através da contagem da sobreposição de piscadas encontradas nos dados de ET e EEG, e um estudo de caso com aplicação do dataset no treinamento de algoritmos classificatórios será apresentado.

Palavras-chave: EEG; ET; Sincronização; Base de Dados Fisiológicos;

ABSTRACT

Electroencephalogram (EEG) and Eye Tracking (ET) are non-invasive methods of observing the nervous system behavior by monitoring neural activity and ocular positioning over time. They are important tools in the construction of physiological databases. Databases with more than one type of physiological data confer advantages in classification algorithms, presenting a greater accuracy than algorithms trained with unimodal datasets. However, access to these datasets is still restricted due to the equipment cost and synchronization complexity between different sensors. The present study aims to present a tool built from commercially available devices whose output is a multimodal dataset of EEG and ET collected simultaneously. The tool is expected to promote accessibility to multimodal datasets by generating a database from low-cost equipment (in comparison to clinical equipment) and encourage the development of different areas of research that can benefit from easier access to physiological data acquisition. The tool will be evaluated regarding its ability to synchronize EEG and ET, and the multimodal dataset will be evaluated in a case study with the participant being submitted to emotional stimuli to be classified by the trained algorithms in Orange software. The algorithms performance will be used to discuss about the tool applicability in future studies.

Keywords: EEG; ET; Synchronization; Physiological Dataset;

SUMÁRIO

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introdução | 1 |
| 1.1 | Contextualização de Problema | 1 |
| 1.2 | Objetivos | 2 |
| 1.2.1 | Objetivos Específicos | 2 |
| 1.3 | Justificativa | 3 |
| 1.4 | Organização do Documento | 3 |
| 2 | Eletricidade Cerebral | 5 |
| 2.1 | Correntes Elétricas e Neurônios | 5 |
| 2.2 | Eletroencefalograma | 7 |
| 2.3 | Ondas Cerebrais | 8 |
| 2.3.1 | Sistema Internacional 10/20 de Posicionamento de Eletrodos . . . | 8 |
| 2.3.2 | Tipos de Eletrodos para Captura de EEG | 9 |
| 3 | Rastreamento Ocular | 11 |
| 3.1 | Anatomia Ocular | 11 |
| 3.2 | Equipamentos de Rastreamento | 12 |
| 3.3 | Eletrooculograma | 12 |
| 4 | Datasets Fisiológicos | 13 |
| 4.1 | Aquisição de EEG e ET | 14 |
| 4.2 | Pré-processamento de EEG | 14 |
| 4.3 | A Fusão de Dados | 15 |
| 5 | Métodos de Construção e Uso de Datasets de EEG e ET | 16 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6 | Equipamentos Comerciais na Pesquisa | 19 |
| 6.1 | Considerações Finais | 19 |
| 7 | Sincronização | 20 |
| 7.1 | Sincronização com Timecode | 20 |
| 7.2 | Sincronização com Piscadas | 22 |
| 7.3 | Calcular a Sincronização | 23 |
| 8 | Materiais e Métodos | 25 |
| 8.1 | Construção da Ferramenta | 25 |
| 8.1.1 | Mindwave Mobile II | 25 |
| 8.1.2 | Gazepoint GP3 | 26 |
| 8.2 | Linguagens de Programação e Softwares | 27 |
| 8.2.1 | Orange | 28 |
| 8.2.2 | Python | 28 |
| 8.2.3 | MATLAB | 28 |
| 8.3 | Coleta dos Dados: Protocolo | 28 |
| 8.3.1 | Preparo de Coleta | 29 |
| 8.3.2 | Régressão Logística | 32 |
| 8.3.3 | Floresta Aleatória | 32 |
| 8.3.4 | Support Vector Machine - SVM | 33 |
| 8.3.5 | Rede Neural | 34 |
| 8.3.6 | Curva ROC | 34 |
| 8.3.7 | Matriz de Confusão | 34 |
| 9 | Resultados | 36 |
| 9.1 | Construção do Dataset | 36 |
| 9.2 | Sincronização | 36 |
| 10 | Discussão | 37 |
| 11 | Conclusão | 38 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Lista de Referências | 38 |
| Apêndice A | 40 |
| Apêndice B | 41 |
| Anexo A | 42 |
| Anexo B | 43 |

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

| | | |
|---|-------|----|
| 2.1 Tipos de Eletrodos para coleta de EEG (adaptado de Brain Support Inc. (2019)): | | 10 |
|---|-------|----|

LISTA DE FIGURAS

| | | |
|-----|---|----|
| 1.1 | Exemplo de um acelerador linear utilizado no Hospital Universitário de Brasília. | 2 |
| 2.1 | Anatomia de um neurônio com destaque para área de sinapse entre neurônios. Fonte: Bear (2015) | 6 |
| 2.2 | Esquema Modelo Hodgkin-Huxley. Dentro: indicando espaço intracelular; fora: indicando espaço extracelular (imagem a esquerda). Direita: C = capacitor, R = resistor, E = Baterias. Na = Sódio, K = Potássio Fonte: Neuromal Dynamcs (2014) | 6 |
| 2.3 | Impulsos nervosos conduzidos em neurônios | 7 |
| 4.1 | Número de datasets disponíveis publicamente para estudos de sono por tipo de sinal. Fonte: Rim et al. (2020). | 13 |
| 4.2 | Setup de coleta de EEG e ET. Fonte: Kastrati et al. (2021) | 14 |
| 4.3 | Exemplo de pipeline para processamento de EEG. Fonte: Neuroelectrics (2022) | 15 |
| 4.4 | Exemplo de Fluxo para Fusão de Dados de Sensores. Fonte: Mendes et al. (2016) | 15 |
| 5.1 | Design de Experimento para Coleta de EEG e ET. Fonte: Zheng et al. (2014) | 17 |
| 5.2 | Acurácia por Método de Fusão de Modalidade e Modalidade Única em Algoritmo Supervisionado. Fonte: Lu et. al. (2015) | 17 |
| 5.3 | União de dados de EEG e ET. Fonte: Thapaliya et al. (2019) | 18 |
| 7.1 | Dados de EEG, ET (eye gaze) e posição de cursor (cursor position) 2 segundos antes da resposta de um participante em atividades de um site de línguas. Fonte: Notaro et al. (2018). | 21 |
| 7.2 | Assinatura de piscada em microvolts. Fonte: Blinker (2022) | 23 |

| | | |
|------|---|----|
| 8.1 | Mindwave Mobile II (Neurosky) | 26 |
| 8.2 | GP3 (Gazepoint) | 27 |
| 8.3 | Exemplo do Opengaze conectado. Fonte: Sibley et al. (2017) | 29 |
| 8.4 | Montagem de Estudo de Caso da Ferramenta de Coleta EEG-ET. | 30 |
| 8.5 | Workflow Orange para Algoritmos de Classificação. (Orange, 2022). | 31 |
| 8.6 | Workflow Utilizado no Projeto para Validar o Dataset Gerado pela Ferramenta Proposta. | 32 |
| 8.7 | Régressão Logística | 32 |
| 8.8 | Floresta Aleatória | 33 |
| 8.9 | SVM Linear | 33 |
| 8.10 | SVM Linear | 34 |
| 8.11 | Matriz de Confusão | 35 |

LISTA DE NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES

1 INTRODUÇÃO

Existe uma importante vantagem advinda do uso de bases fisiológicas chamadas multimodais, ou constituídas de mais de um tipo de dado fisiológico em algoritmos supervisionados: a possibilidade de conferir um maior poder classificatório em relação aos datasets multimodais (Kang et al., 2020; Thapaliya et al., 2019). Sobre os benefícios já alcançados com estes datasets, é possível citar: melhora no diagnóstico de depressão e autismo (Kang et al., 2020; Thapaliya et al., 2019; Wu et al., 2021), maior poder de classificação de emoções (Guo et al., 2019; Zheng et al., 2019; Lu et al., 2015; Zheng et al., 2014), e uma maior compreensão da ativação de mecanismos nervosos durante atividades rotineiras, como leitura (Hollenstein et al., 2018). Um modelo específico de dataset multimodal é o constituído por eletroencefalograma (EEG) e rastreamento ocular (RO, ou Eye Tracking – ET), utilizado previamente em estudos de aprendizado supervisionado relacionados a integração cérebro-máquina, ou Brain Computer Interface – BCI (Xu et al., 2022; Kim et al., 2015; Lee et al., 2010).

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DE PROBLEMA

Apesar das vantagens, o acesso a bases de dados fisiológicos ainda é restrito por precisar de equipamento e experiência, reduzindo o desenvolvimento na área (Kastrati et al., 2021). No recente estudo sobre a análise conjunta de dados de EEG e ET por Dimigen e Ehinger (2020) foram levantados quatro principais problemas com este tipo de coleta (figura 1.1):

- Integração de dados
- A remoção de artefatos
- Controle de sobreposição temporal de respostas cerebrais
- Controle de influências de baixo-nível

Por ser uma coleta que envolve diferentes equipamentos, a integração dos dados pode se tornar um desafio. Diferentes autores propuseram soluções para tal integração. A

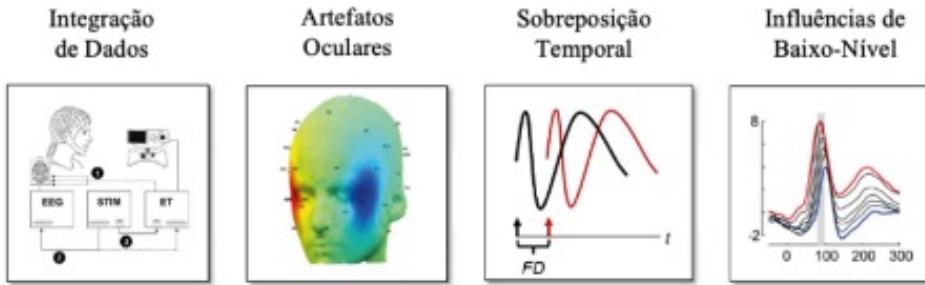


Figura 1.1. Principais problemas de integração em datasets de EEG e ET. Fonte: Dimigen e Ehinger (2020).

respeito do custo de equipamentos de coleta, o avanço de equipamentos comerciais tem possibilitado maior acesso à dados fisiológicos. Por exemplo, o Mindwave Mobile II (Neurosky, CA, Estados Unidos), é um exemplo de equipamento de baixo custo que captura EEG, além de também capturar outras métricas próprias do fabricante, como nível de atenção e meditação (Neurosky). O GP3 (Gazepoint, BC, Estados Unidos), por sua vez, é um equipamento comercialmente disponível que captura dados de rastreamento ocular, incluindo dilatação da pupila e direção de foco.

Com o propósito de desenvolver uma ferramenta de baixo custo que possa facilitar o acesso a bases de dados multimodais, o presente projeto tem por objetivo a integração dos dados coletados por estes dois equipamentos – Mindwave Mobile II e GP3. O output da ferramenta será analisado a respeito de sua capacidade de sincronização a partir dos dados de piscadas identificados em ambos os equipamentos. Acredita-se que a ferramenta proposta se apresente como uma alternativa para os equipamentos de coleta de alto custo por ser feita com equipamentos disponíveis comercialmente, e que também apresente uma oportunidade para construção de bases de dados multimodais de EEG e ET, incentivando o contínuo desenvolvimento em áreas que se beneficiem deste tipo de dataset, como BCI e diagnósticos de condições neurológicas.

1.2 OBJETIVOS

Criação de uma ferramenta para construção de datasets fisiológicos multimodais de EEG e ET.

1.2.1 Objetivos Específicos

- Criação de um código integrativo para equipamento de coleta de EEG e ET de forma simultânea;
- Criação de um dataset de EEG e ET;

- A● Avaliação da capacidade de sincronização dos dados multimodais pela ferramenta através da análise de sobreposição de piscadas identificadas em ambos os equipamentos;

1.3 JUSTIFICATIVA

A capacidade de coletar dados fisiológicos de forma simplificada e de baixo custo pode ser um motivador para desenvolvimento de diferentes áreas em destaque na atualidade, tais como integração homem-máquina, desenvolvimento de algoritmos e automatização de processos. Outro importante fator é a diminuição da necessidade de deslocamento do participante até centros de coleta, possibilitando uma maior diversidade na população em análise (Brand et al., 2020).

De forma geral, os benefícios da solução se concentram em:

- Aumento da acessibilidade à estação de coleta, tanto por participantes quanto por pesquisadores;
- Aumento da volumetria de dados;
- Maior disponibilidade de bases de dados fisiológicos para incentivar o desenvolvimento de outras frentes de estudo;

1.4 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O presente texto tem nove capítulos. O primeiro capítulo trata da contextualização do problema, objetivos gerais e específicos, e a justificativa para a abordagem selecionada.

O segundo capítulo trata das características da eletricidade cerebral, dando base para entendimento do que é o sinal de onda cerebral.

O terceiro capítulo trata do Rastreamento ocular, com os principais tipos de equipamento e abordagem de eletrooculograma.

O quarto capítulo aborda a acessibilidade à datasets fisiológicos e geração de bases.

O quinto capítulo trata do uso do dataset multimodal em algoritmos classificatórios.

O sexto capítulo aborda a questão da sincronização de dados de múltiplos sensores.

O sétimo capítulo aborda os materiais e métodos para construção da ferramenta e estudo de caso.

O oitavo capítulo aborda os resultados e discussões.

O nono capítulo apresenta a conclusão deste estudo.

2 ELETRICIDADE CEREBRAL

O presente capítulo apresenta uma introdução aos princípios de eletricidade cerebral, o que são ondas cerebrais e como é registrado o EEG.

2.1 CORRENTES ELÉTRICAS E NEURÔNIOS

A diferença de potencial elétrico (se referindo a energia necessária para deslocar uma carga elétrica (Matias e Fratezzi, 2008)) entre um material condutor gera um fluxo de cargas nomeado corrente elétrica (Creder, 1989). A intensidade deste fluxo é medida em ampère, e determinada pela quantidade de elementos carregados que atravessam o material condutor. As correntes (este fluxo), podem ser contínuos ou alternados, dependendo se o sentido da corrente varia ou não; sendo a corrente contínua composta por polos, e a alternada por fases (Bhargava e Kulshreshtha, 1983). O cálculo de corrente elétrica é dado pela seguinte equação:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta T}, \quad (2.1)$$

onde ΔQ é a quantidade de partículas que passam em um seguimento do condutor e ΔT indica o tempo.

Os neurônios são células responsáveis pela condução dos chamados “impulsos nervosos”, e se comportam como um “cabo eletrificado”, que é uma analogia a respeito da condução de impulsos elétricos por estas células, como apresentado no clássico estudo de Hodgkin e Huxley (1952). Os neurônios comunicam-se através de sinapses, locais onde ocorrem a transmissão destas correntes elétricas; e podem ser divididos anatomicamente em três partes: corpo celular, axônio e dendritos, apresentados na figura 2.1. A membrana celular é uma membrana semi-permeável que permite a passagem de cargas elétricas através de canais. A diferença entre a concentração destas cargas separadas pela membrana resulta em uma atuação de capacitor. Capacitores são dispositivos de polaridades diferentes em suas extremidades, capazes de armazenar cargas elétricas (Serway, 2008). Em função desta característica de separação de diferentes densidades de cargas elétricas, a membrana pode ter sua capacidade calculada pela equação 2.2

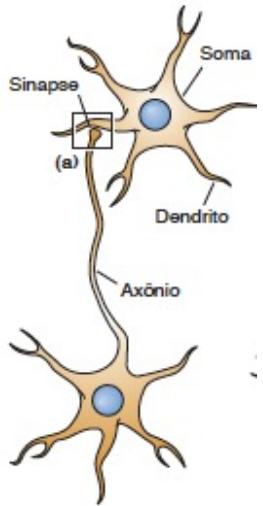


Figura 2.1. Anatomia de um neurônio com destaque para área de sinapse entre neurônios. Fonte: Bear (2015)

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \quad (2.2)$$

onde C é a capacidade, Q é a quantidade de carga armazenada e ΔV é a tensão elétrica, medida em farad (F).

A resistência elétrica é outra propriedade de interesse, e se refere a capacidade de se opor a passagem de uma corrente elétrica. Esta capacidade é medida em ohms, e os canais de membrana podem se comportar como resistores a depender das condições celulares e das condições de canal, visto que estes podem estar abertos (facilitando passagem), ou não. Estes diferentes comportamentos dos componentes neuronais podem ser observados na figura 2.2.

$$C \frac{du}{dt} = - \sum_k I_k(t) + I(t), \quad (2.3)$$

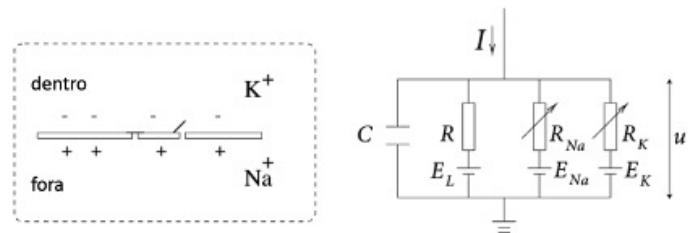


Figura 2.2. Esquema Modelo Hodgkin-Huxley. Dentro: indicando espaço intracelular; fora: indicando espaço extracelular (imagem a esquerda). Direita: C = capacitor, R = resistor, E = baterias. Na = Sódio, K = Potássio. Fonte: Neuromal Dynamcs (2014)

onde u = voltagem ao longo da membrana e t = tempo.

2.2 ELETROENCEFALOGRAAMA

Os impulsos nervosos gerados pelos neurônios são alterações no potencial elétrico de suas membranas. Este sinal elétrico ocorre quando um estímulo recebido pelo neurônio é intenso o suficiente para ultrapassar seu chamado limiar de ativação. O conjunto de impulsos nervosos por grupos de neurônios ao longo do tempo gera campos magnéticos que podem ser captados por eletrodos colocados sobre a cabeça humana (Kandel, 2000). Estes campos magnéticos foram primeiro registrados em humanos pelo psiquiatra Hans Berger (Ince et al., 2021), em uma coleta representada na figura 2.4. Estes registros são o resultado de potenciais de ação emitidos por células nervosas próximas ao eletrodo, e permitem uma boa resolução temporal – embora não apresentem uma boa resolução espacial - do comportamento neuronal.

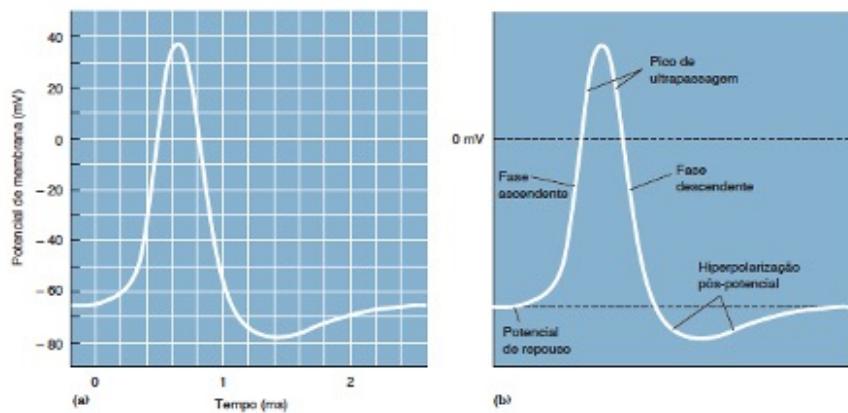


Figura 2.3. Resumo do potencial de ação. Fonte: Bear (2015).

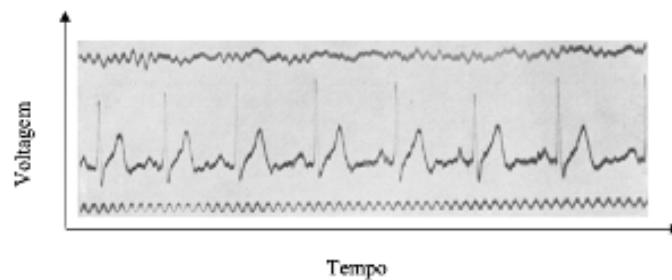


Figura 2.4. Primeiro EEG registrado em humanos, resultado do trabalho do psiquiatra Hans Berger. Fonte: Ince et al. (2021).

2.3 ONDAS CEREBRAIS

O cérebro é capaz de gerar ondas de impulsos nervosos ritmadas. A oscilação de um único neurônio pode ser explorada na figura 2.5. As grandes oscilações são detectadas pelos eletrodos (Llinas, 2014), e classificadas de acordo com suas características. Um exemplo de agrupamento de ondas cerebrais pode ser observado na figura 2.6.

As ondas cerebrais são caracterizadas pela **frequência, amplitude e fase** (figura 2.5). A amplitude mede a magnitude da oscilação de uma onda e pode ser representada pela equação

$$y = A * \text{sen}(t - k) + b, \quad (2.4)$$

onde y é a função de onda (mede amplitude no instante t), A é a amplitude da onda, sen representa uma função senoidal, t é o tempo, k é a transalação temporal e b mede a translação de onda.

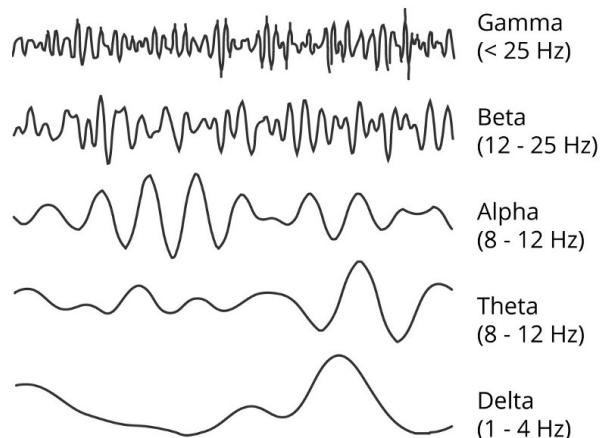


Figura 2.5. Ondas gamma, beta, alfa, teta e delta.

2.3.1 Sistema Internacional 10/20 de Posicionamento de Eletrodos

Para garantir uma padronização a respeito da coleta de EEG, o sistema de posicionamento de eletrodos pode ser adotado. Em específico, sistema internacional de posicionamentos de eletrodos para a coleta de EEG – o sistema 10/20, é uma técnica desenvolvida por Klem et al. (1999) e amplamente adotada em estudos neurocientíficos.

O registro capturado nos eletrodos advém de uma diferença de potencial elétrico. Esta diferença pode ser em referência à um eletrodo colocado em uma região externa ao crânio (como orelha), ou à uma voltagem média comum (Tavares, 2011).

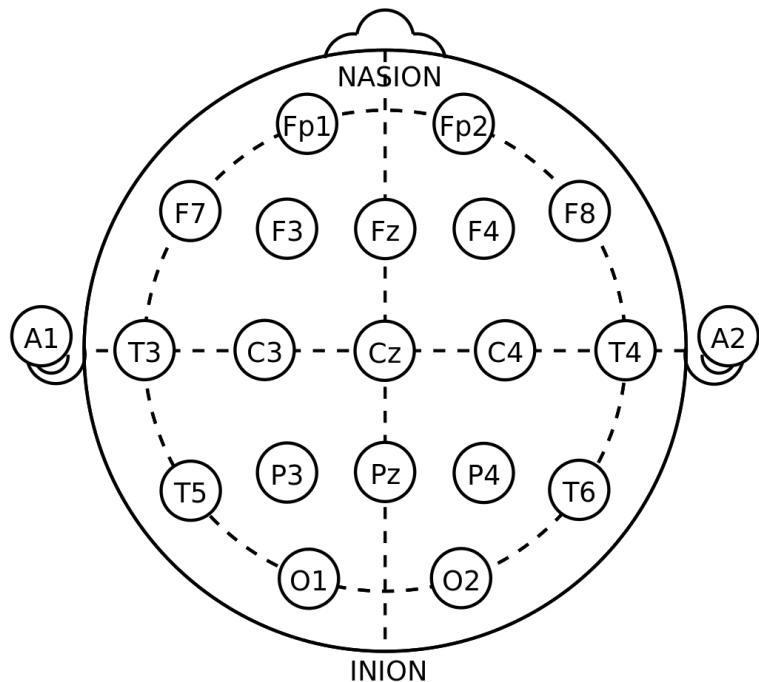


Figura 2.6. Sistema Internacional 10/20 de Posicionamento de Eletrodos. Em destaque: Posição do eletrodo de coleta passiva do MindWave Mobile 2. A = Ear lobe, AF = anterior frontal, C = central, CP = centroparietal, F = frontal, FC = frontocentral, FT = frontotemporal, N = nasion, O = occipital, P = parietal, PO = parietooccipital, T = temporal.

Klem et al. (1999).

2.3.2 Tipos de Eletrodos para Captura de EEG

Existem diferentes tipos de eletrodos para a captura de EEG, e uma descrição deles pode ser encontrada no quadro 2.1. Cada tipo de equipamento de coleta irá ter seu tipo de eletrodo. No caso de equipamentos de coleta de EEG comerciais, é comum a presença do eletrodo do tipo seco – que requer menos preparo, dispensando a aplicação de gel (Brain Support Inc., 2019). É notável também que com o desenvolvimento da capacidade computacional, novos recursos e métodos para a análise destes dados vem sendo benéficos à construção do conhecimento científico, agora também contando com o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, aprendizado profundo e inteligência artificial.

Quadro 2.1. Tipos de Eletrodos para coleta de EEG (adaptado de Brain Support Inc. (2019)):

| Tipo de Eletrodo | Descrição |
|------------------|--|
| Passivo | Geralmente feitos de prata, contam com a aplicação de gel condutor para reduzir a perda de informação antes de serem colocados na cabeça do participante. |
| Ativo | Geralmente feitos em prata, permitem o registro de variações de voltagem com redução de ruído do ambiente através de um circuito integrado aos eletrodos, com conversores de impedância. |
| Seco | Não necessita da aplicação de gel para melhora da coleta do sinal. |

Fonte: Brain Support Inc. (2019).

3 RASTREAMENTO OCULAR

3.1 ANATOMIA OCULAR

O globo ocular é majoritariamente opaco, com exceção da córnea, que é transparente. A pupila é a região que da passagem para a luz e possui diâmetro variável. Os músculos da íris são os que controlam a dilatação da pupila. A focalização da imagem deve se concentrar na fóvea, onde se encontram células muito sensíveis a luz (Helene e Helene, 2011). A fixação ocular compreende a um período de cerca de 100 milissegundos onde o olhar se fixa em um ponto de convergência (Barreto et al., 2012). Este período se encerra com o movimento de sacada, que compreende ao movimento rápido até uma nova fixação do olhar em outro local. Através da coleta do posicionamento ocular, é possível calcular uma taxa de dispersão focal ao longo do tempo e piscadas. Estes dados foram previamente correlacionados com estados emocionais (Soleymani et al., 2012) e também aplicados em estudos com algoritmos de aprendizado de máquina e *deep learning*.

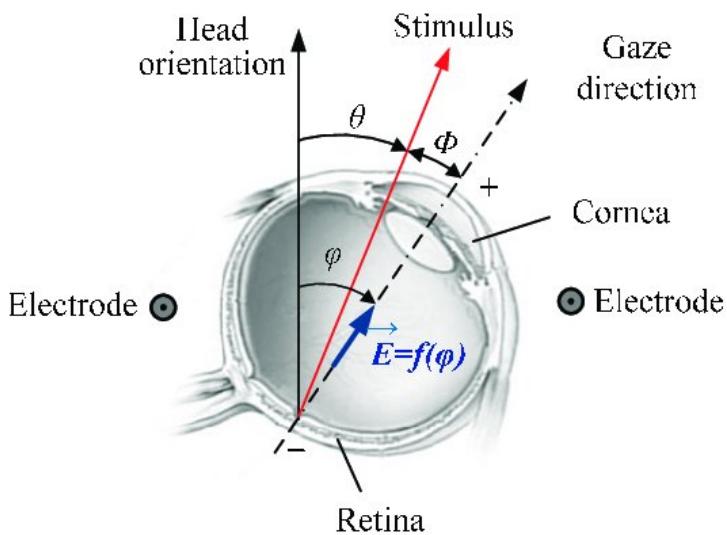


Figura 3.1. Representação de polaridades no olho humano. Fonte: López et al. (2019)

3.2 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO

Para detectar onde o participante está focando seu olhar ao longo do tempo, alguns equipamentos de ET fazem uso de luz infravermelha e câmeras de alta definição que projetam a luz diretamente no olho do participante e gravam a direção do olhar a partir do reflexo. Como a luz infravermelha abrange um comprimento de onda não detectável pelo olho humano, o direcionamento desta luz no olho não interfere visão do participante. O cálculo do direcionamento ocular é feito com base em algoritmos próprios de cada fabricante. Existem alguns tipos de equipamentos de rastreamento ocular. São eles: (1) Webcam, (2) Vestível (Wearable) e (3) Baseados em Tela. Webcam diz respeito a equipamentos não especializados para o uso de rastreamento; usáveis correspondem a equipamentos como óculos de rastreamento ocular e realidade virtual, e os baseados em tela dizem respeito aos equipamentos de coleta especializada que podem ser acoplados a um computador (Tobii, 2020).

3.3 ELETROOCULOGRAMA

Também é possível detectar a movimentação ocular através de registros elétricos no exame de EEG. Isto ocorre devido às características elétricas do olho, que se comporta como um dipolo (possui duas cargas diferentes separadas), com a córnea sendo o polo positivo a retina o negativo (López et al., 2019). Isto faz com que seja possível capturar a movimentação ocular ao colocar os eletrodos próximos aos olhos, como na figura 2.6. É possível observar picos de voltagem positiva identificados por eletrodos colocados na posição vertical e picos negativos e positivos identificados por eletrodos na posição horizontal, acompanhando movimentos de sacada do participante.

A diferença de potencial entre regiões é chamado de *stading potential*, que mede a diferença entre o potencial de membrana da base e topo do epitélio de pigmento da retina (Ramkumar et al., 2022).

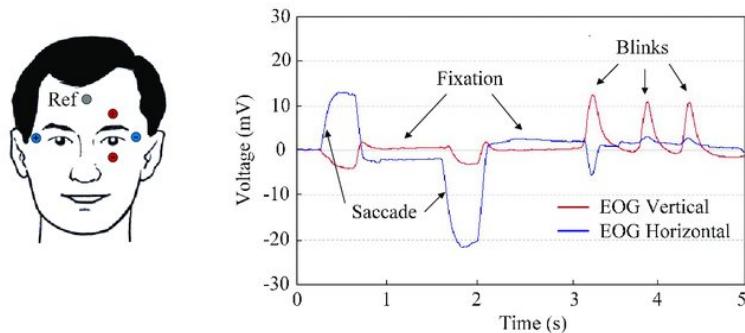


Figura 3.2. Representação de polaridades no olho humano. Fonte: López et al. (2019)

4 DATASETS FISIOLÓGICOS

Apesar da existência de fontes de datasets fisiológicos públicos, o número de datasets disponíveis ainda é restrito. Sobre a qualidade das bases de dados, Mendoza et al. (2021) observou que nenhum de nove datasets disponíveis publicamente para treinamento de algoritmos de classificação analisados possuía todos os critérios de referência levantados por estudos anteriores, embora ainda mantivessem seu valor para incentivar desenvolvimentos futuros. Sobre a disponibilidade de datasets fisiológicos, Rim et al. (2020) fez uma análise de datasets públicos e privados. No exemplo apresentado, é possível observar que datasets públicos combinando sinais são minoria nas diferentes fontes de dados analisadas (figura 4.1).

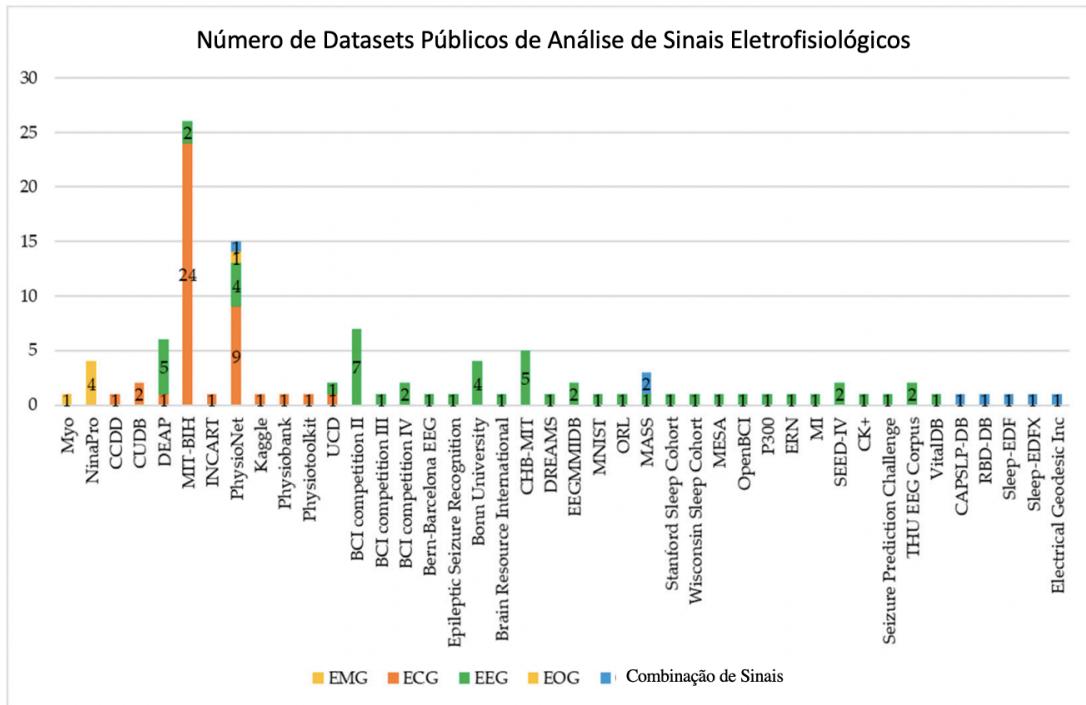


Figura 4.1. Número de datasets disponíveis publicamente para estudos de sono por tipo de sinal. Fonte: Rim et al. (2020).

4.1 AQUISIÇÃO DE EEG E ET

Um exemplo de como se realizar a montagem para coleta de EEG e ET é demonstrado na figura 4.2, utilizado na montagem do dataset EEGEyeNet (Kastrati et al., 2021), onde o participante é colocado de frente para o monitor para apresentação de estímulos com o equipamento de coleta de EEG sobre a cabeça e o aparelho de ET direcionado aos olhos.

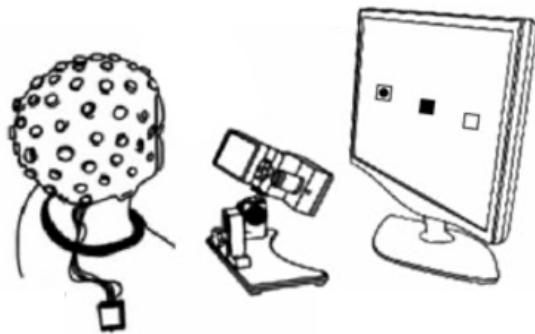


Figura 4.2. Setup de coleta de EEG e ET. Fonte: Kastrati et al. (2021)

4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DE EEG

O pré-processamento de EEG consiste em remoção de artefatos, tais como contração muscular e movimentação ocular. A etapa de extração de características consiste em, partindo dos dados com remoção de artefatos indesejáveis, extrair métricas estatísticas, como média, mediana e desvio padrão aplicados a uma janela de tempo, ou outras métricas, como entropia de Shannon (como feito no estudo de Thapaliya et al. (2019)). A seleção de features pode envolver o uso de algoritmos que permitem reduzir o número de características a serem apresentadas como input ao algoritmo, como o *Principal Component Analysis* (PCA). Um exemplo de pipeline é apresentado na figura 4.3. A partir dessas etapas, os dados são divididos entre treinamento e teste, para validar o algoritmo ou algoritmos a serem estudados.

O pré-processamento será diferente dependendo se a fonte de dados é de *single electrode* (somente um eletrodo) ou não, e do que é o sinal de interesse. Comumente não são estudados sinais acima de 90Hz (Neuroelectrics, 2022), de forma que um filtro pode ser aplicado para remover frequências que não forem de interesse. Também é comum dividir o sinal em épocas temporais de alguns segundos de duração, para extrair componentes destas janelas e construir a fase de extração de características. Esse processo acontece anteriormente a se inputar os dados a um modelo algorítmico.

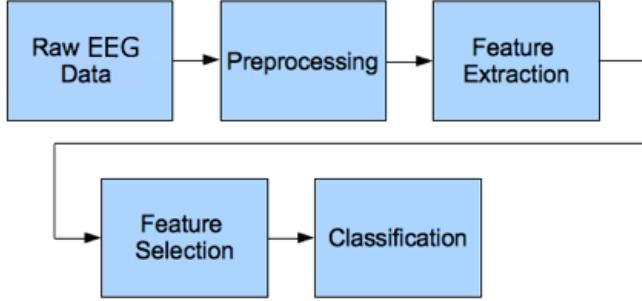


Figura 4.3. Exemplo de pipeline para processamento de EEG. Fonte: Neuroelectronics (2022)

4.3 A FUSÃO DE DADOS

A fusão ou união de dados advindos de diferentes sensores pode ser realizada no nível de característica ou *feature*, assim como o nível de decisão do algoritmo classificatório (Klein, 2014; Mendes et al., 2016). Na figura 4.4. é possível observar um fluxo de processamento dos sinais capturados por diferentes sensores. Os diferentes sensores representados no estudo de Mendes et al. (2016) são aqui representados pela coleta de EEG e ET.

Na **Feature Level Fusion** (FLF), os dados de diversas fontes são extraídos dos sensores e unidos de forma a gerar um vetor único com informações multimodais; no **Decision Fusion** (DF) a classificação ocorre para cada categoria de fonte de dado (exemplo: uma classificação para EEG e outra para ET) e estas classificações são combinadas em um esquema de voto (exemplo: a classificação mais comum) para se chegar em uma categoria final (Bota et al., 2020). A respeito de qual formato seria melhor, Bota et al. (2020) observou que o melhor método de fusão é altamente correlacionado à base dados, embora o FLF tenha sido escolhido como o melhor em função de sua baixa complexidade em relação ao DF.

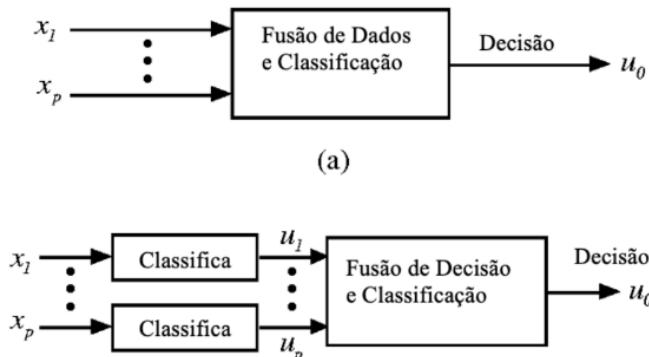


Figura 4.4. Exemplo de Fluxo para Fusão de Dados de Sensores. Fonte: Mendes et al. (2016)

5 MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO E USO DE DATASETS DE EEG E ET

Lu et al. (2015) faz uso de dados de EEG e ET para classificação de emoções nas três valências emocionais eleitas no estudo de Zheng et al. (2014). Em contraste com o volume de informações coletadas no estudo de Zheng et al., Lu et al. coletam uma maior quantidade de dados de rastreamento ocular – extraiendo 16 métricas de ET, enquanto o estudo de Zheng foca em apenas métricas principais da dilatação ocular. Os resultados da acurácia do algoritmo aplicado aos diferentes métodos de fusão de dados multimodais estão resumidos na imagem 5.2, ficando evidente que, independente do método utilizado para fusão das modalidades de EEG e ET, as melhores acurárias foram encontradas para base de dados de mais de uma fonte de informação fisiológica.

No trabalho de Thapaliya et al. (2019) dados de EEG e ET foram aplicados em algoritmos de máquina, com o objetivo de estudar uma melhora no método de diagnóstico de crianças com autismo através de diferentes formas de pré-processamento (exemplo de processamento do estudo na figura 5.3). Os dados de EEG tiveram suas métricas estatísticas coletadas para a construção de um vetor de características (incluindo desvio padrão e média por janela de tempo dos dados de EEG filtrados), assim como a entropia calculada por janela temporal. Para os dados de ET, os tempos de fixação foram coletados, em conjunto com o resultado de testes cognitivos. Em seu estudo, diferentes métodos de construção de vetores de características foram analisados, tanto para os dados unimodais quanto para a junção de EEG e ET.

Através das acurárias apresentadas para os diferentes métodos de processamento, é possível observar que determinados algoritmos aumentaram sua acurácia a depender do modo no qual o vetor de características foi construído. Por exemplo, enquanto o algoritmo Support Vector Machine (SVM) atingiu **71%** de acurácia com o vetor que incluiu Entropia para as janelas de EEG e PCA, a regressão logística com maior acurácia foi atingida com o dataset de desvio padrão de EEG e dados de rastreamento ocular sem a aplicação de PCA (Thapaliya et al., 2019).

Lim e Chia (2015), estudaram a correlação de ondas EEG detectadas em um equipamento de eletrodo único e estresse cognitivo induzido pelo teste de Stroop. A análise

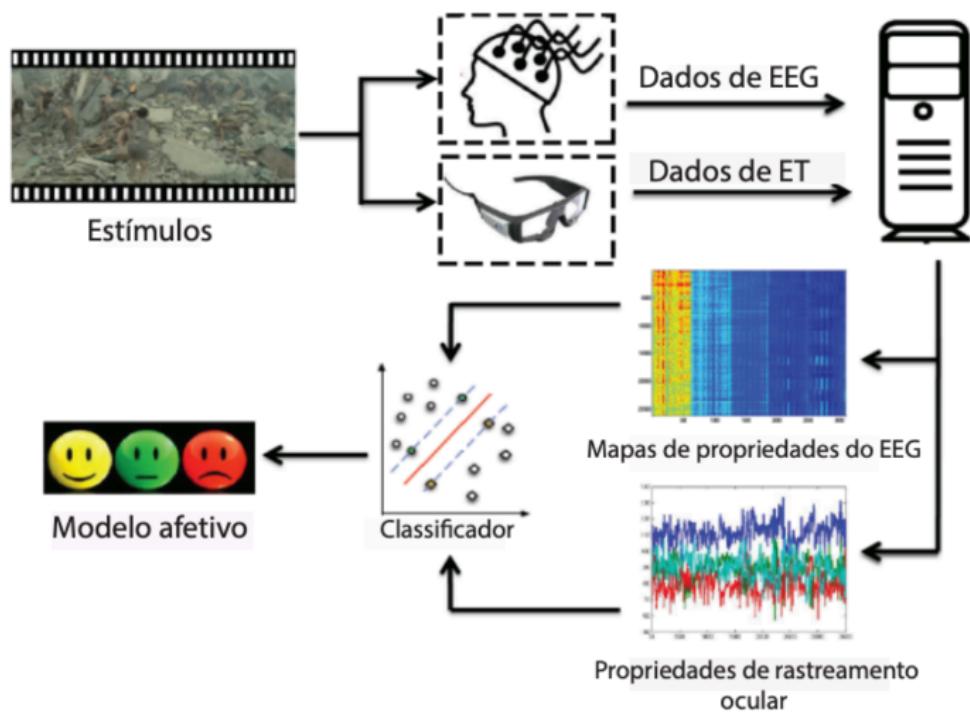


Figura 5.1. Design de Experimento para Coleta de EEG e ET. Fonte: Zheng et al. (2014)

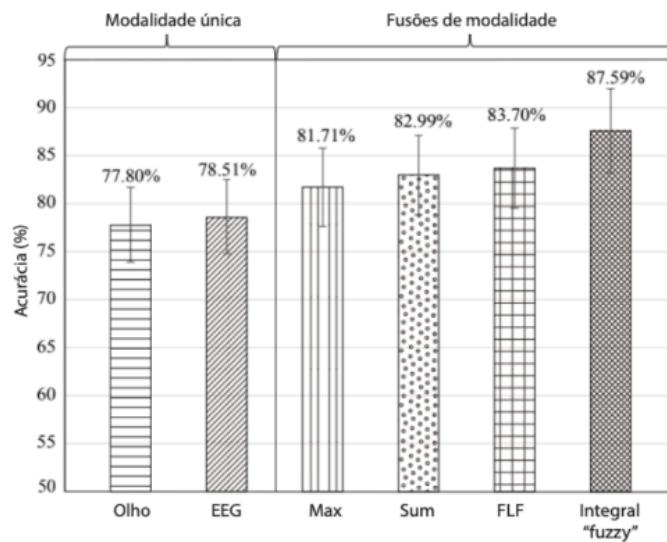


Figura 5.2. Acurácia por Método de Fusão de Modalidade e Modalidade Única em Algoritmo Supervisionado. Fonte: Lu et. al. (2015)

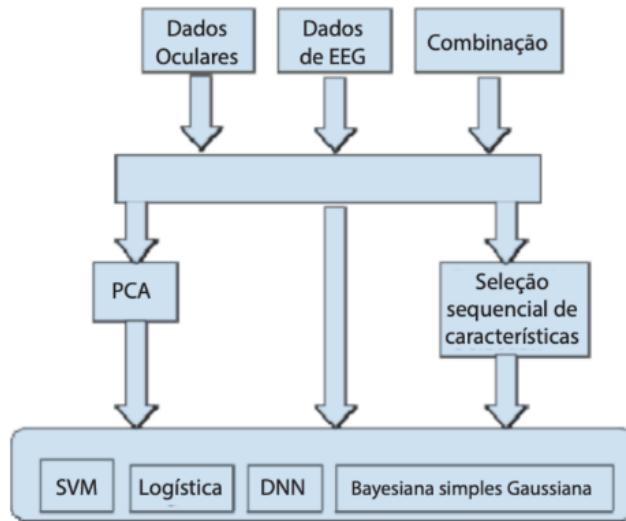


Figura 5.3. União de dados de EEG e ET. Fonte: Thapaliya et al. (2019)

foi feita com base na aplicação de três algoritmos: *Artificial Neural Network*, *k-Nearest Neighboor* (KNN) e *Linear Discriminant Analysis* (LDA), dos dados de EEG transformados pela aplicação da Transformação Cosseno Discreta (*Discrete Cosine Transform – DCT*). O KNN com o DCT conseguiu classificar melhor o estado de estresse do participante.

6 EQUIPAMENTOS COMERCIAIS NA PESQUISA

O uso do MindWave Mobile II foi recentemente empregado para o controle de cadeira de rodas (Abuzaher e Al-Azzeh, 2021; Permana et al., 2019), controle de mão robótica e robô móvel (Purnamasari et al., 2019; Rusanu et al., 2019; Ruşanu et al., 2021) e predição de personalidade (Bhardwaj et al., 2021).

Outro estudo com uso de eletrodo único como fonte de dados eletrofisiológicos foi o trabalho de Quesada-Tabares et al. (2017), onde foi demonstrado que o uso de EEG comercial e com eletrodo único também possui um importante poder classificatório quando aplicado em algoritmos. Em seu estudo, sete participantes observaram imagens selecionadas do *International Affective Picture System* (IAPS) pertencentes a três grupos com diferentes valores de valência e excitabilidade. O teste de Análise de Variância aplicado indicou uma diferença estatisticamente significante entre os sets de imagens. Um segundo teste foi conduzido pela aplicação de um algoritmo de classificação no estilo árvore de decisão, chegando a uma acurácia média entre os sete participantes de **80.71%**.

Bos (2021) também explora o uso do Mindwave no contexto escolar para medir a atenção dos alunos. Em seu estudo, o nível de atenção com alunos assistindo a um vídeo educacional sem e outro com interações (fazendo pergunta aos alunos) é explorado e a distribuição percentual das diferentes bandas de frequência são comparadas entre os grupos. Foi observado uma relativa diminuição banda de frequência de onda beta para o grupo que não assistiu ao vídeo interativo, o que foi relacionado a um processamento cognitivo reduzido e menor atenção.

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Datasets multimodais tendem a performar melhor em algoritmos classificatórios que datasets unimodais. A forma de processamento dos dados também pode ter impactos na performance classificatórias dos algoritmos. Equipamentos comerciais já foram previamente utilizados em estudos de algoritmos classificatórios. É esperado que um método de tratamento eficiente reflita em uma maior acurácia dos algoritmos treinados no dataset.

7 SÍNCRONIZAÇÃO

A sincronização do sinal adquirido de diferentes equipamentos pode ser um desafio (Tu et al., 2020). Algumas propostas já foram exploradas a respeito, como o uso sincronização temporal e sincronização por piscadas (Xiao et al., 2022, Bækgaard et al. 2015, Notaro et al. 2018). Outra solução conta com o disparo de pulsos para os equipamentos de coleta fisiológica (Baccino e Manunta, 2005) e posterior sincronização.

7.1 SÍNCRONIZAÇÃO COM TIMECODE

Notaro et al. (2018) fez uma integração de equipamentos de coleta fisiológica e comportamental de baixo custo, através do equipamento OpenBCI para captura de EEG; GP3 para ET e dados de movimentação do mouse em tela. Os dados foram coletados enquanto os participantes realizavam atividades em um site de línguas. Os dados de EEG foram coletados em frequencia de 250Hz e dados de ET e deslocamento do mouse foram gravados em 60 Hz. Em sua pesquisa, Norato et al. faz uso uso do código temporal, ou *timecode*, para sincronizar as diferentes modalidades.

O driver do fabricante do equipamento comercial de EEG utilizado permite alteração da latência da coleta de dados, que foi modificada do valor padrão de 16 milissegundos para 1 milissegundo, afim de aumentar a precisão do equipamento. A granularidade do *timecode* foi de milissegundos (HH:MM:SS:MsMsMs), informação posteriormente utilizada para montar uma base de dados onde é possível identificar ondas cerebrais e coordenada do foco ocular em tela (figura 6.1). A calibração do GP3 e coleta de dados de ET foi realizada através de código desenvolvido em Python, enquanto a coleta de EEG é realizada por software próprio do OpenBCI e posteriormente unida em código em MATLAB, onde os dados são sincronizados para poder gerar imagens como a do exemplo abaixo.

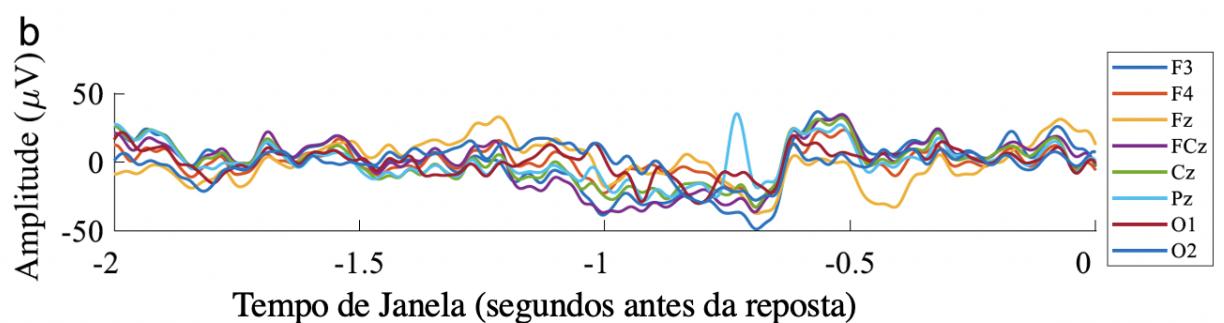
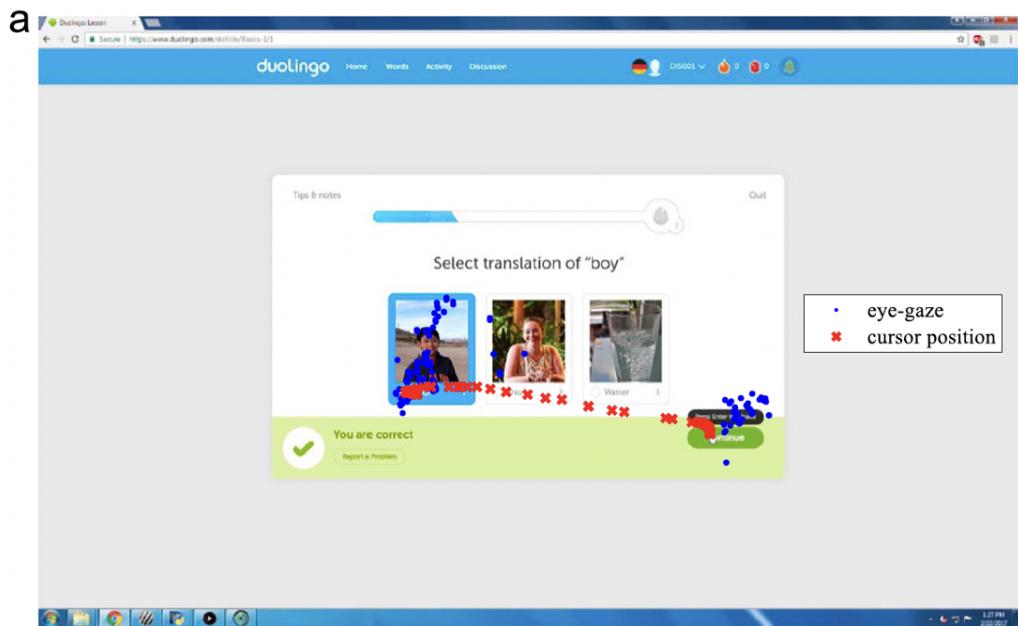


Figura 7.1. Dados de EEG, ET (eye gaze) e posição de cursor (cursor position) 2 segundos antes da resposta de um participante em atividades de um site de línguas. Fonte: Notaro et al. (2018).

7.2 SINCRONIZAÇÃO COM PISCADAS

Piscadas duram cerca de 200 milissegundos em média, com o tempo de abertura das pálpebras sendo cerca de duas vezes mais longo que a duração do fechar das pálpebras (Caffier et al., 2013). O comportamento de piscar também tende a ser relacionado a condições de alerta e a depender se o participante está engajado de forma ativa ou assistindo de forma passiva a determinada atividade (Caffier et al., 2013; Skotte et al. 2007).

e aparecem em sinais de EEG de forma característica, podendo alcançar uma amplitude de sinal acima de 200 microvolts em eletrodos próximos a órbita ocular (Hoffmann e Falkenstein, 2008). Assim sendo, é possível realizar uma sincronização por piscadas ao se detectar o movimento em ambos os equipamentos de coleta. No caso do EEG, as piscadas são comumente descartadas como artefatos indesejáveis. Já no estudo de Bækgaard et al. (2015), elas são a assinatura de sincronização entre os equipamentos de coleta de EEG e ET em função de sua onda característica (geralmente muitos milivolts acima do sinal do EEG), e de também ser detectada através dos equipamentos de rastreamento ocular.

A piscada envolve ativação muscular, e o dipolo ocular também influencia na captura de alterações de voltagem em eletrodos próximos aos olhos (Croft e Barry, 2000). Seu reflexo no EEG pode ser facilmente identificado pois tem a ter uma amplitude e forma de sinal característicos. A amplitude de uma atividade de piscada no sinal de EEG tem uma média de 200 microvolts (Hoffmann et al., 2008). Esta característica permite que o poder elétrico somado de eletrodos de interesse possam auxiliar na determinação de uma probabilidade do evento capturado ser uma piscada. No estudo de Bækgaard et al. (2015), as assinaturas de piscadas foram alinhadas entre as modalidades de EEG e ET para garantir a sincronizaçā, e o começo da atividade de piscada (com o fechamento das pálpebras) foi eleito como o ponto de referencia da assinatura.

Para se detectar a piscada através de um sinal, é possível tentar realizar o método de *Independent Component Analysis*, ou análise de componente independente, mas as características do sinal de piscada também permite outras abordagens, como a identificação por função de probabilidade.

EEG-Blinks é uma *toolbox* feita para MATLAB que possibilita a coleta de piscadas em dados de EEG, que funciona primeiramente extrairindo possíveis sinais de piscadas do sinal de EEG, calculando pontos de interesse (figura 6.1) nos sinais potenciais sinais de piscadas, rejeitando sinais com baixo SNR, e calculando o melhor sinal de piscada para ser utilizado. A partir disso, ele calcula as propriedades do sinal de piscada e seus índices (Blinker, 2022).

Como o equipamento de rastreamento procura encontrar sinais da movimentação

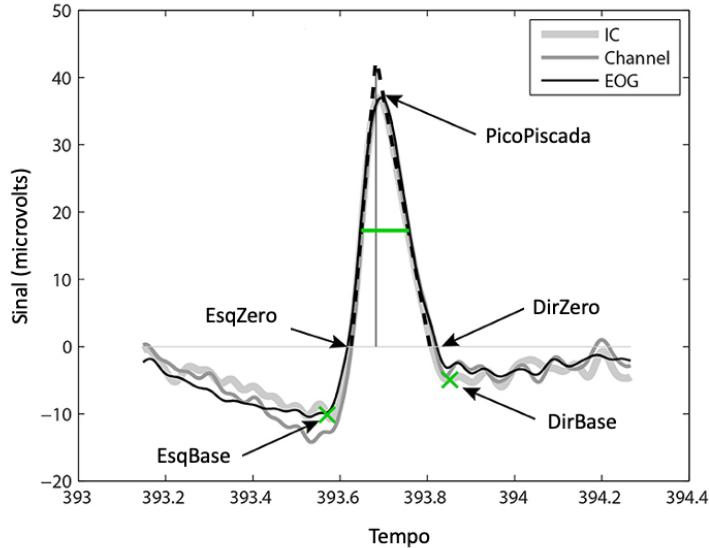


Figura 7.2. Assinatura de piscada em microvolts. Fonte: Blinker (2022)

ocular, ele também detecta a ausencia desse sinal. No estudo de Bækgaard et al. (2015), uma perda de até 500 milissegundos foi considerada como indicador da ocorrência de uma piscada. No equipamento de coleta de ET GP3, o fabricante oferece uma forma de identificar a existencia de uma piscada. Ela ocorre através da propriedade Blinking Validation Flag, ou BKID, onde qualquer valor diferente de 0 indica ocorrência de piscada durante o timeframe. A extração de piscada através do BKID foi utilizada no estudo de Seha et al. (2019), onde o blink rate foi validado e sincronizado com o vídeo do próprio equipamento (que indica quando houve piscada através da ausencia da imgem dos olhos do usuário).

7.3 CALCULAR A SINCRONIZAÇÃO

Existem diferentes métodos para calculo de sincronização entre séries temporais. A forma mais simples é por **correlação de Pearson**, que mede como dois sinais mudam ao longo do tempo em valores que vão de -1 a 1; com -1 indicando uma correlação perfeita e negativa, 1 uma correlação perfeita e 0, sem correlação. É importante notar que anomalias vão impactar significativamente a correlação, e que os dados assumem que a variância é homogênea.

Outro método de sincronização entre séries temporais é o **lag cross-correlation**, onde é possível identificar qual sinal vem primeiro. A correlação é calculada através da mudança gradual de um vetor de série temporal e subsequente cálculo de correlação. A correlação cruzada procura calcular a similaridade entre dois sinais com a aplicação de um *delay* em apenas um dos sinais.

Um exemplo de seu uso é no trabalho de Com dois sinais diferentes em EEG e ET, Bækgaard et al. (2015) opta por correlacionar as funções de probabilidade do evento observado em ambos os equipamentos, ser uma piscada. Para correlacionar assinaturas diferentes, as probabilidades de ocorrencia de um evento (piscada) em duas séries temporais são convertidas em uma mesma frequênci amostral (Bækgaard et al., 2014). A similaridade entre sinais é medida na amplitude do sinal da correlação. A correlação cruzada é definida como:

$$(f * g) = f(-t) * g(t), \quad (7.1)$$

onde * significa convolução e $f(-t)$ é o conjugado complexo de $f(t)$.

8 MATERIAIS E MÉTODOS

8.1 CONSTRUÇÃO DA FERRAMENTA

Dois equipamentos comerciais foram utilizados para construção da ferramenta de coleta sincronizada: Mindwave Mobile II e o GP3; para a coleta de EEG e ET, respectivamente. O código de coleta que gera o dataset multimodal foi construído em MATLAB, e o pré-processamento dos dados antes de serem *inputs* no treinamento de algoritmos no software Orange foi construído em Python. O presente capítulo irá apresentar os equipamentos de coleta e o método adotado para construção da ferramenta.

8.1.1 Mindwave Mobile II

O equipamento possui um eletrodo de coleta e um eletrodo de referência que ficam posicionados acima da sobrancelha esquerda e na orelha esquerda do participante, respectivamente. A posição do eletrodo de coleta em relação ao sistema de referência de posição de eletrodos (10-20), é o FP1, correspondendo a região Frontopolar 1. A coleta de dados do aparelho se dá por conexão via *bluetooth* e funciona em computadores Mac, Windows ou celulares Androids ou iOS, disponíveis em um raio de 10 metros (informações do fabricante). Ele coleta ondas cerebrais variando entre 3 e 100Hz, com uma frequência de 512Hz (NeuroSky Inc., 2015).

O aparelho automaticamente distingue os dados coletados em ondas alfa, beta, gama, teta e delta; além de coletar informações subjetivas no formato de medidas de atenção e meditação, por meio de um algoritmo de reforço de aprendizado não disponibilizado ao público. Também mede a ativação muscular próxima ao eletrodo para estimar a qualidade do sinal. O MindWave Mobile filtra interferência elétrica e converte o sinal detectado pelo eletrodo em sinal digital. O chip que faz o filtro e conversão se chama ThinkGear, e permite a filtragem de ruído para interferência ativação muscular (EMG) e 50/60Hz de corrente alternada.

Para o funcionamento adequado do Mindwave, é necessário instalar uma tecnologia chamada *ThinkGear* (TG), que permite a troca de informações entre o equipamento e os softwares compatíveis e processa o sinal detectado pelo eletrodo.



Figura 8.1. Mindwave Mobile II (Neurosky)

8.1.2 Gazepoint GP3

O GP3 é um equipamento comercial de coleta do movimento dos olhos, fabricado pela Gazepoint. Possui software próprio para análise dos dados, além de ser possível realizar coleta de dados com linguagens de programação open-source. O GP3 funciona emitindo uma luz infravermelha (IR) diretamente nos olhos do participante e captando a reflexão da luz para localizar o ponto focal ao longo do tempo. Permite coletar a direção do olhar, número de fixações, tempo até a primeira fixação, taxa de piscadas, duração de piscadas, diâmetro da pupila, tempo de duração do olhar em um determinado ponto focal, objetos observados em uma imagem, entre outros (informações do fabricante).

O Gazepoint GP3 estabelece sua conexão com o computador através de dois cabos USB - um cabo de energia e outro para dados. Seu posicionamento ideal é logo abaixo do monitor de estímulo. Para um melhor posicionamento, o fabricante sugere uma distância ideal de 65 cm dos olhos do participante até o equipamento. O GP3 possui as seguintes características, conforme especificado pelo fabricante:

- Acurácia de 0.5-1 grau de ângulo visual
- 60 Hz de frequencia de atualização
- calibração de 5 e 9 pontos
- API
- Captura movimento de 25cm horizontais e 11cm verticais
- 15 cm de limite de profundidade de movimento

A calibração é realizada pelo Gazepoint Control, afim de estabelecer qual o apon-tamento ocular do participante. A calibração pode ser feita em 5 pontos ou 9 pontos



Figura 8.2. GP3 (Gazepoint)

no monitor de exibição de estímulo. Os pontos na tela são apresentados em sequencia e o participante deve acompanha-los com o olhar até a finalização da calibração. Após a calibração ser concluída, a API calcula o erro do sistema em relação ao olhar para o olho esquerdo (em verde) e direito (vermelho), dos pontos apresentados na tela.

O equipamento GP3 possui uma *Application Programming Interface* (API) própria, o Open Gaze API. A API é uma alternativa de se controlar o equipamento sem precisar do software pago tambem feito pela Gazepoint. A API utiliza de um *Transmission Control Protocol – Internet Protocol (TCP/IP) socket*, que permite a comunicação entre a aplicação e o servidor (fonte dos dados de ET). O IP determina o endereço para o qual os dados serão enviados, e o TCP utiliza a arquitetura de rede para realizar o transporte. O formato de dado utilizado para a API é o *Extensible Markup Language (XML)*, que também pode ser implementado e estabelecer conexão com Python. As portas utilizadas para a comunicação de forma padrão são: localhost (127.0.0.1) e port 4242.

Na API do Gazepoint, o cliente tem duas tags de comunicação: GET e SET. Ao utilizar o SET o cliente pode alterar o valor de alguma variável. O comando GET não tem a possibilidade de alterção de valores. O servidor pode enviar dados para o cliente com diferentes tags: ACK, NACK, CAL e REC. As duas primeiras são geradas em resposta aos comandos de GET e SET (ACK – Sucesso e NACK – Falha). Os CAL são gerados com bases nas calibrações e REC serve para os dados gravados. Estas regras de escrita são utilizadas pelo código em Python para estabelecer o controle do GP3, permitindo que o código calibre o equipamento e estabeleça definições de variáveis.

8.2 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E SOFTWARES

Para a análise de dados coletados, foram necessários a utilização de alguns softwares. A escolha dos softwares foi dada com foco em um uso menos programático (fácil usabilidade mesmo para pessoas com pouco conhecimento de programação) e disponibilidade

de pacotes de interesse para as análises.

8.2.1 Orange

Orange é um software desenvolvido pela Universidade de Ljubljana (Demsar et al., 2013), que permite a construção facilitada de pipelines de modelagem através de click-and-point. Este software possibilita o estudo de diferentes algoritmos ao mesmo tempo, incluindo análise das principais métricas de desempenho. O pipeline todo pode ser montado com click-and-point, ou seja, sem precisar de programação.

8.2.2 Python

Python é uma linguagem de programação que vem crescendo seu uso na atualidade. Por ser fácil de se interpretar e por sua ativa comunidade de colaboradores, se faz uma linguagem de bastante interesse para a construção de soluções de análises que englobam a academia e a indústria. Python é uma linguagem criada com base em colaboração e sem custo. Logo, ao utilizarmos Python como linguagem de desenvolvimento de solução, podemos reduzir o custo geral da pesquisa.

8.2.3 MATLAB

O MATLAB é um software e linguagem de programação e software (Mathworks, 2018). A linguagem é baseada em matrizes e possibilita formas de visualizar problemas complexos. Tem diversas “toolboxes”, que permitem robustez e capacidade de processamento para diferentes tipos de dados.

8.3 COLETA DOS DADOS: PROTOCOLO

Para a coleta simultânea, duas linguagens de programação foram utilizadas: MATLAB e Python, como também utilizado no trabalho de Notaro et al. (2018). A montagem do *setup* foi feita com base nas coletas realizadas para a construção dos datasets EEGEyeNet e ZuCO (Kastrati et al., 2021; Hollenstein et al., 2019), com o gazepoint a frente do monitor de exibição de estímulos e com a montagem do equipamento de EEG antes de começar a coleta.

8.3.1 Preparo de Coleta

Inicialmente, o software Gazepoint Control foi ligado para rodar em *background* no computador. Em seguida, o Mindwave mobile II foi ligado e teve sua conexão *bluetooth* estabelecida e verificada. A porta de conexão (porta COM) PC-Mindwave pode mudar, então foi verificado em qual porta foi estabelecida a conexão em todo início de nova coleta. Após a verificação da porta, foi observado se houve necessidade de alterar este valor na variável do código. O Gazepoint ficou distante do participante até o software próprio acusar distância ideal (sinalizado por um sinal verde no topo do software de regulação do equipamento, figura 7.1). Para teste de coleta foram utilizados dois monitores: um para calibração e apresentação de imagens, e outro para o desenvolvimento de código e testagem (figura 7.2).

Com o posicionamento do participante em frente as cameras, o passo de coleta dos dados deve ter início.

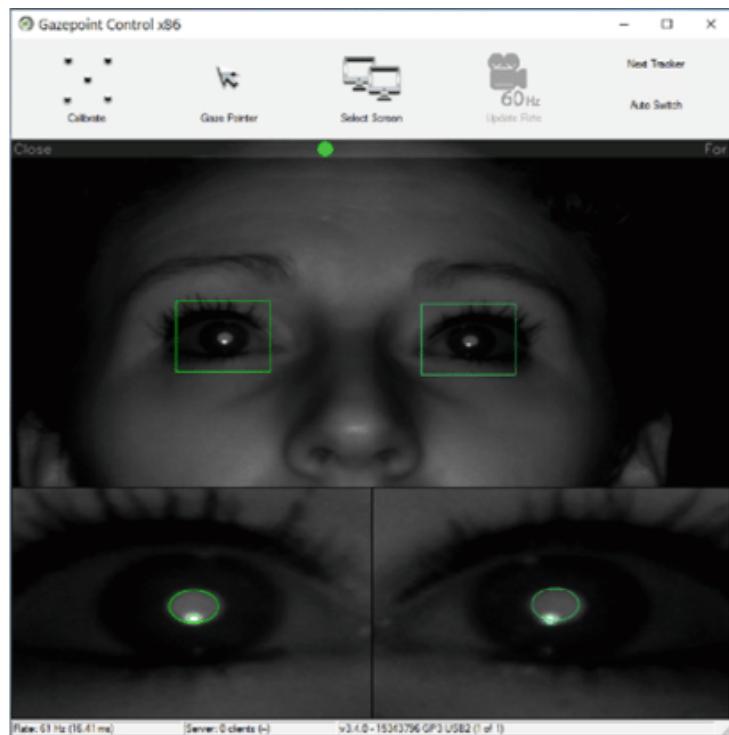


Figura 8.3. Exemplo do Opengaze conectado. Fonte: Sibley et al. (2017)

1. Coletando com MATLAB

O código foi escrito em MATLAB e funciona em quatro principais passos: (1) estabelecendo conexão com o GP3 e o Mindwave, (2) realizando a calibração de rastreamento ocular em tela, (3) gravando e plotando os dados de EEG e (4) gravando dados de ET e EEG simultaneos em um arquivo .txt pré definido (anterior ao início da gravação). O código faz uso de uma função de envio de informações simultâneas (na mesma linha



Figura 8.4. Montagem de Estudo de Caso da Ferramenta de Coleta EEG-ET.

temporal do dataframe) definido pelo usuário do equipamento GP3 na coluna ”USER” do arquivo .txt. Esta coluna é comumente utilizada para identificar estímulos que o participante estava sendo submetido no momento da gravação do rastreamento ocular.

Através do uso deste recurso do GP3 é armazenado a informação ”RAW EEG” do Mindwave Mobile II, que corresponde ao dado de EEG sem tratamentos. A gravação de ambos os equipamentos são armazenados na mesma linha temporal do dataset e em mesma frequência, seguindo a frequencia de coleta do equipamento GP3 (60Hz). Mais especificamente, o código realiza o seguinte:

1. Fecha todas as variáveis pré existentes;
2. Estabelece conexão com o GP3;
3. Executa a calibração do GP3 com 5 pontos em tela;
4. Estabelece conexão com o TG do Mindwave Mobile II;
5. Instancia um segundo terminal para envio de mensagens ao GP3 (mensagens enviadas são o valor do RAW do mindwave);
6. Plota em tempo-real a visualização do plot de EEG;
7. Fecha o segundo terminal após término da coleta em tempo pré-determinado;

8. Desconecta a conexão com ambos os equipamentos e fecha os dois terminais.

A conexão com o GP3 é estabelecida no segundo terminal, enquanto o primeiro é utilizado para enviar os dados de RAW EEG para a coluna "USER".

2. Validando o Dataset

A validação do uso do dataset foi realizado de acordo com o método indicado pelo desenvolvedor do software orange para classificação com cross-validação (figura 9.5).

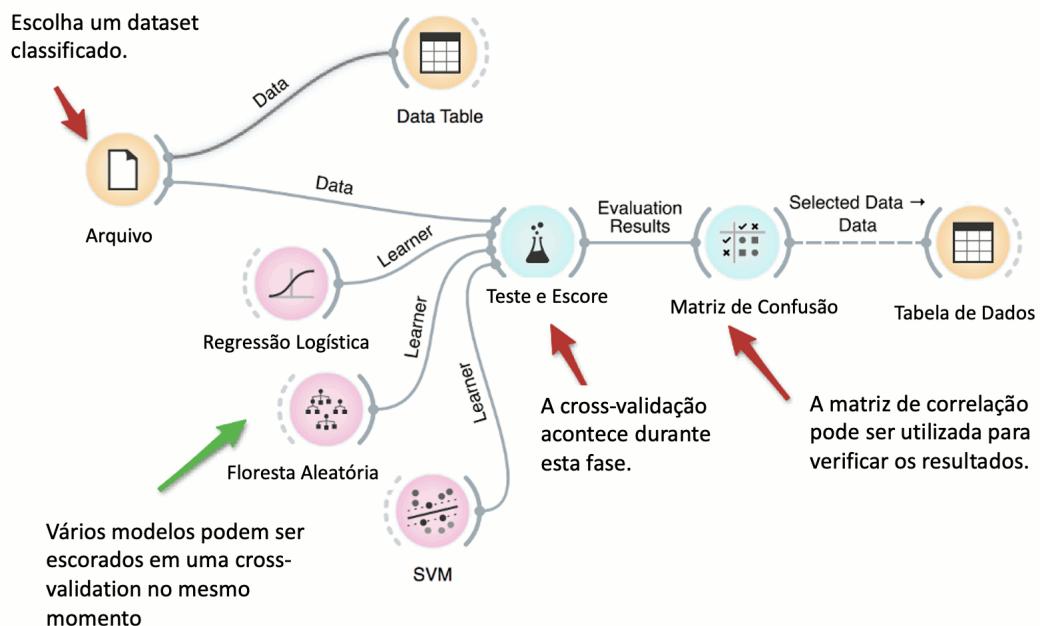


Figura 8.5. Workflow Orange para Algoritmos de Classificação. (Orange, 2022).

Quatro algoritmos de classificação foram analisados: Rede Neural (Neural Network), Regressão Logistica (Logistic Regression), Floresta aleatória (Random Forest) e Support Vector Machine (SVM). (Figura 9.6).

O processo de classificação é feito da seguinte forma:

1. Recebe o dataset dividido aleatoriamente entre treino (80%) e teste (20%);
2. Separa a coluna com a classificação, também chamada de *target*, e as colunas de características ou *features*;
3. Treina quatro modelos com os mesmos dados de treino;
4. Testa com o dataset de teste;
5. Plota a curva ROC;
6. Calcula a Matriz de Confusão;

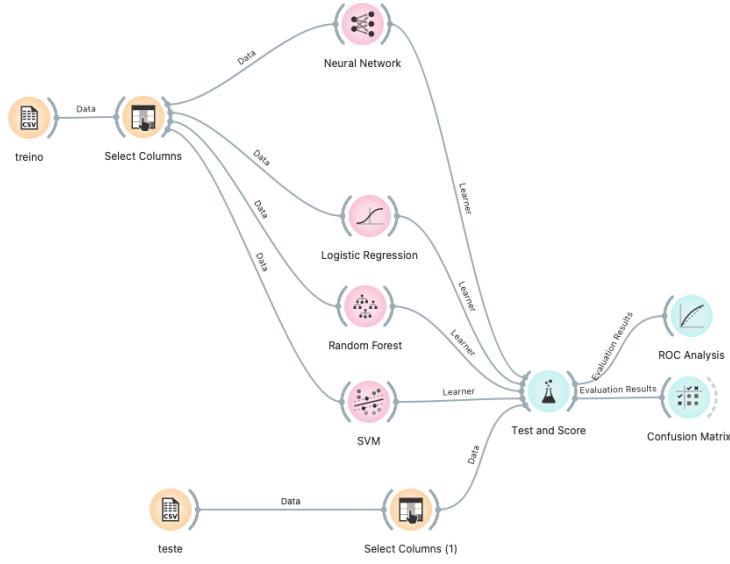


Figura 8.6. Workflow Utilizado no Projeto para Validar o Dataset Gerado pela Ferramenta Proposta.

8.3.2 Regressão Logística

A regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo produzir, a partir de um conjunto de observações, um modelo que permita a predição de valores tomados por uma variável categórica, frequentemente binária, em função de uma ou mais variáveis independentes contínuas.

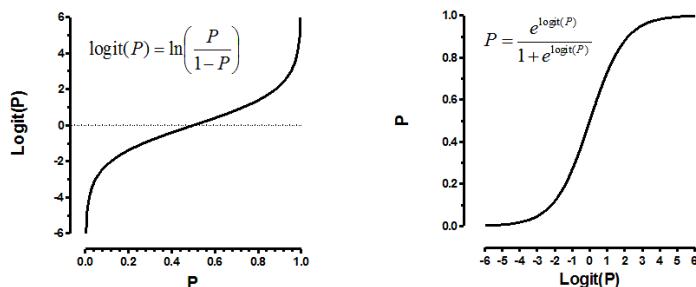


Figura 8.7. Regressão Logística

8.3.3 Floresta Aleatória

Florestas aleatórias são uma combinação de preditores de árvores de tal forma que cada árvore depende dos valores de um vetor aleatório amostrado independentemente e com a mesma distribuição para todas as árvores da floresta. A generalização erro para florestas converge a.s. até um limite à medida que o número de árvores na floresta se torna grande.

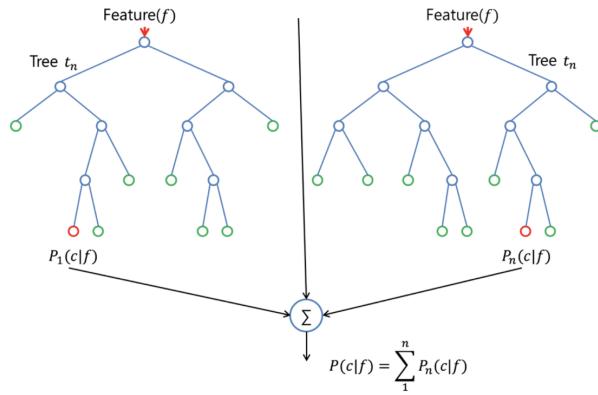


Figura 8.8. Floresta Aleatória

8.3.4 Support Vector Machine - SVM

É um método de classificação não probabilístico linear que procura maximizar a distância entre as categorias após mapear as observações no espaço. Podem performar uma classificação linear e não linear, através de colocar as observações em espaços multidimensionais.

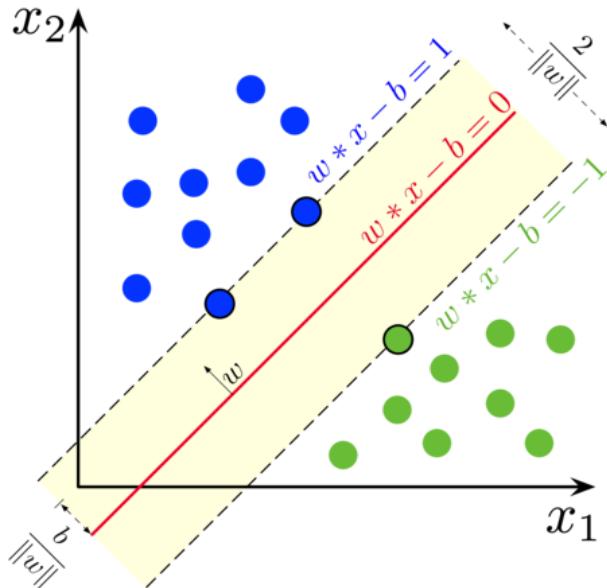


Figura 8.9. SVM Linear

8.3.5 Rede Neural

ma rede neural é um método de inteligência artificial que ensina computadores a processar dados de uma forma inspirada pelo cérebro humano. É um tipo de processo de machine learning, chamado aprendizado profundo, que usa nós ou neurônios interconectados em uma estrutura em camadas, semelhante ao cérebro humano.

8.3.6 Curva ROC

As curvas ROC (receiver operator characteristic curve) são uma forma de representar a relação, normalmente antagônica, entre a sensibilidade e a especificidade de um teste diagnóstico quantitativo, ao longo de um contínuo de valores de "cutoff point".

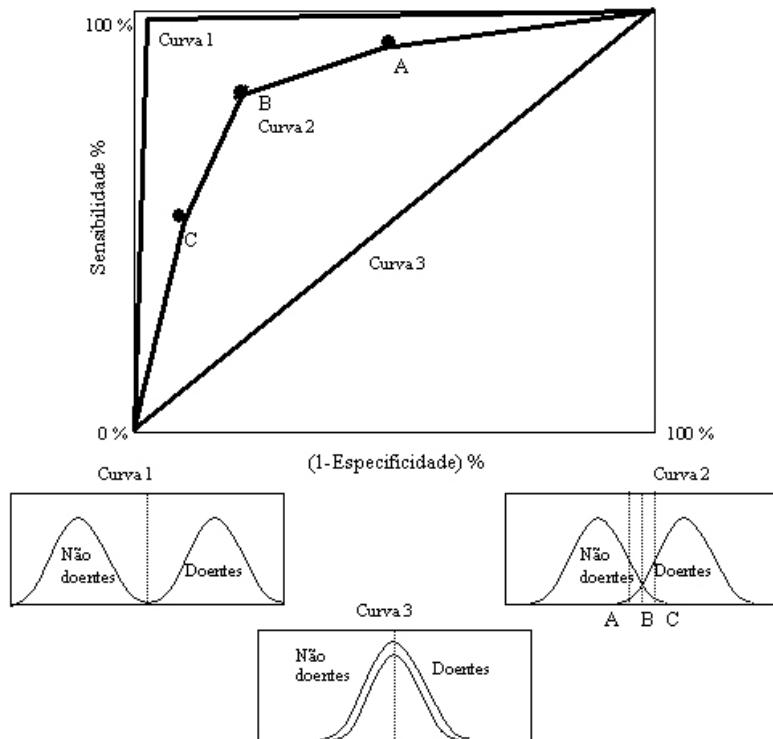


Figura 8.10. SVM Linear

8.3.7 Matriz de Confusão

A Matriz de Confusão é calculada pela função de pesquisa Classificação. Ela exibe a distribuição dos registros em termos de suas classes atuais e de suas classes previstas. Isso indica a qualidade do modelo atual. Um modelo pode conter duas ou mais classes previstas.

| | | Valor Preditivo | |
|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sim | Não |
| Real | Sim | Verdadeiro Positivo (TP) | Falso Negativo (FN) |
| | Não | Falso Positivo (FP) | Verdadeiro Negativo (TN) |

Figura 8.11. Matriz de Confusão

9 RESULTADOS

O dataset de EEG e ET foi construído com uma frequência de 60 Hz. Cada linha temporal contendo informação de dados de movimentação ocular e dados de EEG sem pré-processamento.

9.1 CONSTRUÇÃO DO DATASET

Dados de baixa qualidade são removidos. Estes consideram a coluna identificadora de má qualidade do aparelho GP3, e a ausencia de alteração por longos períodos (1 segundo) do raw EEG.

9.2 SINCRONIZAÇÃO

10 DISCUSSÃO

Durante a análise de performance do equipamento GP3, a métrica USER foi utilizada por Brand et al. (2020) para identificar o estímulo apresentando no dado timecode e também a captura de clicks no mouse. Segundo o fabricante, a coluna USER é utilizada para que o usuário possa enviar mensagens ao equipamento. O Código que gera os dados multimodais utiliza da mesma via disponibilizada pelo fabricante do equipamento para indicação de estímulos apresentados. Entretanto, ao invés da identificação de estímulo apresentado, o código captura o dado de EEG no determinado momento, possibilitando que o dataset gerado tenha informações de ambos, EEG e ET, para cada momento de coleta. Como no estudo apresentado sobre a qualidade dos dados do GP3, realizado por Brand et al. (2020), a coleta com a ferramenta multimodal também deverá considerar os principais fatores que impedem uma coleta de qualidade, sendo estes: distância do equipamento, reflexos no olho e calibração adequada.

O código possibilitou a geração de um datasetmultimodal coletado em um reduzido espaço de tempo. Para atestar a sincronização dos equipamentos, a presença de curvas típicas de piscadas foram identificadas em conjunto com a identificação de piscadas pelo equipamento GP3. Além da calibração realizada desta forma,

11 CONCLUSÃO

LISTA DE REFERÊNCIAS

APÊNDICE A

EXEMPLO DE APÊNDICE

Se você desejar, pode incluir ao final um ou mais apêndices, e um ou mais anexos. Caso não queira, é só remover todo o conteúdo começando na linha marcada por “% Início do Apêndice”, até a linha anterior a “\end{document}”.

APÊNDICE B

OUTRO EXEMPLO DE APÊNDICE

Se você desejar, pode incluir ao final um ou mais apêndices, e um ou mais anexos. Caso não queira, é só remover todo o conteúdo começando na linha marcada por “% Início do Apêndice”, até a linha anterior a “\end{document}”.

ANEXO A

EXEMPLO DE ANEXO

Se você desejar, pode incluir ao final um ou mais apêndices, e um ou mais anexos. Caso não queira, é só remover todo o conteúdo começando na linha marcada por “% Início do Apêndice”, até a linha anterior a “\end{document}”.

ANEXO B

OUTRO EXEMPLO DE ANEXO

Se você desejar, pode incluir ao final um ou mais apêndices, e um ou mais anexos. Caso não queira, é só remover todo o conteúdo começando na linha marcada por “% Início do Apêndice”, até a linha anterior a “\end{document}”.