


Процедура калибровки насосов рекомендуется производить каждые 500 га либо если вязкость нового препарата значительно отличается от предыдущего

1. Зайти в настройки дрона
2. Запустить процедуру калибровки



3. Залить в бак **3,5-4л готового раствора** и нажать кнопку “Next”
4. Выбрать один атомайзер, поставив галочку по стрелке и нажать “Start”
5. Дождаться успешного окончания калибровки и повторить процедуру для всех оставшихся атомайзеров

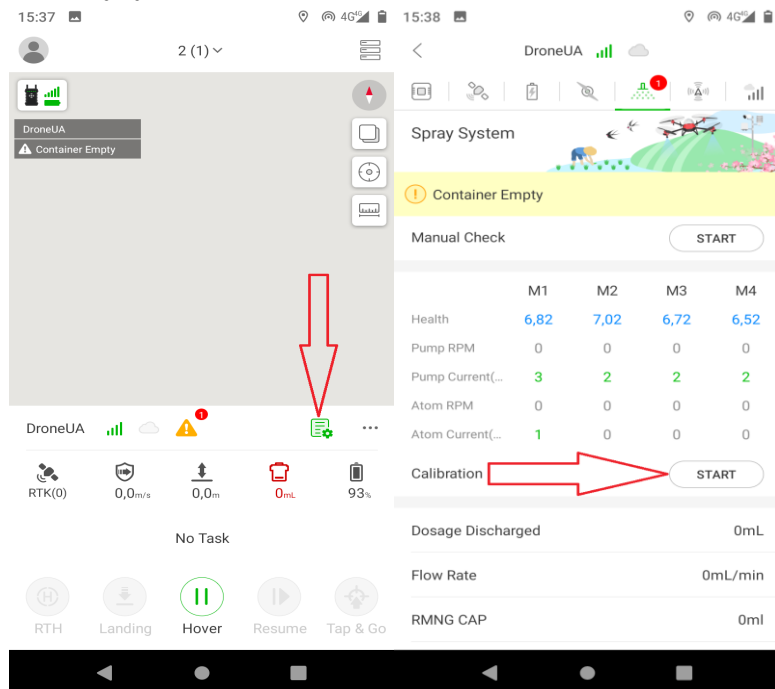