


Overview of Cp Values

Raw values

PI.1

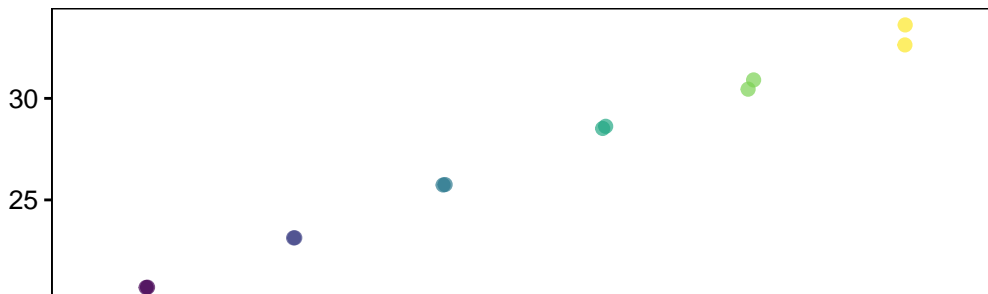


PI.2



SampleName

- Dilution1
- Dilution2
- Dilution3
- Dilution4
- Dilution5
- Dilution6

REF1

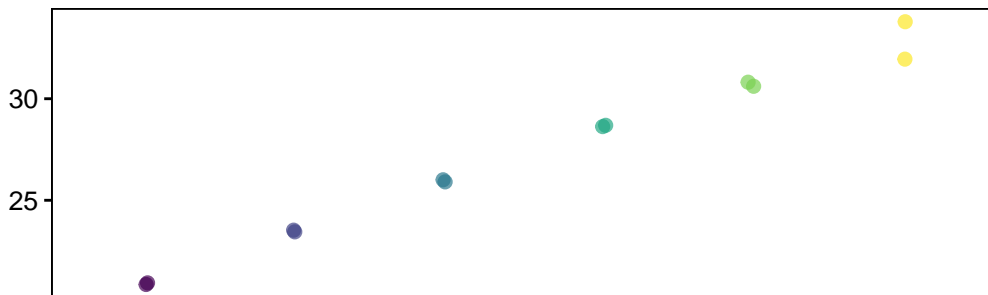


Dilution1 Dilution2 Dilution3 Dilution4 Dilution5 Dilution6

SampleName

Overview of Cp Values

Means of Technical Replicas

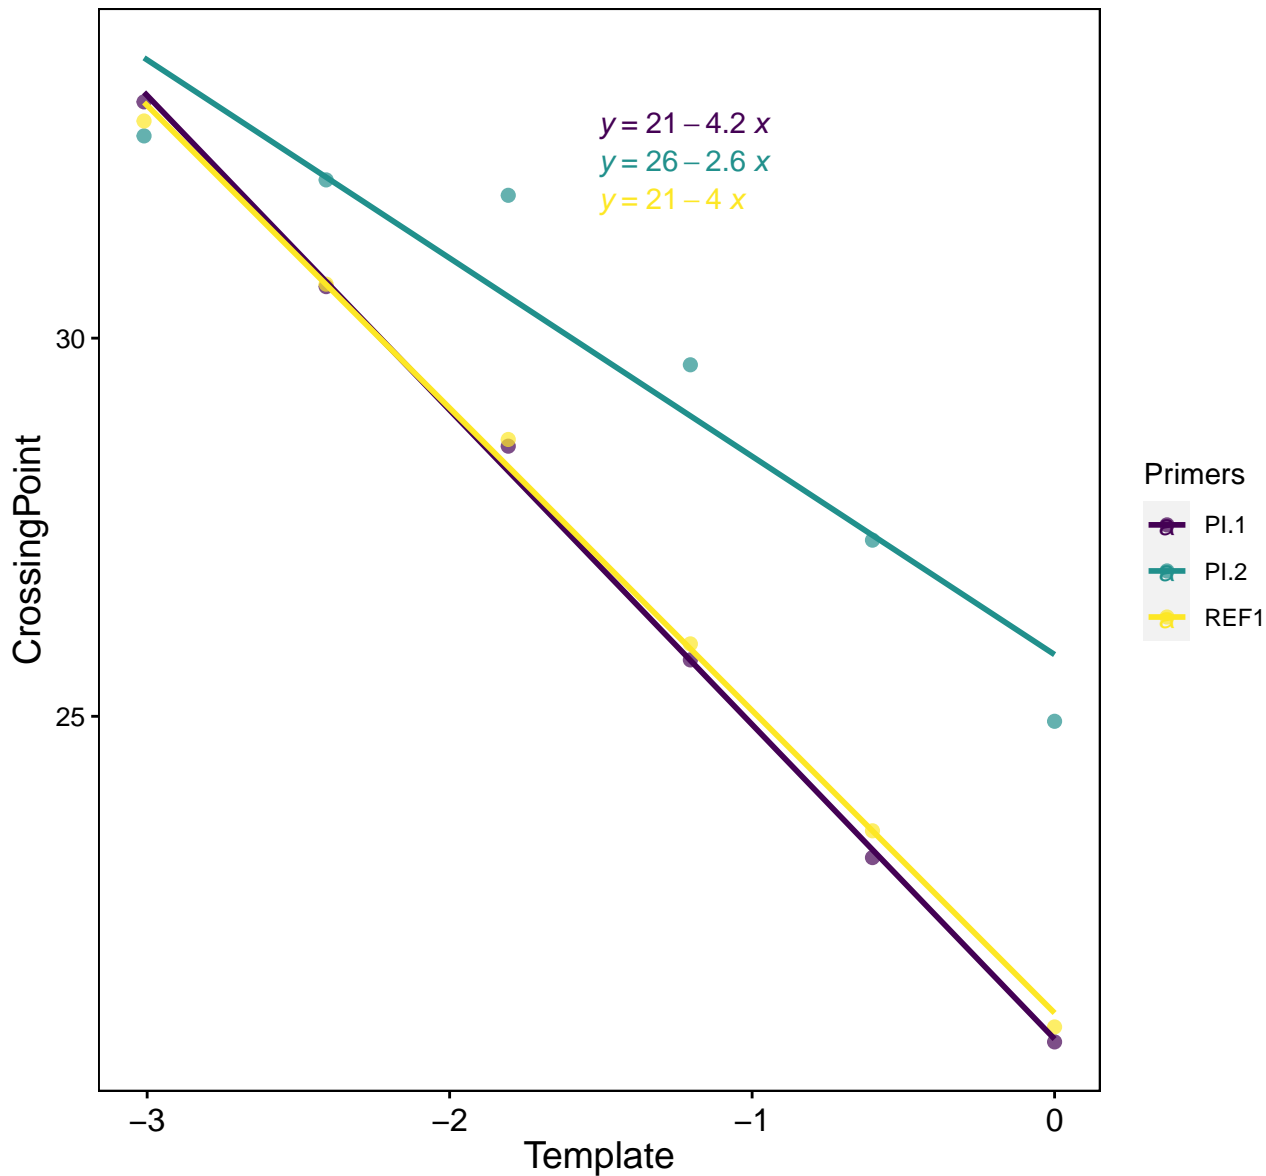

Primer Efficiencies

Formula: $\text{DilutionFactor}^{(-1/\text{slope})} - 1$

