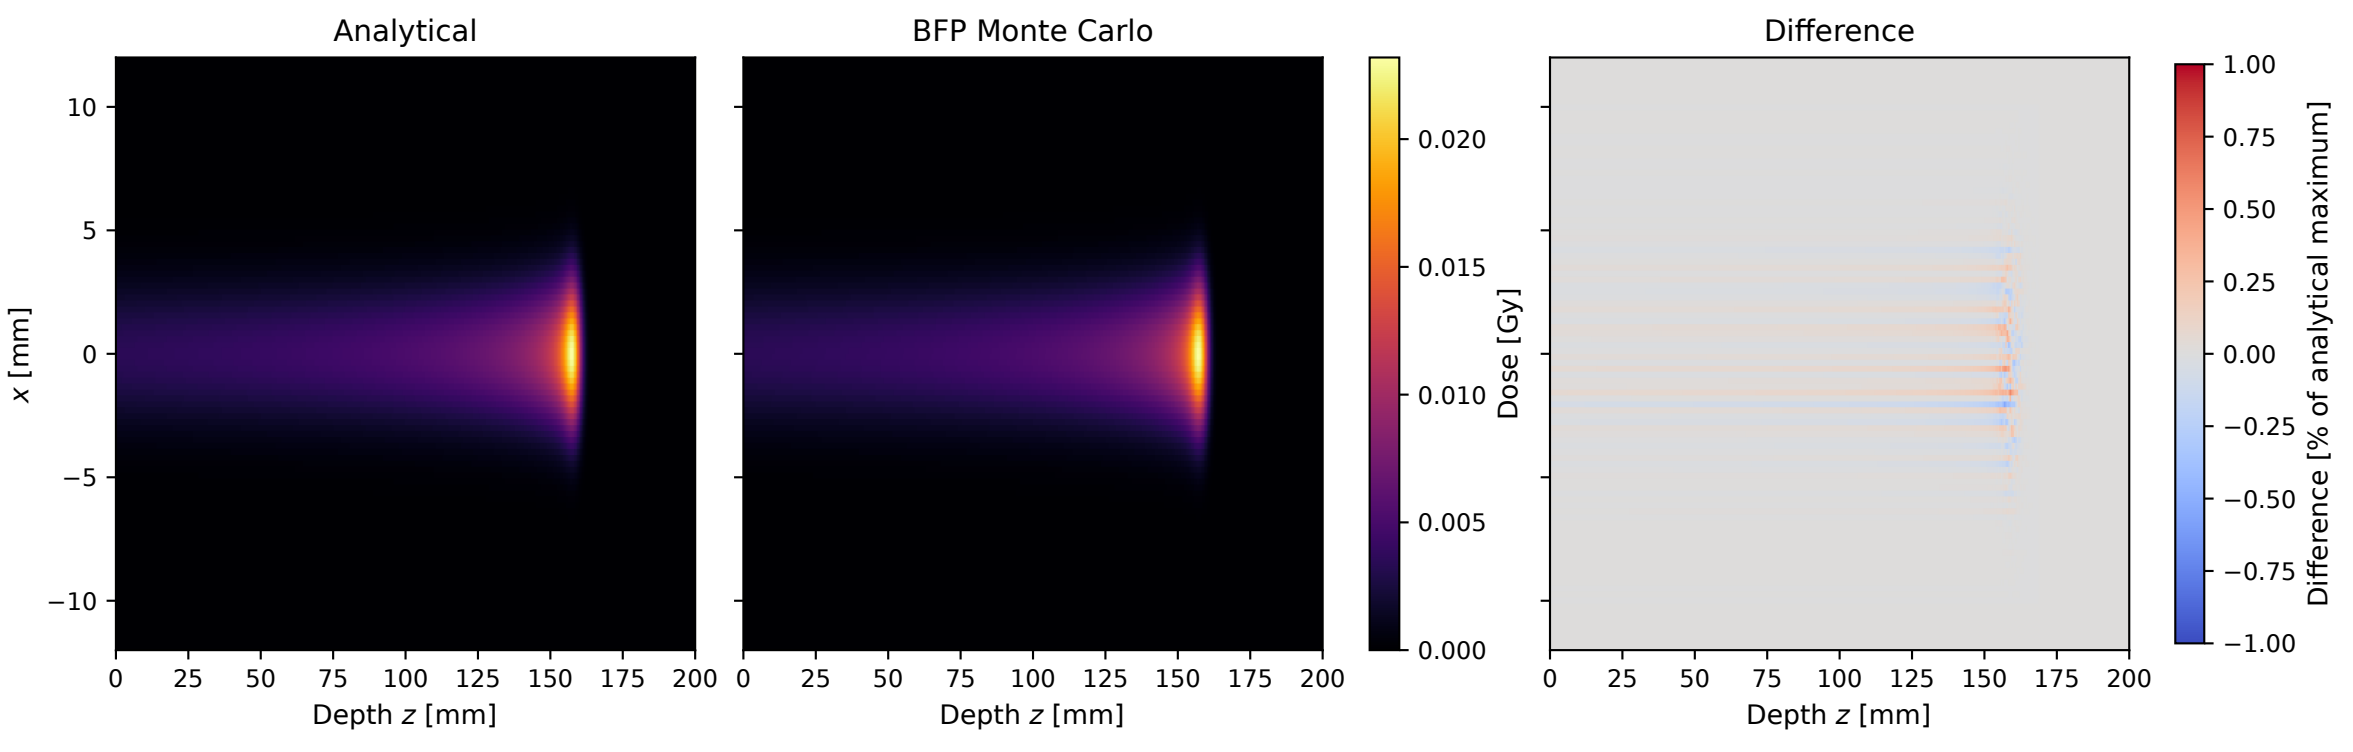

Analytical
BFP Monte Carlo
Difference
x [mm]
Depth z [mm]
Depth z [mm]
Depth z [mm]
Dose [Gy]
Difference [% of analytical maximum]
10
5
0
−5
−10
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00