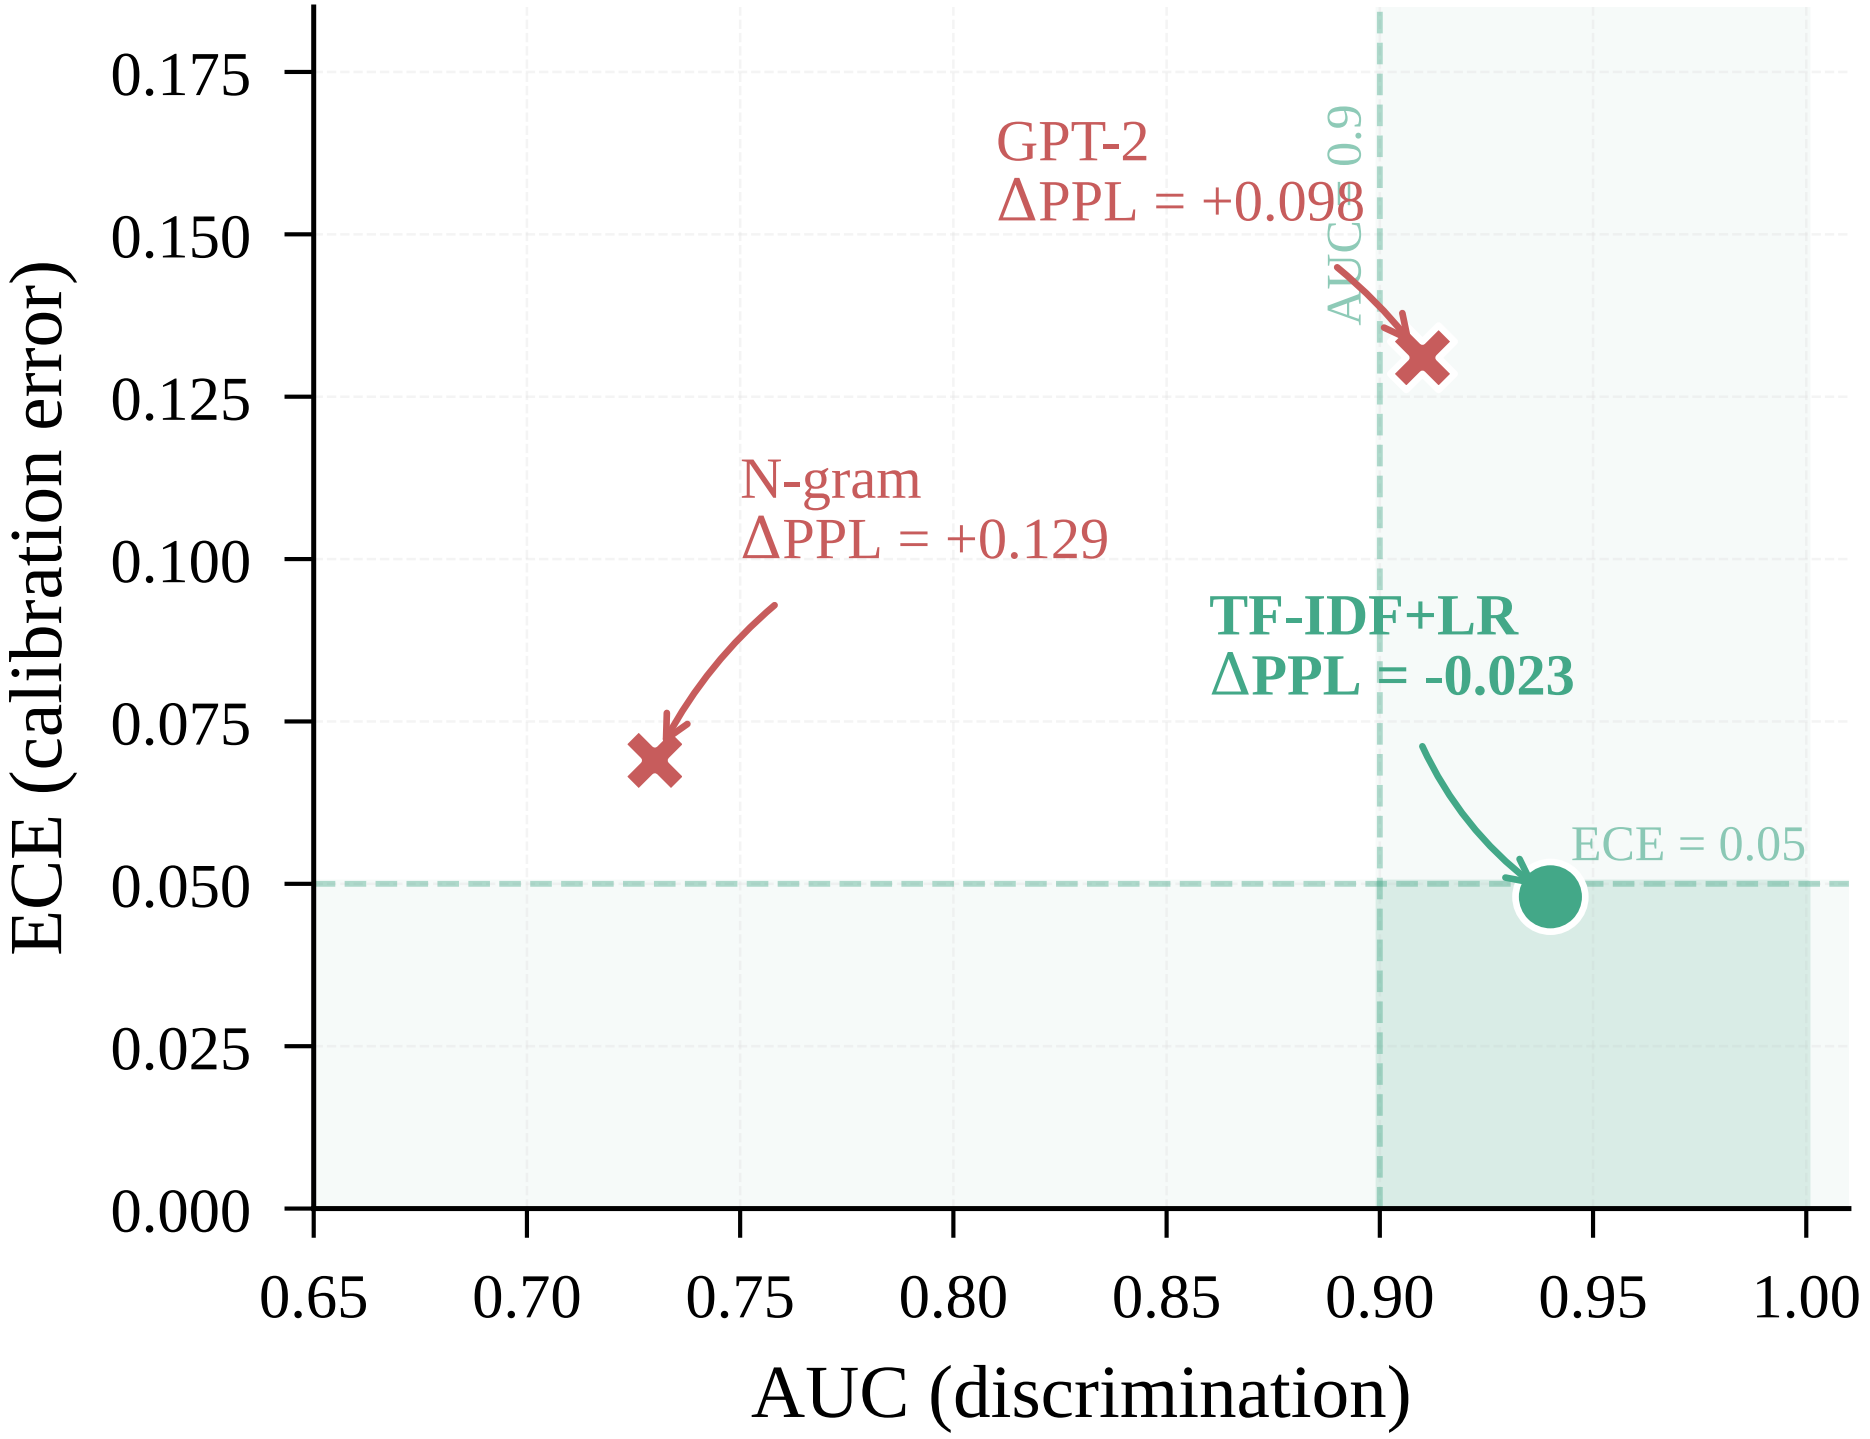
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
ECE (calibration error)
GPT-2
ΔPPL = +0.098
AUC = 0.9
N-gram
ΔPPL = +0.129
TF-IDF+LR
ΔPPL = -0.023
ECE = 0.05
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
AUC (discrimination)