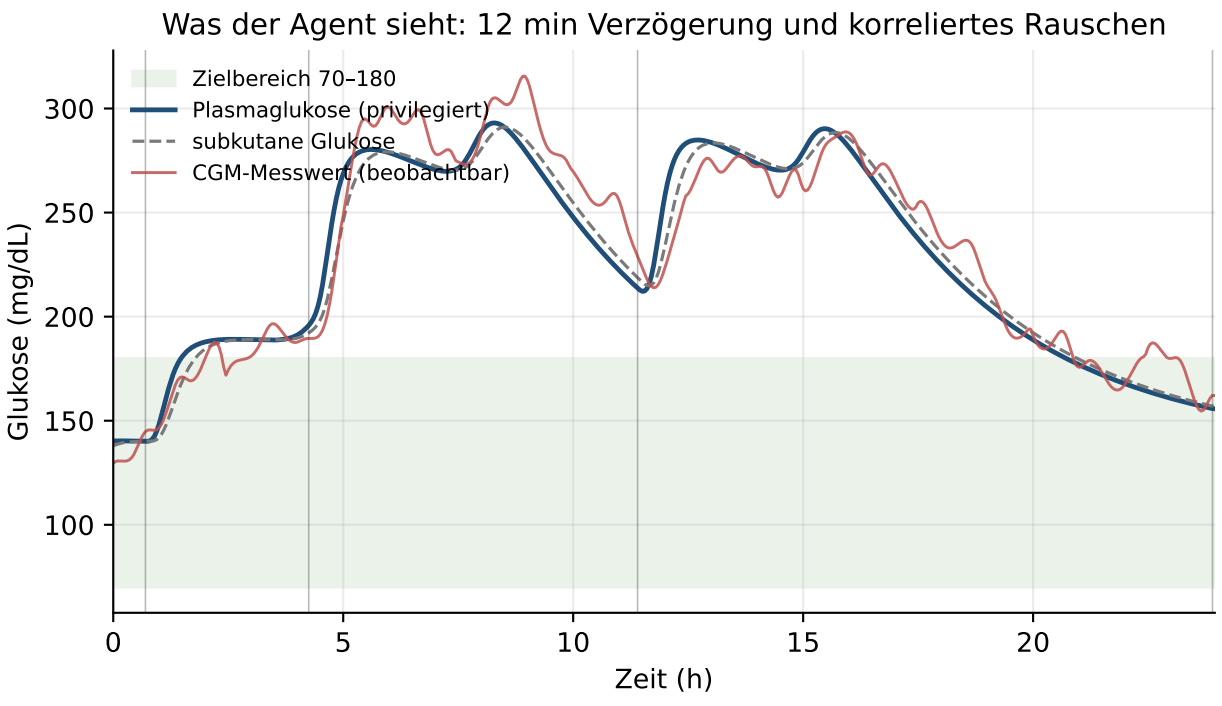
Was der Agent sieht: 12 min Verzögerung und korreliertes Rauschen
Zielbereich 70–180
Plasmaglukose (privilegiert)
subkutane Glukose
CGM-Messwert (beobachtbar)
Glukose (mg/dL)
300
250
200
150
100
0
5
10
15
20
Zeit (h)