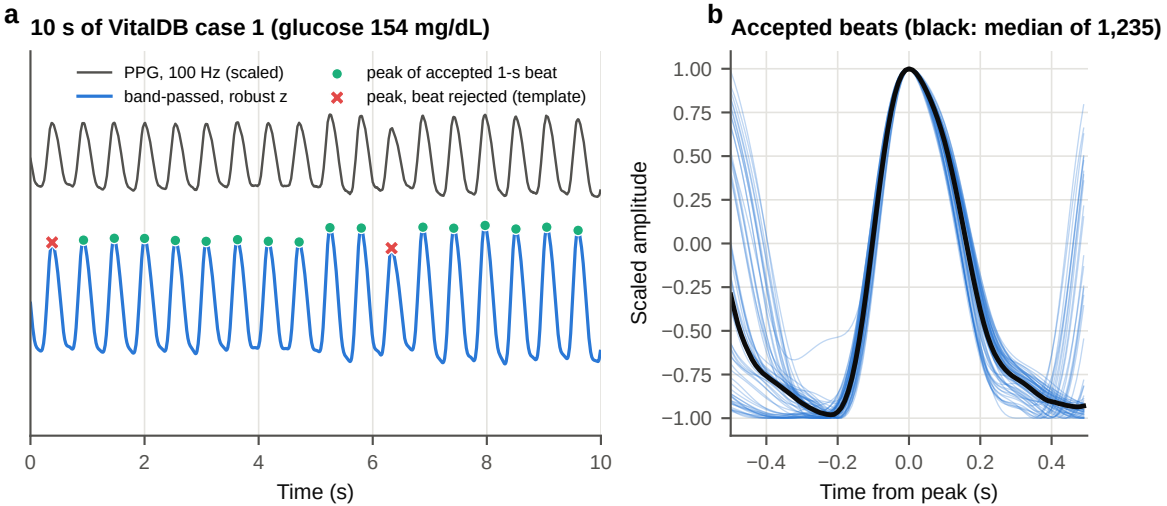

a
10 s of VitalDB case 1 (glucose 154 mg/dL)
PPG, 100 Hz (scaled)
band-passed, robust z
peak of accepted 1-s beat
peak, beat rejected (template)
0
2
4
6
8
10
Time (s)
b
Accepted beats (black: median of 1,235)
Scaled amplitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
Time from peak (s)