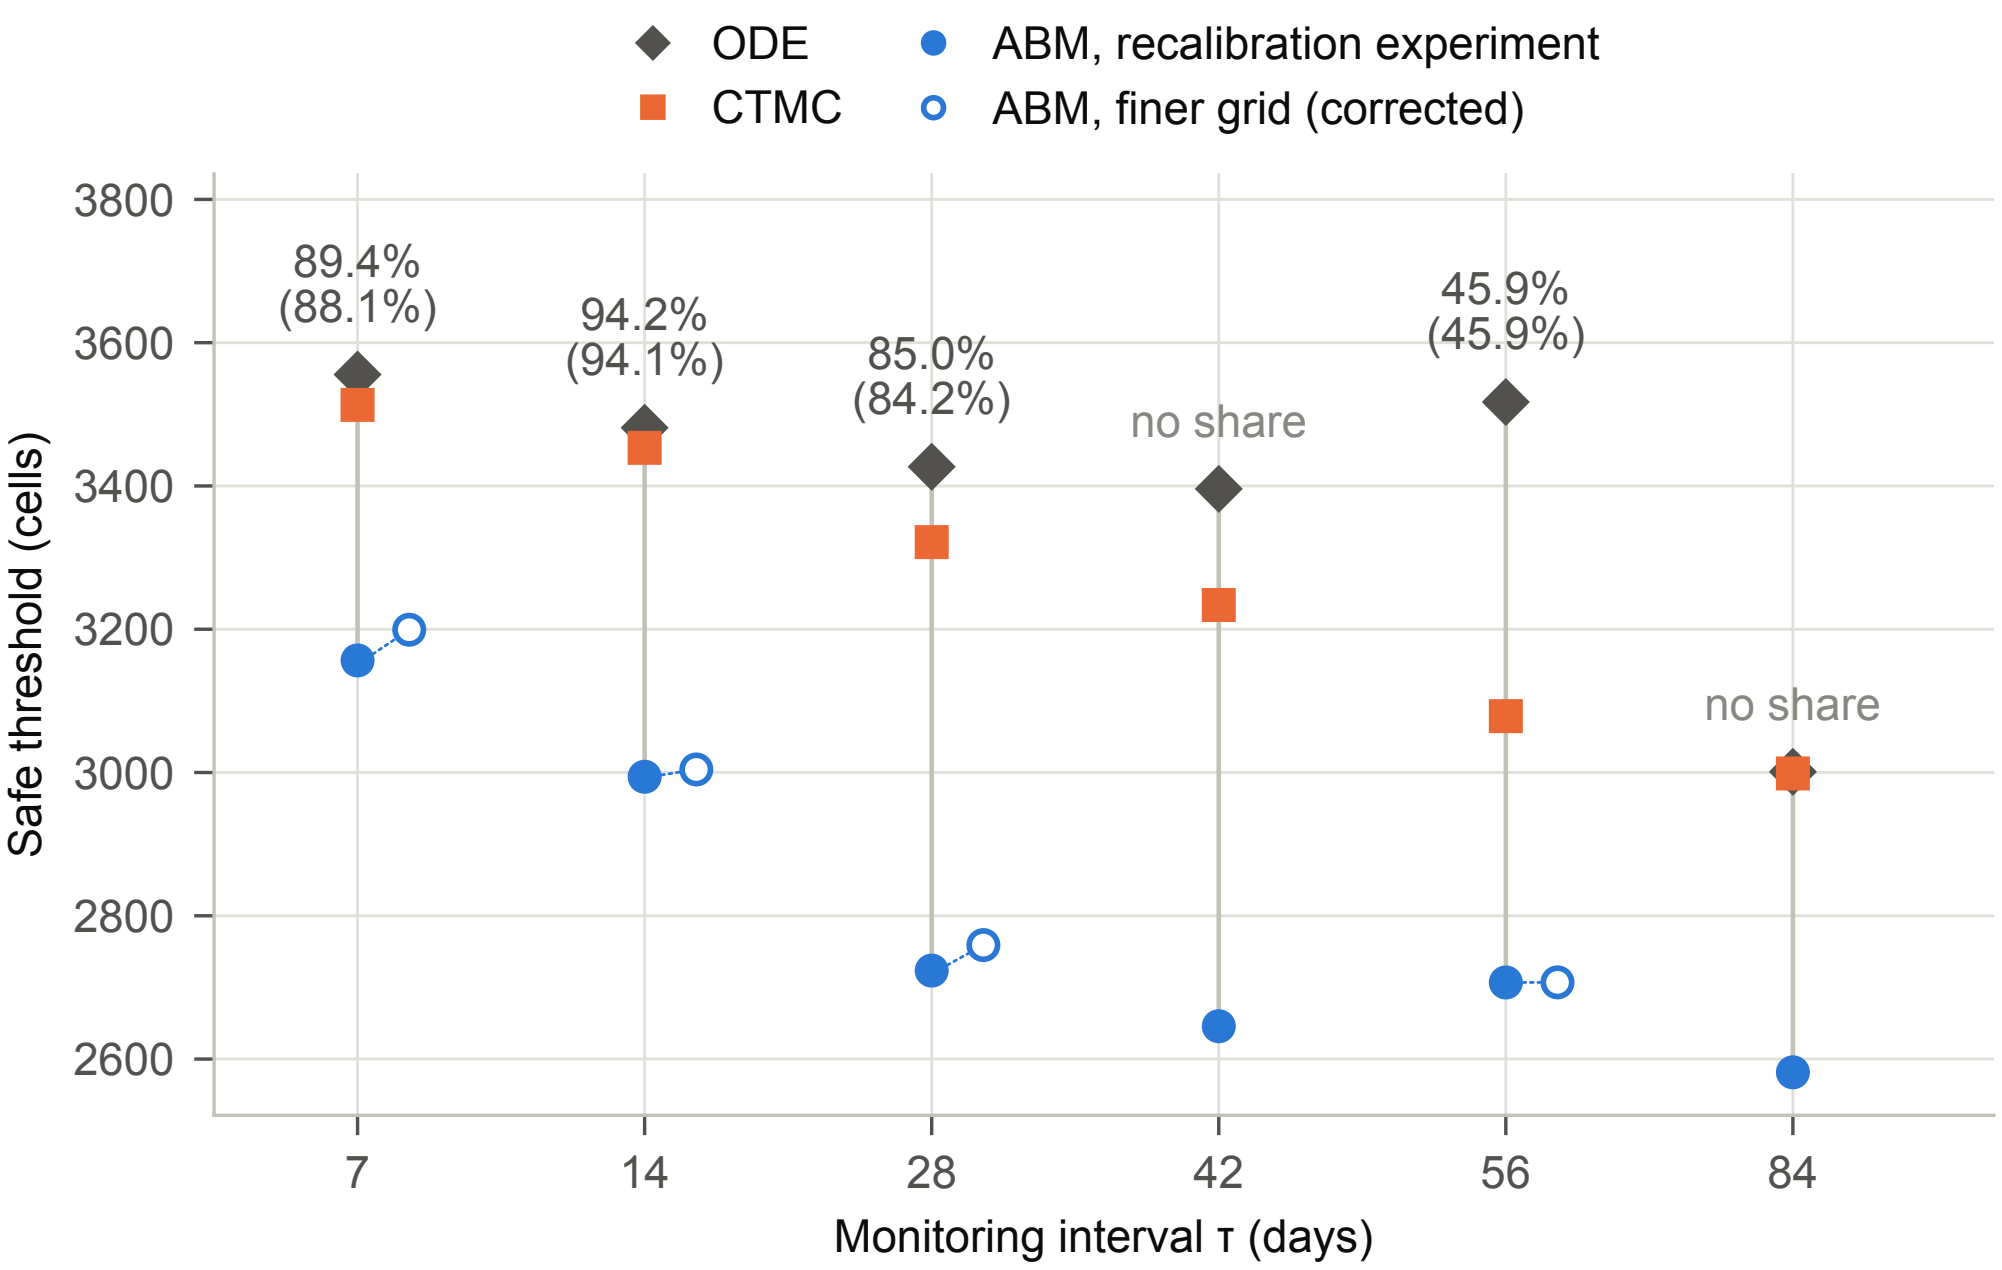
ODE
CTMC
ABM, recalibration experiment
ABM, finer grid (corrected)
Safe threshold (cells)
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
89.4%
(88.1%)
94.2%
(94.1%)
85.0%
(84.2%)
no share
45.9%
(45.9%)
no share
7
14
28
42
56
84
Monitoring interval τ (days)