


NETZSCH Temperature Calibration - DSC 200F3 t-sensor

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Instrument: | NETZSCH DSC 200F3 240-20-066-L |
| File name: | temp_calibration_10.ngb-td5 |
| Heating rate: | 10.0 |
| Furnace: | Std DSC 200F3 |
| Crucible: | Pan Al, pierced lid |
| Atmosphere: | NITROGEN |
| Date: | 04.12.2017 13:23:11 (UTC+3) |

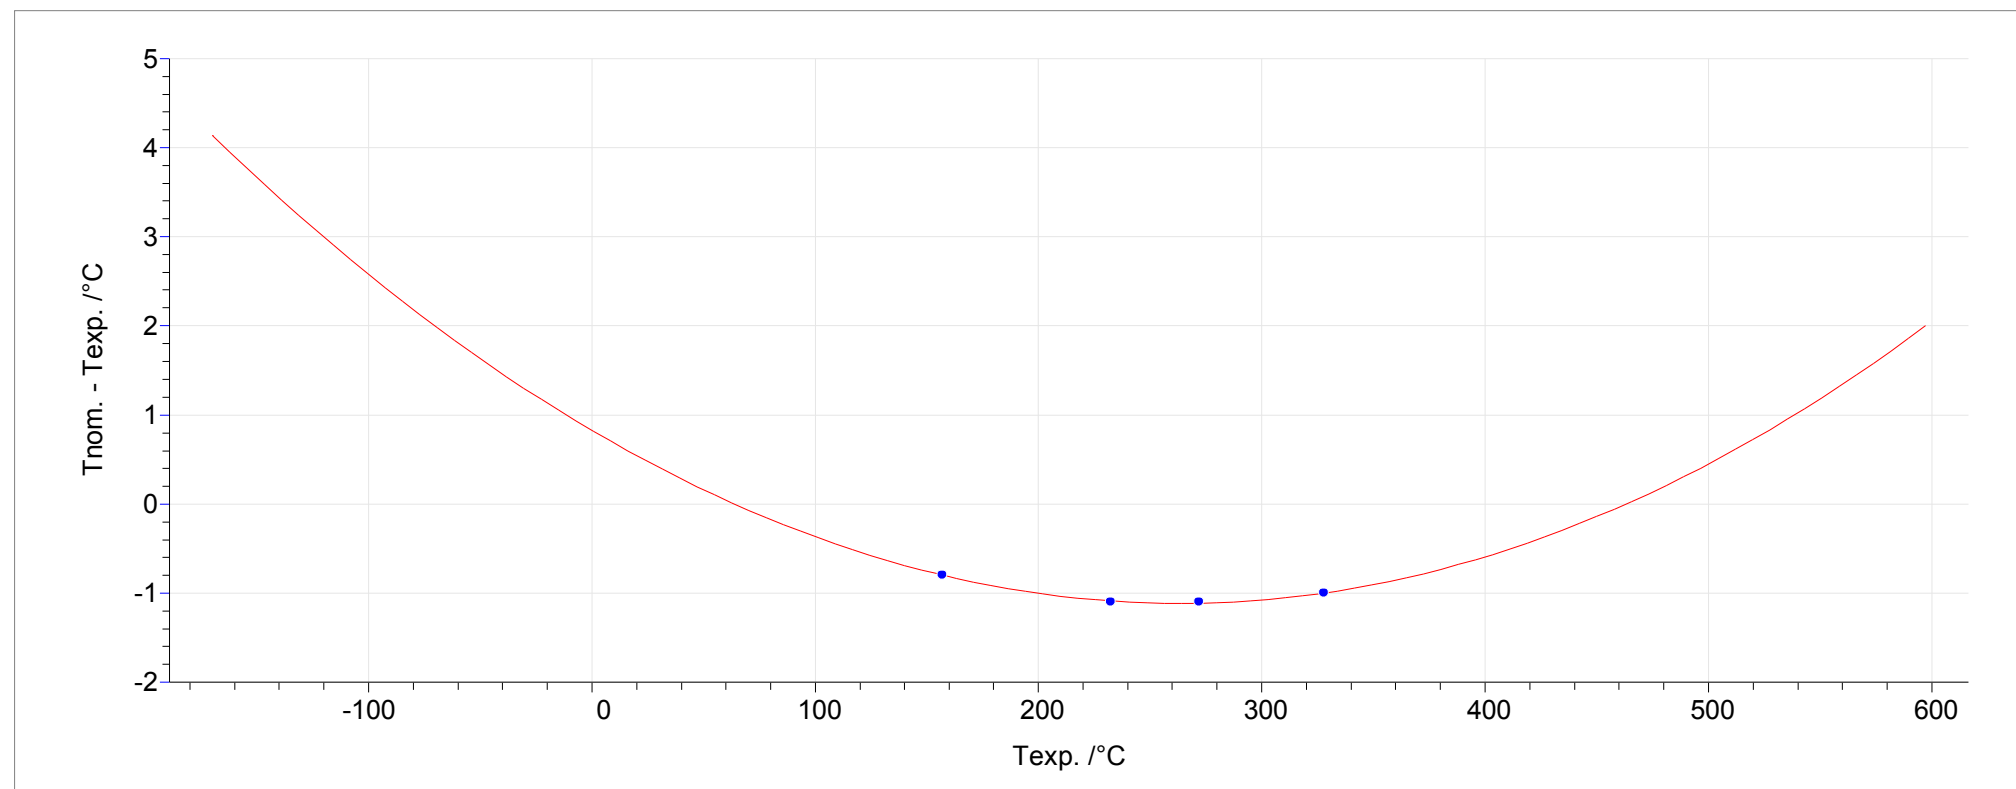

| Substance | Temp. nom. /°C | Temp. exp. /°C | Mathematical Weight | Temp. corr. /°C |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| In | 156.6 | 157.4 | 10.000 | 156.6 |
| Sn | 231.9 | 233.0 | 1.000 | 231.9 |
| Bi | 271.4 | 272.5 | 1.000 | 271.4 |
| Pb | 327.5 | 328.5 | 1.000 | 327.5 |