

Пациент

NIDZIEVA V

Дата рожд.	22.02.1946	Пол	Женский	ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" Диагностика ул. им. Землячки, 80 г. Волгоград 8-844-291-35-35
Ид пациента	503141			
Врач	Surgeon	Оператор	Administrator	

Дата проверки калибр: 03.04.2023 от: Administrator Результат: OK
 Дата измерения: 03.04.2023 п: 1,3375 CVD: 12,00 мм

! [OD] Hoffer® Q является торговым знаком компании Kenneth Hoffer.
 [OS] Hoffer® Q является торговым знаком компании Kenneth Hoffer.

OD правый		Расчет ИОЛ				OS левый					
		Статус глаза									
LS:	Факический	VS:	Стекловидное тело	LS:	Факический	VS:	Стекловидное тело				
Реф:	---	VA:	---	Реф:	---	VA:	---				
LVC:	Нелеченный	Режим LVC:	-	LVC:	Нелеченный	Режим LVC:	-				
Цел. рефр.:	План	SIA:	+0,20 дптр @ 135°	Цел. рефр.:	План	SIA:	+0,20 дптр @ 135°				
Биометрические показатели											
AL:	23,56 мм	SD:	12 мкм	AL:	23,27 мм	SD:	10 мкм				
ACD:	2,88 мм	SD:	5 мкм	ACD:	2,85 мм	SD:	7 мкм				
LT:	4,79 мм	SD:	7 мкм	LT:	4,74 мм	SD:	10 мкм				
WTW:	11,2 мм			WTW:	11,1 мм						
SE:	45,67 дптр	SD:	0,02 дптр	K1:	44,85 дптр @ 97°	SE:	45,92 дптр	SD:	0,02 дптр	K1:	45,48 дптр @ 84°
ΔK:	-1,68 дптр @ 97°			K2:	46,53 дптр @ 7°	ΔK:	-0,89 дптр @ 84°			K2:	46,37 дптр @ 174°
TSE:	45,57 дптр	SD:	0,03 дптр	TK1:	44,58 дптр @ 97°	TSE:	45,76 дптр	SD:	0,07 дптр	TK1:	45,22 дптр @ 84°
ΔTK:	-2,03 дптр @ 97°			TK2:	46,61 дптр @ 7°	ΔTK:	-1,10 дптр @ 84°			TK2:	46,32 дптр @ 174°
TK	Alcon - SA60AT	TK	Alcon - SA60AT	TK	Alcon - SA60AT	TK	Alcon - SA60AT				
- Barrett TK Universal II - LF: +1,64 DF: +5,0		- Holladay 2 - ACD: +5,426		- Barrett TK Universal II - LF: +1,64 DF: +5,0		- Holladay 2 - ACD: +5,426					
ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)	ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)	ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)	ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)				
+19,00	-0,68	+19,50	-0,80	+20,00	-0,84	+20,00	-0,58				
+18,50	-0,33	+19,00	-0,47	+19,50	-0,49	+19,50	-0,25				
+18,00	+0,02	+18,50	-0,14	+19,00	-0,13	+19,00	+0,08				
+17,50	+0,37	+18,00	+0,19	+18,50	+0,22	+18,50	+0,40				
+17,00	+0,71	+17,50	+0,51	+18,00	+0,56	+18,00	+0,72				
+18,03	Эмметропия	+18,29	Эмметропия	+18,81	Эмметропия	+19,12	Эмметропия				
TK	Alcon - SA60AT	TK	Alcon - SA60AT	TK	Alcon - SA60AT	TK	Alcon - SA60AT				
- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179		- Hoffer® Q - pACD: +5,44		- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179		- Hoffer® Q - pACD: +5,44					
ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)	ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)	ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)	ИОЛ (дптр)	Реф (дптр)				
+19,00	-0,78	+19,00	-0,69	+19,50	-0,60	+20,00	-0,83				
+18,50	-0,42	+18,50	-0,35	+19,00	-0,25	+19,50	-0,49				
+18,00	-0,07	+18,00	-0,02	+18,50	+0,11	+19,00	-0,16				
+17,50	+0,28	+17,50	+0,30	+18,00	+0,46	+18,50	+0,17				
+17,00	+0,63	+17,00	+0,63	+17,50	+0,80	+18,00	+0,50				
+17,90	Эмметропия	+17,97	Эмметропия	+18,65	Эмметропия	+18,76	Эмметропия				

(!) значение на границе нормы

(*) значение отредактировано вручную

--- нет результата измерения

Комментарий



Пациент

NIDZIEVA V

Дата рожд.
Ид пациента22.02.1946
503141

Пол


Женский

Врач

Surgeon

Оператор

Administrator

ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза"
Диагностика
ул. им. Землячки, 80
г. Волгоград
8-844-291-35-35Дата проверки калибр: 03.04.2023
Дата измерения: 03.04.2023от: Administrator
н: 1,3375Результат: OK
CVD: 12,00 ммOD
правый

Анализ


Статус глаза

LS: Факический
Реф: ---VS: Стекловидное тело
VA: ---

LVC: Нелеченный

AL: 23,56 мм
CCT: 550 мкм
ACD: 2,88 мм
LT: 4,79 ммSD: 12 мкм
SD: 2 мкм
SD: 5 мкм
SD: 7 мкмWTW: 11,2 мм
P: 3,3 ммIx: +0,3 мм
CW-Chord: 0,2 мм @ 233°SE: 45,67 дптр
K1: 44,85 дптр @ 97°
K2: 46,53 дптр @ 7°
ΔK: -1,68 дптр @ 97°SD: 0,02 дптр
SD: 0,03 дптр
SD: 0,02 дптр
SD: 0,03 дптрTK1: 44,58 дптр @ 97°
TK2: 46,61 дптр @ 7°
ΔTK: -2,03 дптр @ 97°


B-режим

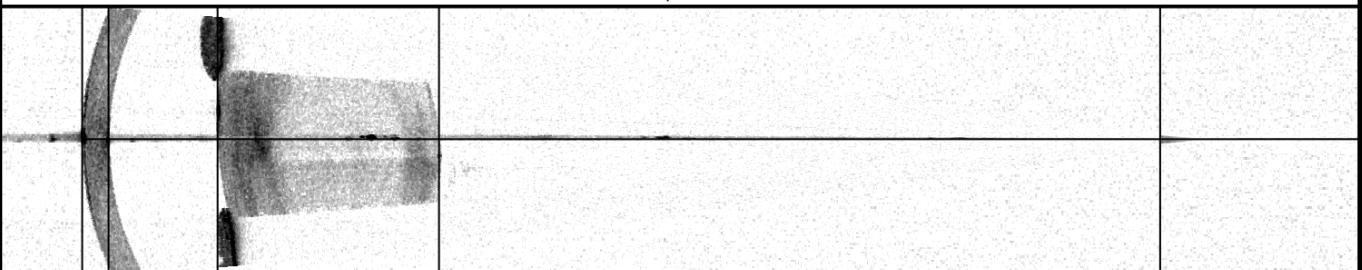

Кератометрия

От белого до белого

Фиксация

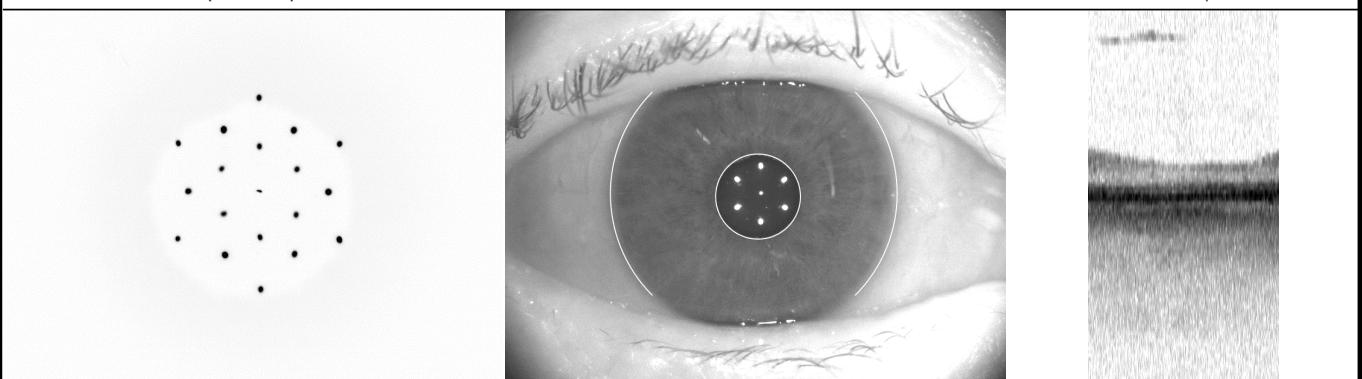

(!) значение на границе нормы

(*) значение отредактировано вручную

--- нет результата измерения

Комментарий



Пациент

NIDZIEVA V

Дата рожд.
ИД пациента22.02.1946
503141

Пол

Женский

Врач

Surgeon

Оператор

Administrator

ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза"
 Диагностика
 ул. им. Землячки, 80
 г. Волгоград
 8-844-291-35-35

Дата проверки калибр:

03.04.2023 от: Administrator

Результат: OK

Дата измерения:

03.04.2023 н: 1,3375

CVD: 12,00 мм



Анализ				OS левый
Статус глаза				
LS: Факический Реф: ---	VS: Стекловидное тело VA: ---	LVC: Нелеченный		
Биометрические показатели				
AL: 23,27 мм CCT: 541 мкм ACD: 2,85 мм LT: 4,74 мм	SD: 10 мкм SD: 4 мкм SD: 7 мкм SD: 10 мкм	WTW: 11,1 мм P: 3,4 мм	Ix: -0,4 мм CW-Chord: 0,1 мм @ 307°	ly: +0,2 мм
SE: 45,92 дптр K1: 45,48 дптр @ 84° K2: 46,37 дптр @ 174° ΔK: -0,89 дптр @ 84°	SD: 0,02 дптр SD: 0,07 дптр SD: 0,04 дптр	TSE: 45,76 дптр TK1: 45,22 дптр @ 84° TK2: 46,32 дптр @ 174° ΔTK: -1,10 дптр @ 84°	SD: 0,07 дптр SD: 0,11 дптр SD: 0,06 дптр	
B-режим				
Кератометрия		От белого до белого	Фиксация	

(!) значение на границе нормы

(*) значение отредактировано вручную

--- нет результата измерения

Комментарий



Пациент

NIDZIEVA V

Дата рожд.	22.02.1946	Пол	Женский	ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" Диагностика ул. им. Землячки, 80 г. Волгоград 8-844-291-35-35
ИД пациента	503141			
Врач	Surgeon	Оператор	Administrator	

Дата проверки калибр: 03.04.2023 от: Administrator Результат: OK
 Дата измерения: 03.04.2023 п: 1,3375 CVD: 12,00 мм



OD правый		Биометрические показатели						OS левый							
Статус глаза															
LS: Факический Реф: --- LVC: Нелеченный				VS: Стекловидное тело VA: ---				LS: Факический Реф: --- LVC: Нелеченный		VS: Стекловидное тело VA: ---					
Биометрические показатели															
AL: 23,56 мм CCT: 550 мкм ACD: 2,88 мм LT: 4,79 мм				SD: 12 мкм SD: 2 мкм SD: 5 мкм SD: 7 мкм				AL: 23,27 мм CCT: 541 мкм ACD: 2,85 мм LT: 4,74 мм				SD: 10 мкм SD: 4 мкм SD: 7 мкм SD: 10 мкм			
AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT				
23,58 мм	550 мкм	2,88 мм	4,80 мм	23,27 мм	541 мкм	2,84 мм	4,75 мм								
23,57 мм	549 мкм	2,88 мм	4,79 мм	23,28 мм	538 мкм	2,84 мм	4,75 мм								
23,57 мм	547 мкм	2,88 мм	4,79 мм	23,29 мм	541 мкм	2,85 мм	4,73 мм								
23,56 мм	550 мкм	2,88 мм	4,79 мм	23,28 мм	543 мкм	2,85 мм	4,74 мм								
23,56 мм	551 мкм	2,88 мм	4,80 мм	23,27 мм	543 мкм	2,85 мм	4,74 мм								
23,55 мм	551 мкм	2,88 мм	4,79 мм	23,26 мм	542 мкм	2,84 мм	4,75 мм								
Значения роговицы															
SE: 45,67 дптр K1: 44,85 дптр @ 97° K2: 46,53 дптр @ 7° ΔK: -1,68 дптр @ 97°				SD: 0,02 дптр SD: 0,03 дптр SD: 0,02 дптр SD: 0,02 дптр				SE: 45,92 дптр K1: 45,48 дптр @ 84° K2: 46,37 дптр @ 174° ΔK: -0,89 дптр @ 84°				SD: 0,02 дптр SD: 0,07 дптр SD: 0,04 дптр SD: 0,02 дптр			
SE: 45,66 дптр SE: 45,67 дптр SE: 45,69 дптр				ΔK: -1,67 дптр @ 98° ΔK: -1,69 дптр @ 97° ΔK: -1,67 дптр @ 97°				SE: 45,85 дптр SE: 45,91 дптр SE: 45,94 дптр				ΔK: -1,17 дптр @ 84° ΔK: -0,91 дптр @ 83° ΔK: -0,82 дптр @ 85°			
TSE: 45,57 дптр TK1: 44,58 дптр @ 97° TK2: 46,61 дптр @ 7° ΔTK: -2,03 дптр @ 97°				SD: 0,03 дптр SD: 0,03 дптр SD: 0,07 дптр SD: 0,03 дптр				TSE: 45,76 дптр TK1: 45,22 дптр @ 84° TK2: 46,32 дптр @ 174° ΔTK: -1,10 дптр @ 84°				SD: 0,07 дптр SD: 0,11 дптр SD: 0,06 дптр SD: 0,07 дптр			
TSE: 45,54 дптр TSE: 45,60 дптр TSE: 45,57 дптр				ΔTK: -1,95 дптр @ 97° ΔTK: -2,04 дптр @ 97° ΔTK: -2,11 дптр @ 97°				TSE: 45,66 дптр TSE: 45,79 дптр TSE: 45,77 дптр				ΔTK: -1,26 дптр @ 86° ΔTK: -1,24 дптр @ 81° ΔTK: -1,06 дптр @ 86°			
Значения ББ и зрачка															
WTW:	11,2 мм	Ix:	+0,3 мм	Iy:	+0,0 мм	WTW:	11,1 мм	Ix:	-0,4 мм	Iy:	+0,2 мм	P:	3,3 мм	CW-Chord:	0,2 мм @ 233°
P:	3,4 мм					P:	3,4 мм							CW-Chord:	0,1 мм @ 307°
Изображение сохранено				Reference Image				Изображение сохранено							

(!) значение на границе нормы

(*) значение отредактировано вручную

--- нет результата измерения

Комментарий




Пациент

NIDZIEVA V

Дата рожд.	22.02.1946	Пол	Женский	ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" Диагностика ул. им. Землячки, 80 г. Волгоград 8-844-291-35-35
Ид пациента	503141			
Врач	Surgeon	Оператор	Administrator	

Дата проверки калибр: 03.04.2023 от: Administrator Результат: OK
 Дата измерения: 03.04.2023 п: 1,3375 CVD: 12,00 мм

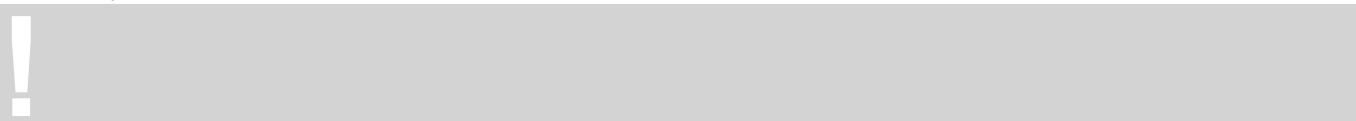

OD правый	Значения роговицы		OS левый
Статус глаза			
LS: Факический Реф: --- LVC: Нелеченный	VS: Стекловидное тело VA: ---	LS: Факический Реф: --- LVC: Нелеченный	VS: Стекловидное тело VA: ---
Значения роговицы			
SE: 45,67 дптр K1: 44,85 дптр@ 97° K2: 46,53 дптр@ 7° ΔK: -1,68 дптр@ 97°	SD: 0,02 дптр SD: 0,03 дптр SD: 0,02 дптр ΔK: -1,67 дптр@ 98°	SE: 45,92 дптр K1: 45,48 дптр@ 84° K2: 46,37 дптр@ 174° ΔK: -0,89 дптр@ 84°	SD: 0,02 дптр SD: 0,07 дптр SD: 0,04 дптр ΔK: -1,17 дптр@ 84°
SE: 45,66 дптр SE: 45,67 дптр SE: 45,69 дптр	ΔK: -1,69 дптр@ 97° ΔK: -1,69 дптр@ 97° ΔK: -1,67 дптр@ 97°	SE: 45,85 дптр SE: 45,91 дптр SE: 45,94 дптр	ΔK: -0,91 дптр@ 83° ΔK: -0,82 дптр@ 85°
Total Keratometry			
TSE: 45,57 дптр TK1: 44,58 дптр@ 97° TK2: 46,61 дптр@ 7° ΔTK: -2,03 дптр@ 97°	SD: 0,03 дптр SD: 0,03 дптр SD: 0,07 дптр ΔTK: -1,95 дптр@ 97°	TSE: 45,76 дптр TK1: 45,22 дптр@ 84° TK2: 46,32 дптр@ 174° ΔTK: -1,10 дптр@ 84°	SD: 0,07 дптр SD: 0,11 дптр SD: 0,06 дптр ΔTK: -1,26 дптр@ 86°
TSE: 45,54 дптр TSE: 45,60 дптр TSE: 45,57 дптр	ΔTK: -2,04 дптр@ 97° ΔTK: -2,11 дптр@ 97°	TSE: 45,66 дптр TSE: 45,79 дптр TSE: 45,77 дптр	ΔTK: -1,24 дптр@ 81° ΔTK: -1,06 дптр@ 86°
Значения задней поверхности роговицы			
PSE: -6,25 дптр PK1: -6,18 дптр@ 178° PK2: -6,31 дптр@ 88° ΔPK: -0,13 дптр@ 88°	SD: 0,03 дптр SD: 0,04 дптр SD: 0,05 дптр ΔPK: -0,09 дптр@ 87°	PSE: -6,34 дптр PK1: -6,29 дптр@ 177° PK2: -6,39 дптр@ 87° ΔPK: -0,09 дптр@ 87°	SD: 0,03 дптр SD: 0,06 дптр SD: 0,00 дптр ΔPK: -0,12 дптр@ 149°
PSE: -6,27 дптр PSE: -6,21 дптр PSE: -6,26 дптр	ΔPK: -0,09 дптр@ 70° ΔPK: -0,12 дптр@ 92° ΔPK: -0,21 дптр@ 94°	PSE: -6,36 дптр PSE: -6,30 дптр PSE: -6,35 дптр	ΔPK: -0,22 дптр@ 71° ΔPK: -0,14 дптр@ 95°
Прочие значения			
CCT: 550 мкм WTW: 11,2 мм P: 3,3 мм	SD: 2 мкм Ix: +0,3 мм ly: +0,0 мм CW-Chord: 0,2 мм @ 233°	CCT: 541 мкм WTW: 11,1 мм P: 3,4 мм	SD: 4 мкм Ix: -0,4 мм ly: +0,2 мм CW-Chord: 0,1 мм @ 307°

(!) значение на границе нормы

(*) значение отредактировано вручную

--- нет результата измерения

Комментарий



Пациент

NIDZIEVA V

Дата рожд.
Ид пациента22.02.1946
503141

Пол

Женский

Врач

Surgeon

Оператор

Administrator


ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза"
Диагностика
ул. им. Землячки, 80
г. Волгоград
8-844-291-35-35Дата проверки калибр: 03.04.2023
Дата измерения: 03.04.2023от: Administrator
н: 1,3375Результат: OK
CVD: 12,00 ммOD
правый

Reference Image

Статус глаза

LS: Факический
Реф: ---VS: Стекловидное тело
VA: ---

LVC: Нелеченный

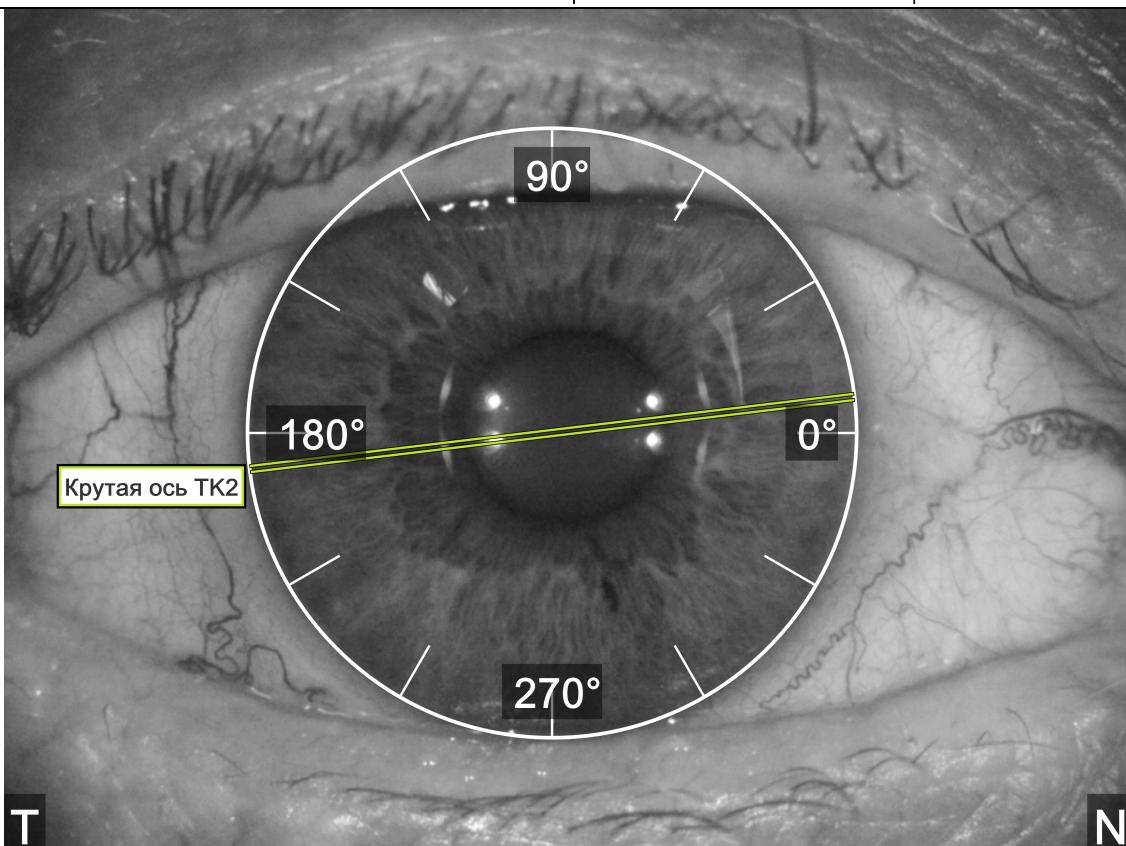AL: 23,56 мм
ACD: 2,88 мм
LT: 4,79 мм
WTW: 11,2 мм
P: 3,3 ммlx: +0,3 мм ly: +0,0 мм
CW-Chord: 0,2 мм @ 233°SE: 45,67 дптр
K1: 44,85 дптр @ 97°
— K2: 46,53 дптр @ 7°
ΔK: -1,68 дптр @ 97°TSE: 45,57 дптр
TK1: 44,58 дптр @ 97°
— TK2: 46,61 дптр @ 7°
ΔTK: -2,03 дптр @ 97°

(!) значение на границе нормы

(*) значение отредактировано вручную

--- нет результата измерения

Комментарий



Пациент

NIDZIEVA V

Дата рожд.
Ид пациента22.02.1946
503141

Пол

Женский

Врач

Surgeon

Оператор

Administrator

ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза"
Диагностика
ул. им. Землячки, 80
г. Волгоград
8-844-291-35-35Дата проверки калибр: 03.04.2023
Дата измерения: 03.04.2023от: Administrator
н: 1,3375Результат: OK
CVD: 12,00 мм

Reference Image


OS
левый

Статус глаза

LS: Факический
Реф: ---VS: Стекловидное тело
VA: ---

LVC: Нелеченный

Биометрические показатели

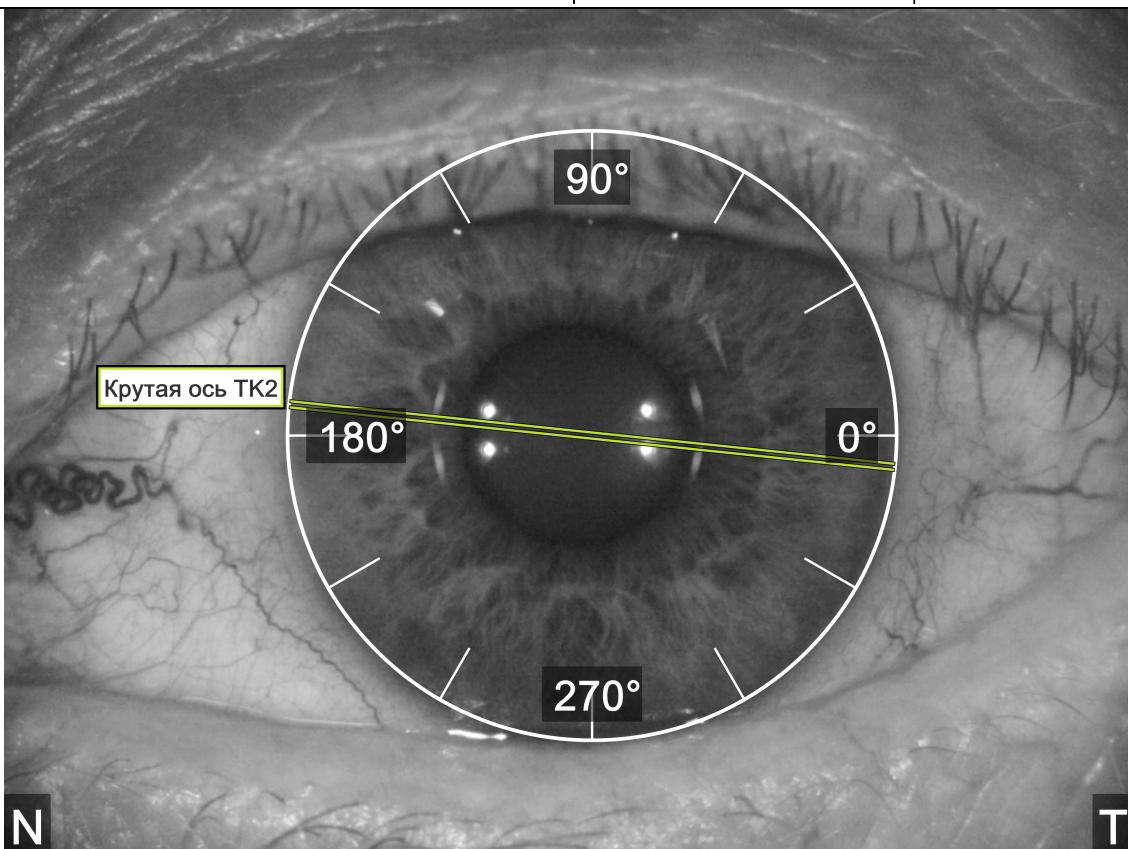AL: 23,27 мм
ACD: 2,85 мм
LT: 4,74 мм
WTW: 11,1 мм
P: 3,4 ммlx: -0,4 мм ly: +0,2 мм
CW-Chord: 0,1 мм @ 307°SE: 45,92 дптр
K1: 45,48 дптр @ 84°
— K2: 46,37 дптр @ 174°
ΔK: -0,89 дптр @ 84°TSE: 45,76 дптр
TK1: 45,22 дптр @ 84°
— TK2: 46,32 дптр @ 174°
ΔTK: -1,10 дптр @ 84°

(!) значение на границе нормы

(*) значение отредактировано вручную

--- нет результата измерения

Комментарий

