



Admisión en "Triat"  
Estado del monitor: Activado  
ID del Monitor: M2702A  
Estado del registrador: Activado  
Modo FCF1: US  
Modo FCF2: no transductor  
Modo FCF3: no transductor  
Estado del FMP: Activado  
Modo Toco: externo  
AJUSTES DE ALARMAS PARA  
PACIENTE

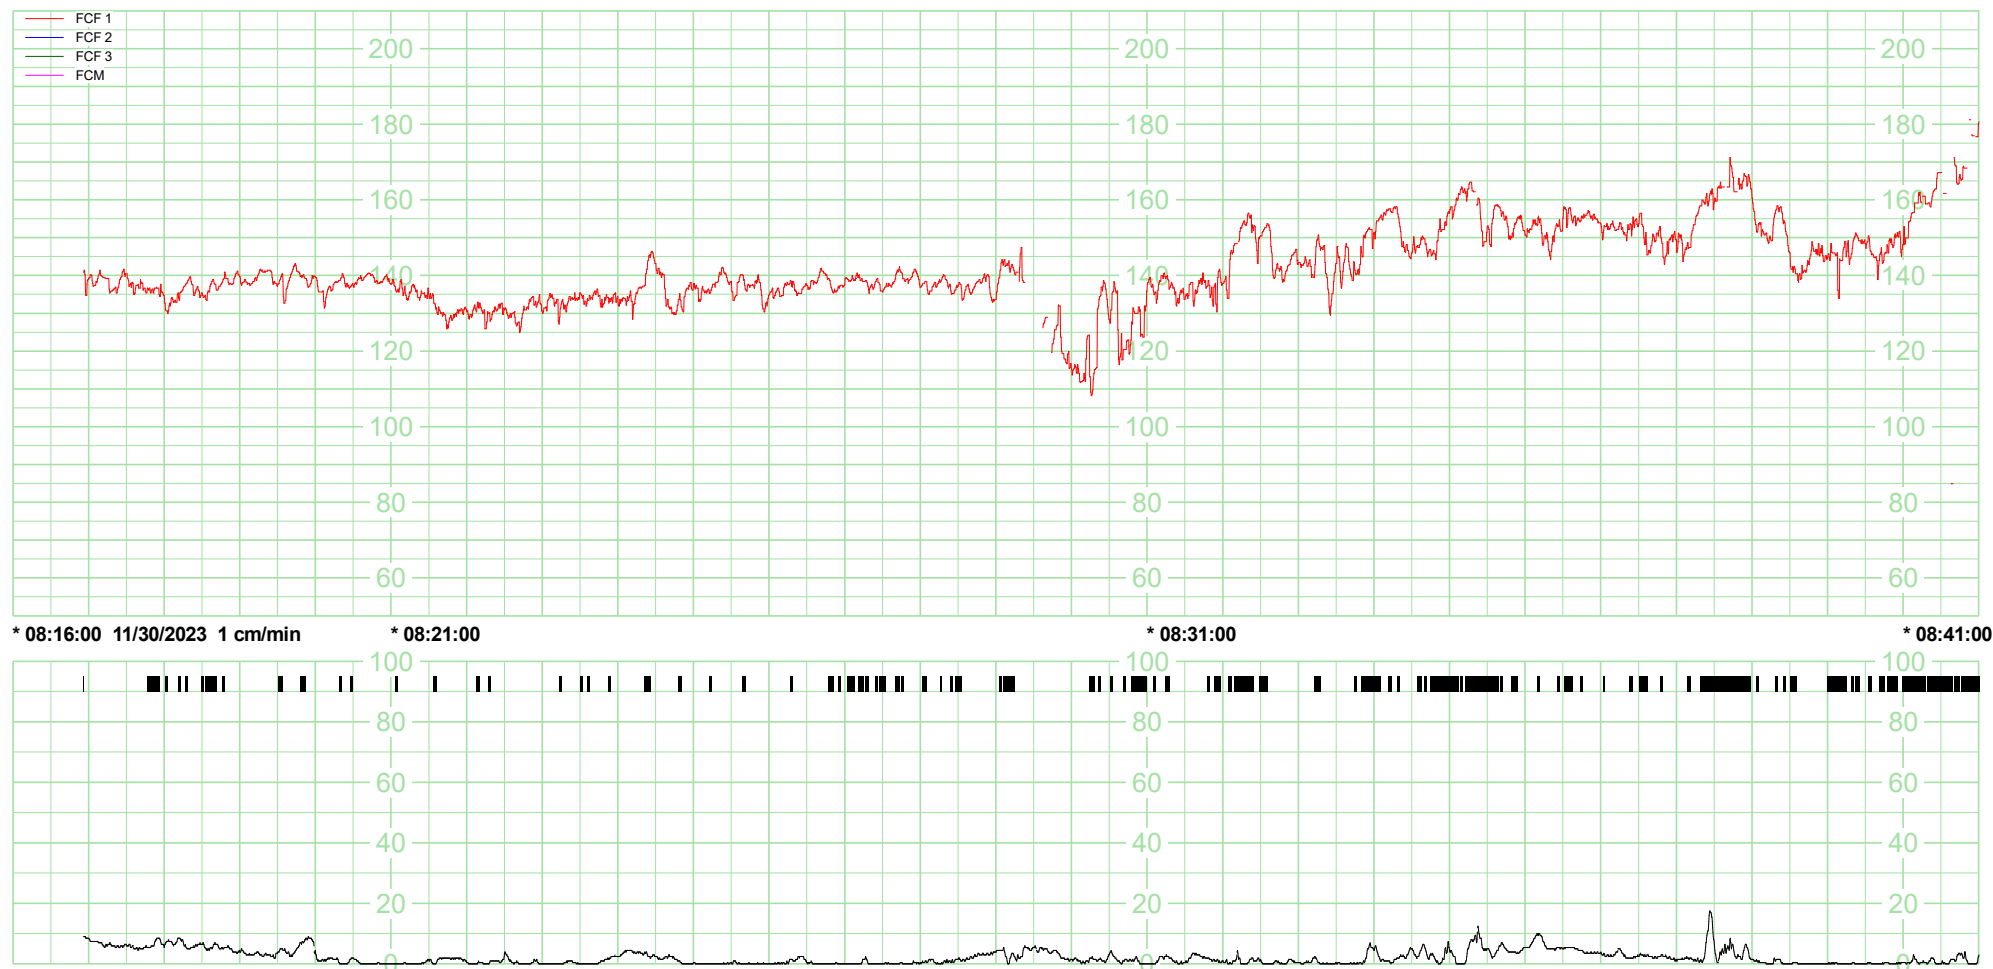


— \* FCF1: PERDIDA SEÑAL

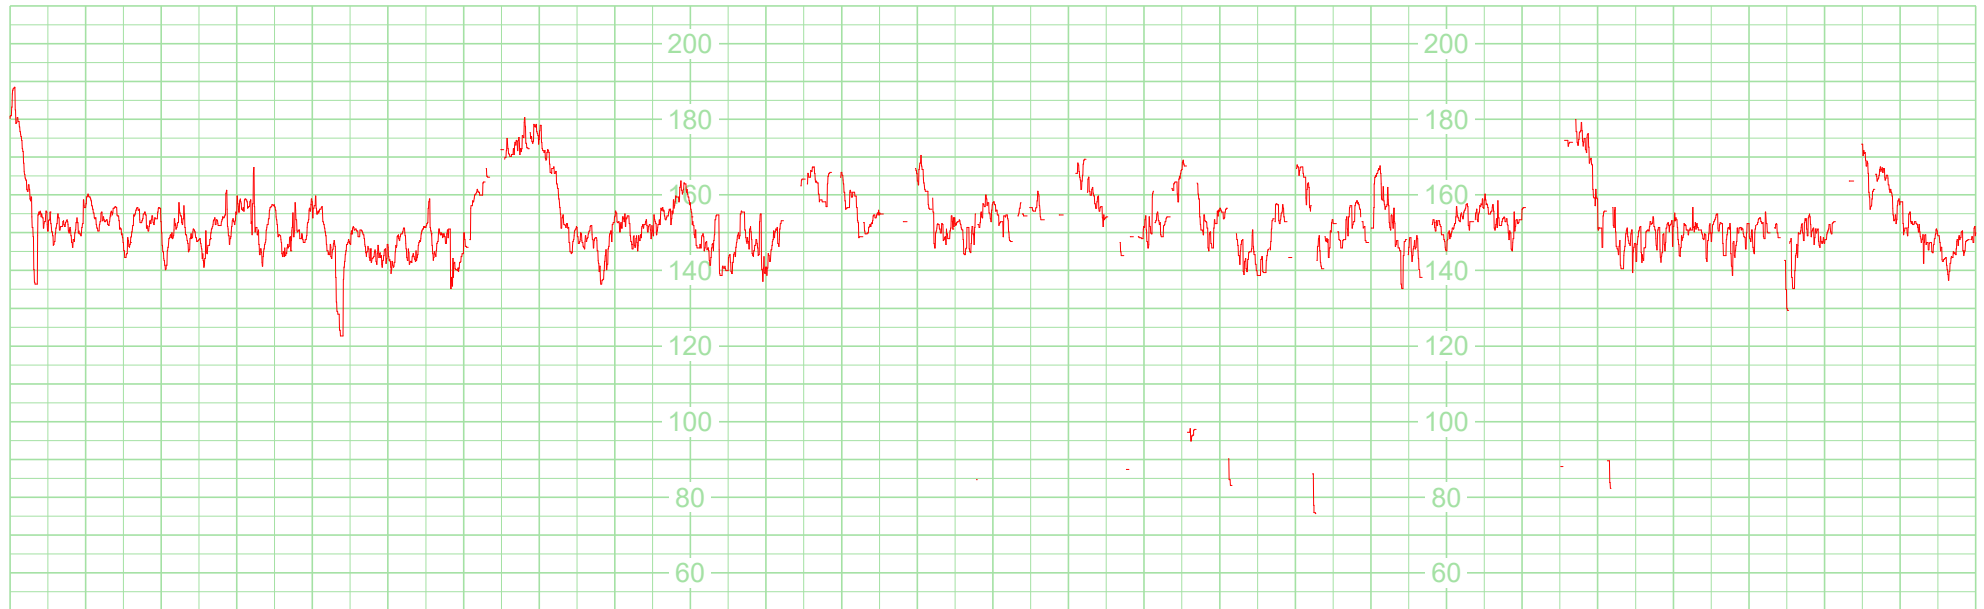


\* 08:51:00 11/30/2023 1 cm/min


\* 09:01:00

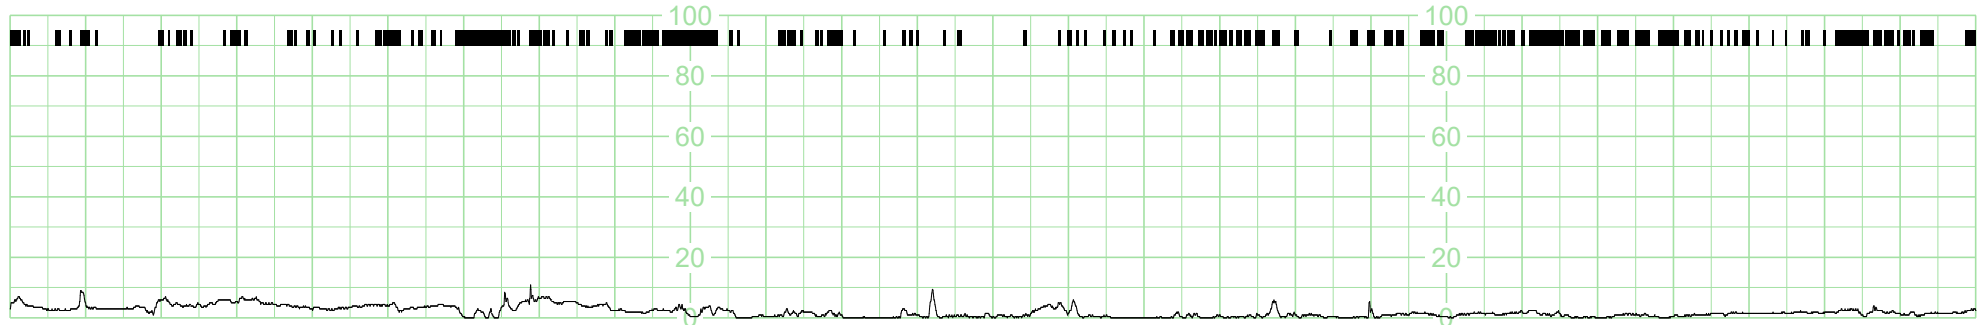

Estado del monitor: En espera  
Modo FCF1: no transductor  
Modo Toco: no transductor  
Estado del registrador: Desactivado

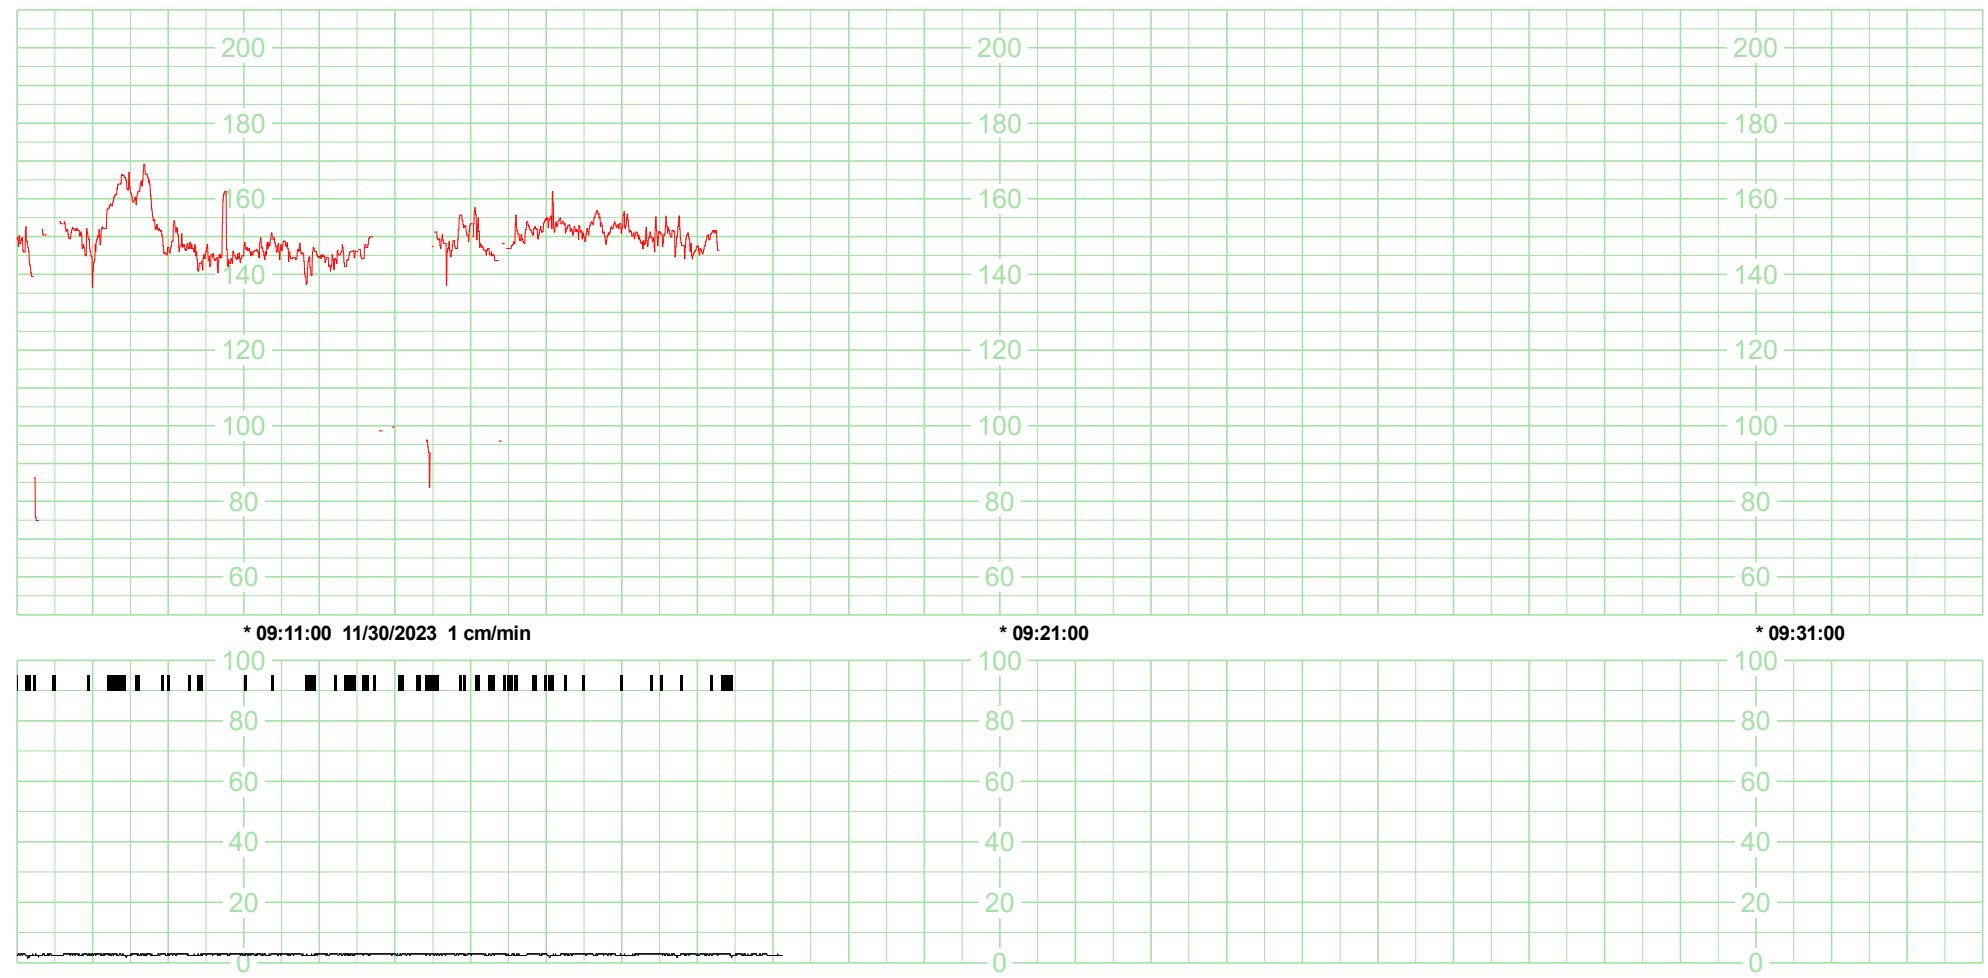

Estado del monitor: Activado  
Modo FCF1: US  
Modo Toco: externo  
Estado del registrador: Activado  
Estado del FMP: Activado

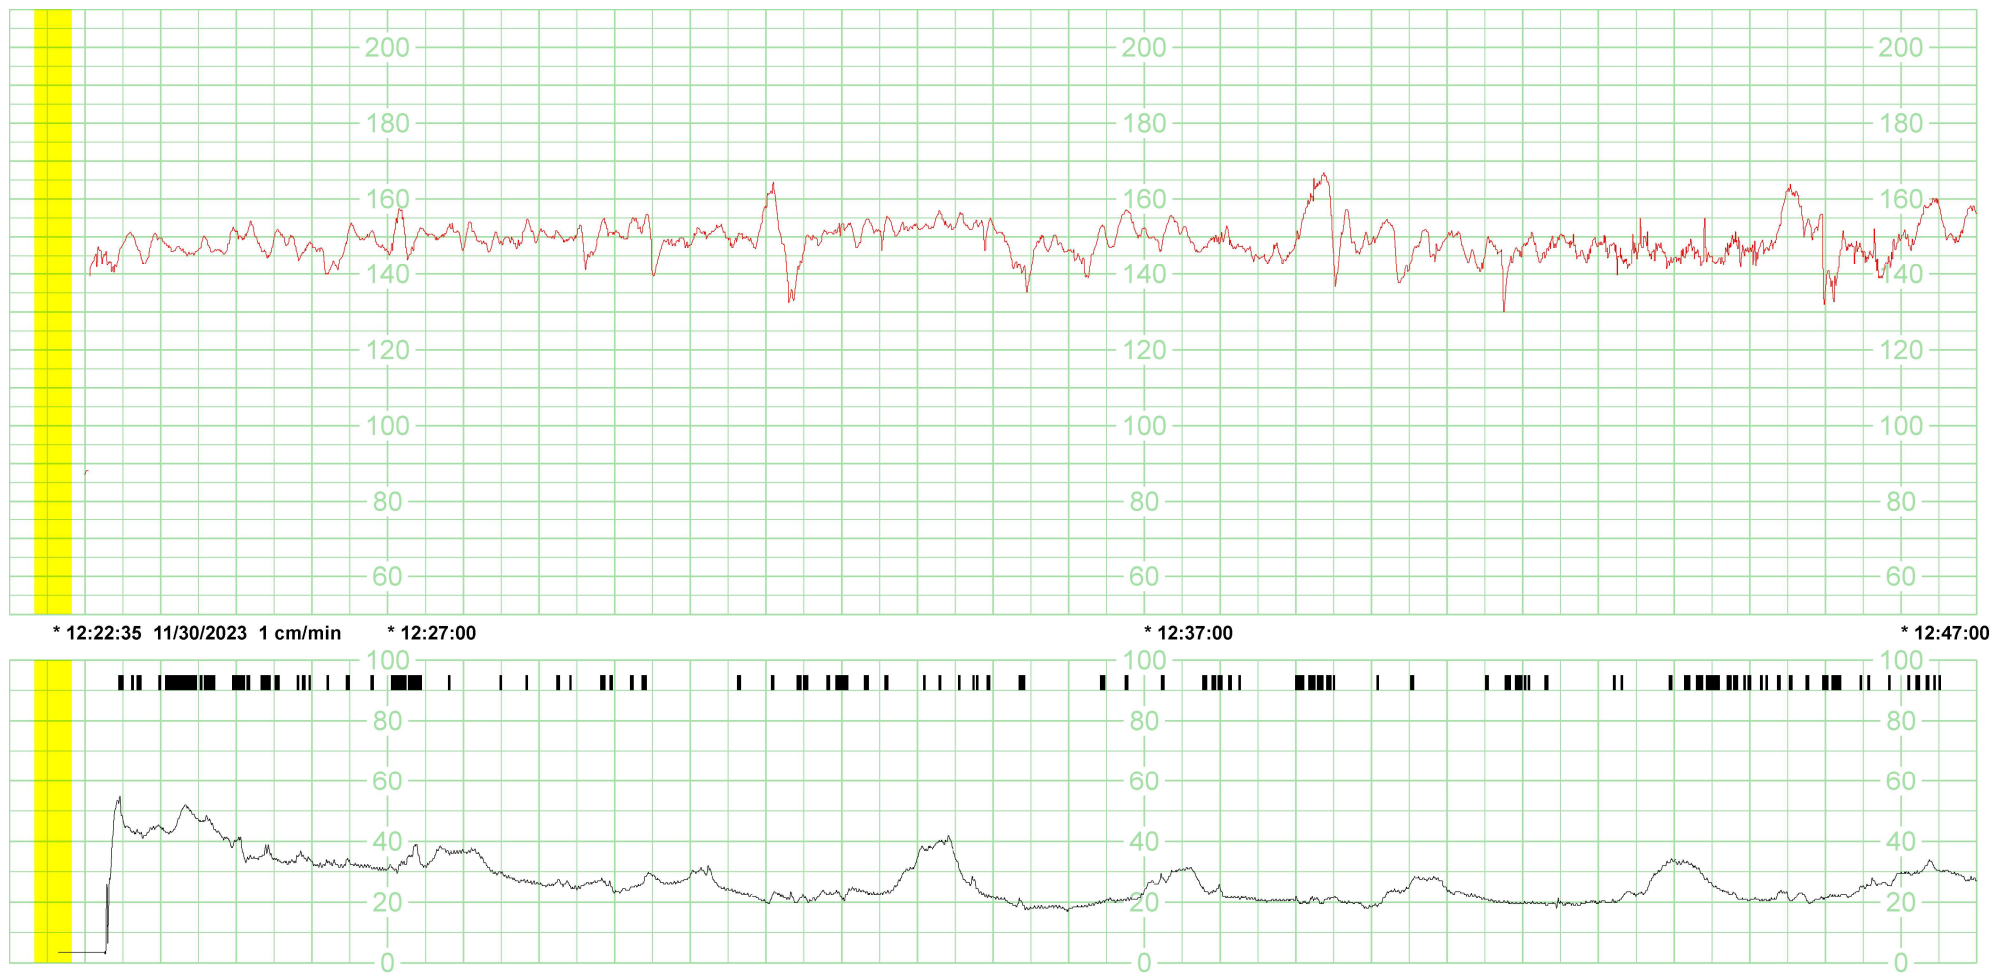

Estado del monitor: Desactivado

