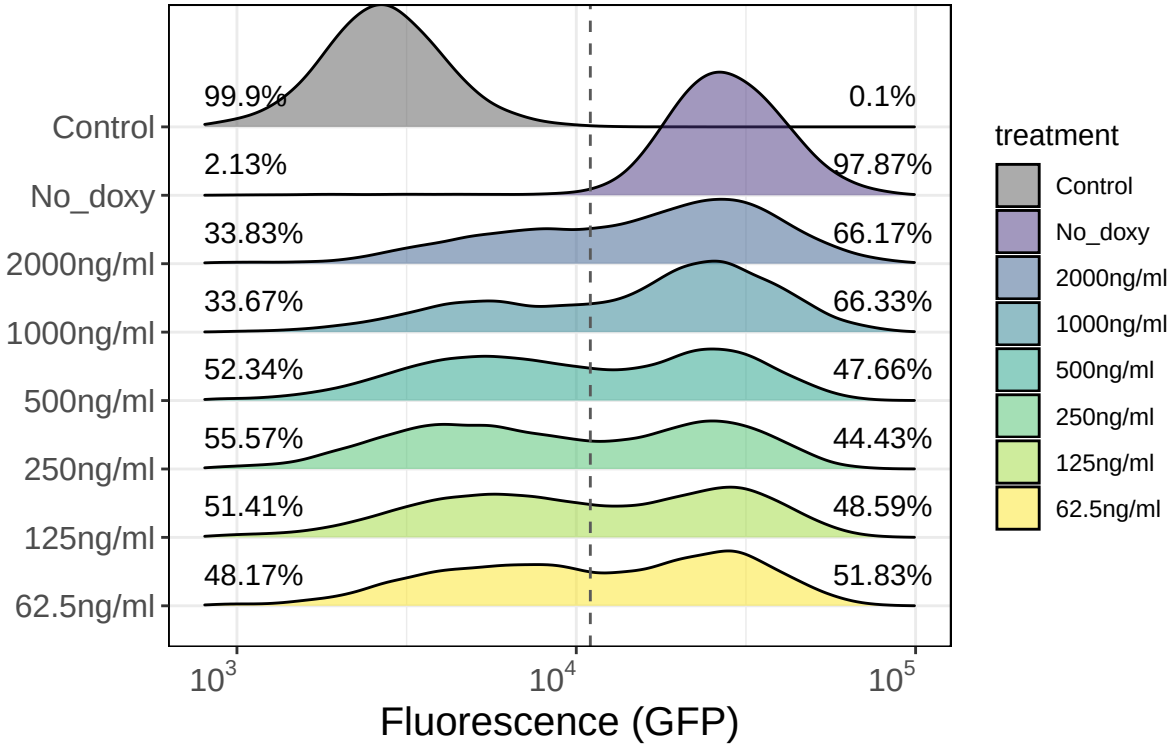
Control
No_doxy
2000ng/ml
1000ng/ml
500ng/ml
250ng/ml
125ng/ml
62.5ng/ml
99.9%
0.1%
2.13%
97.87%
33.83%
66.17%
33.67%
66.33%
52.34%
47.66%
55.57%
44.43%
51.41%
48.59%
48.17%
51.83%
$10^3$
$10^4$
$10^5$
Fluorescence (GFP)
treatment
Control
No_doxy
2000ng/ml
1000ng/ml
500ng/ml
250ng/ml
125ng/ml
62.5ng/ml