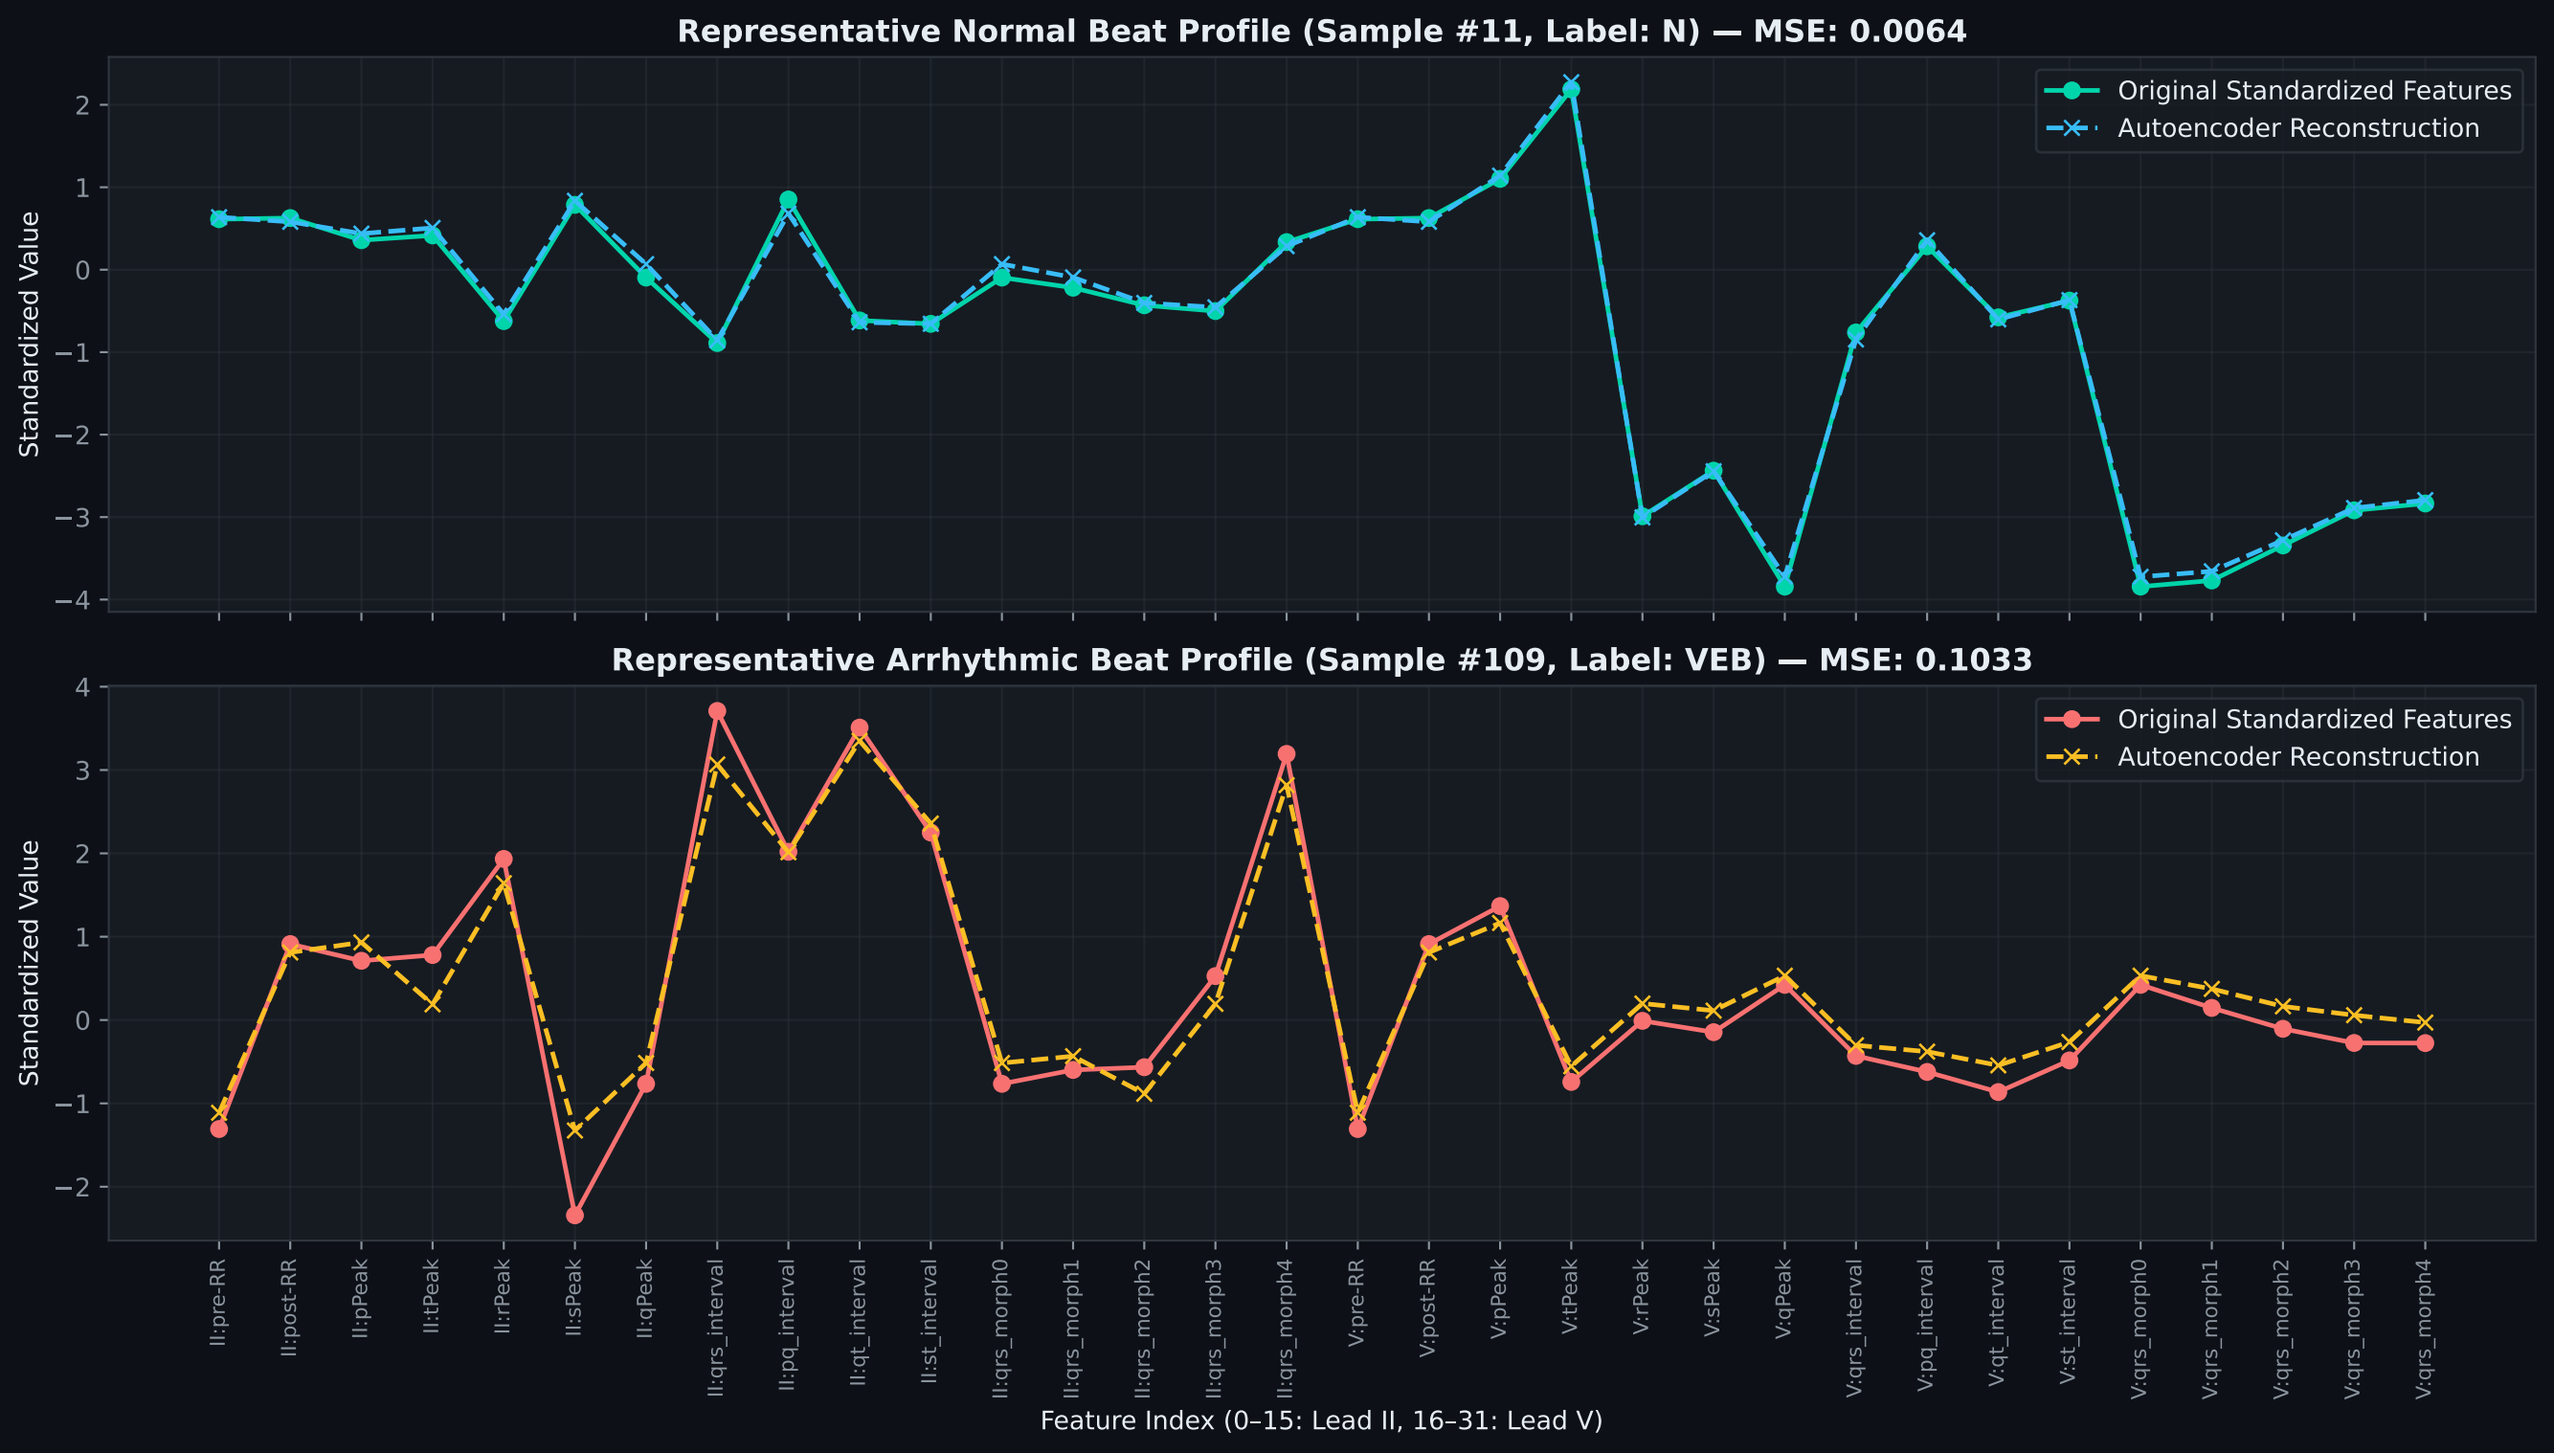
Representative Normal Beat Profile (Sample #11, Label: N) — MSE: 0.0064
Original Standardized Features
Autoencoder Reconstruction
Standardized Value
Representative Arrhythmic Beat Profile (Sample #109, Label: VEB) — MSE: 0.1033
Original Standardized Features
Autoencoder Reconstruction
Standardized Value
II:pre-RR
II:post-RR
II:pPeak
II:tPeak
II:rPeak
II:sPeak
II:qPeak
II:qrs_interval
II:pq_interval
II:qt_interval
II:st_interval
II:qrs_morph0
II:qrs_morph1
II:qrs_morph2
II:qrs_morph3
II:qrs_morph4
V:pre-RR
V:post-RR
V:pPeak
V:tPeak
V:rPeak
V:sPeak
V:qPeak
V:qrs_interval
V:pq_interval
V:qt_interval
V:st_interval
V:qrs_morph0
V:qrs_morph1
V:qrs_morph2
V:qrs_morph3
V:qrs_morph4
Feature Index (0–15: Lead II, 16–31: Lead V)