Channel	Meaning
D6	Scheduler window
D3	Sensor task
D2	Cooling / actuator tasks
D1	Short task pulses

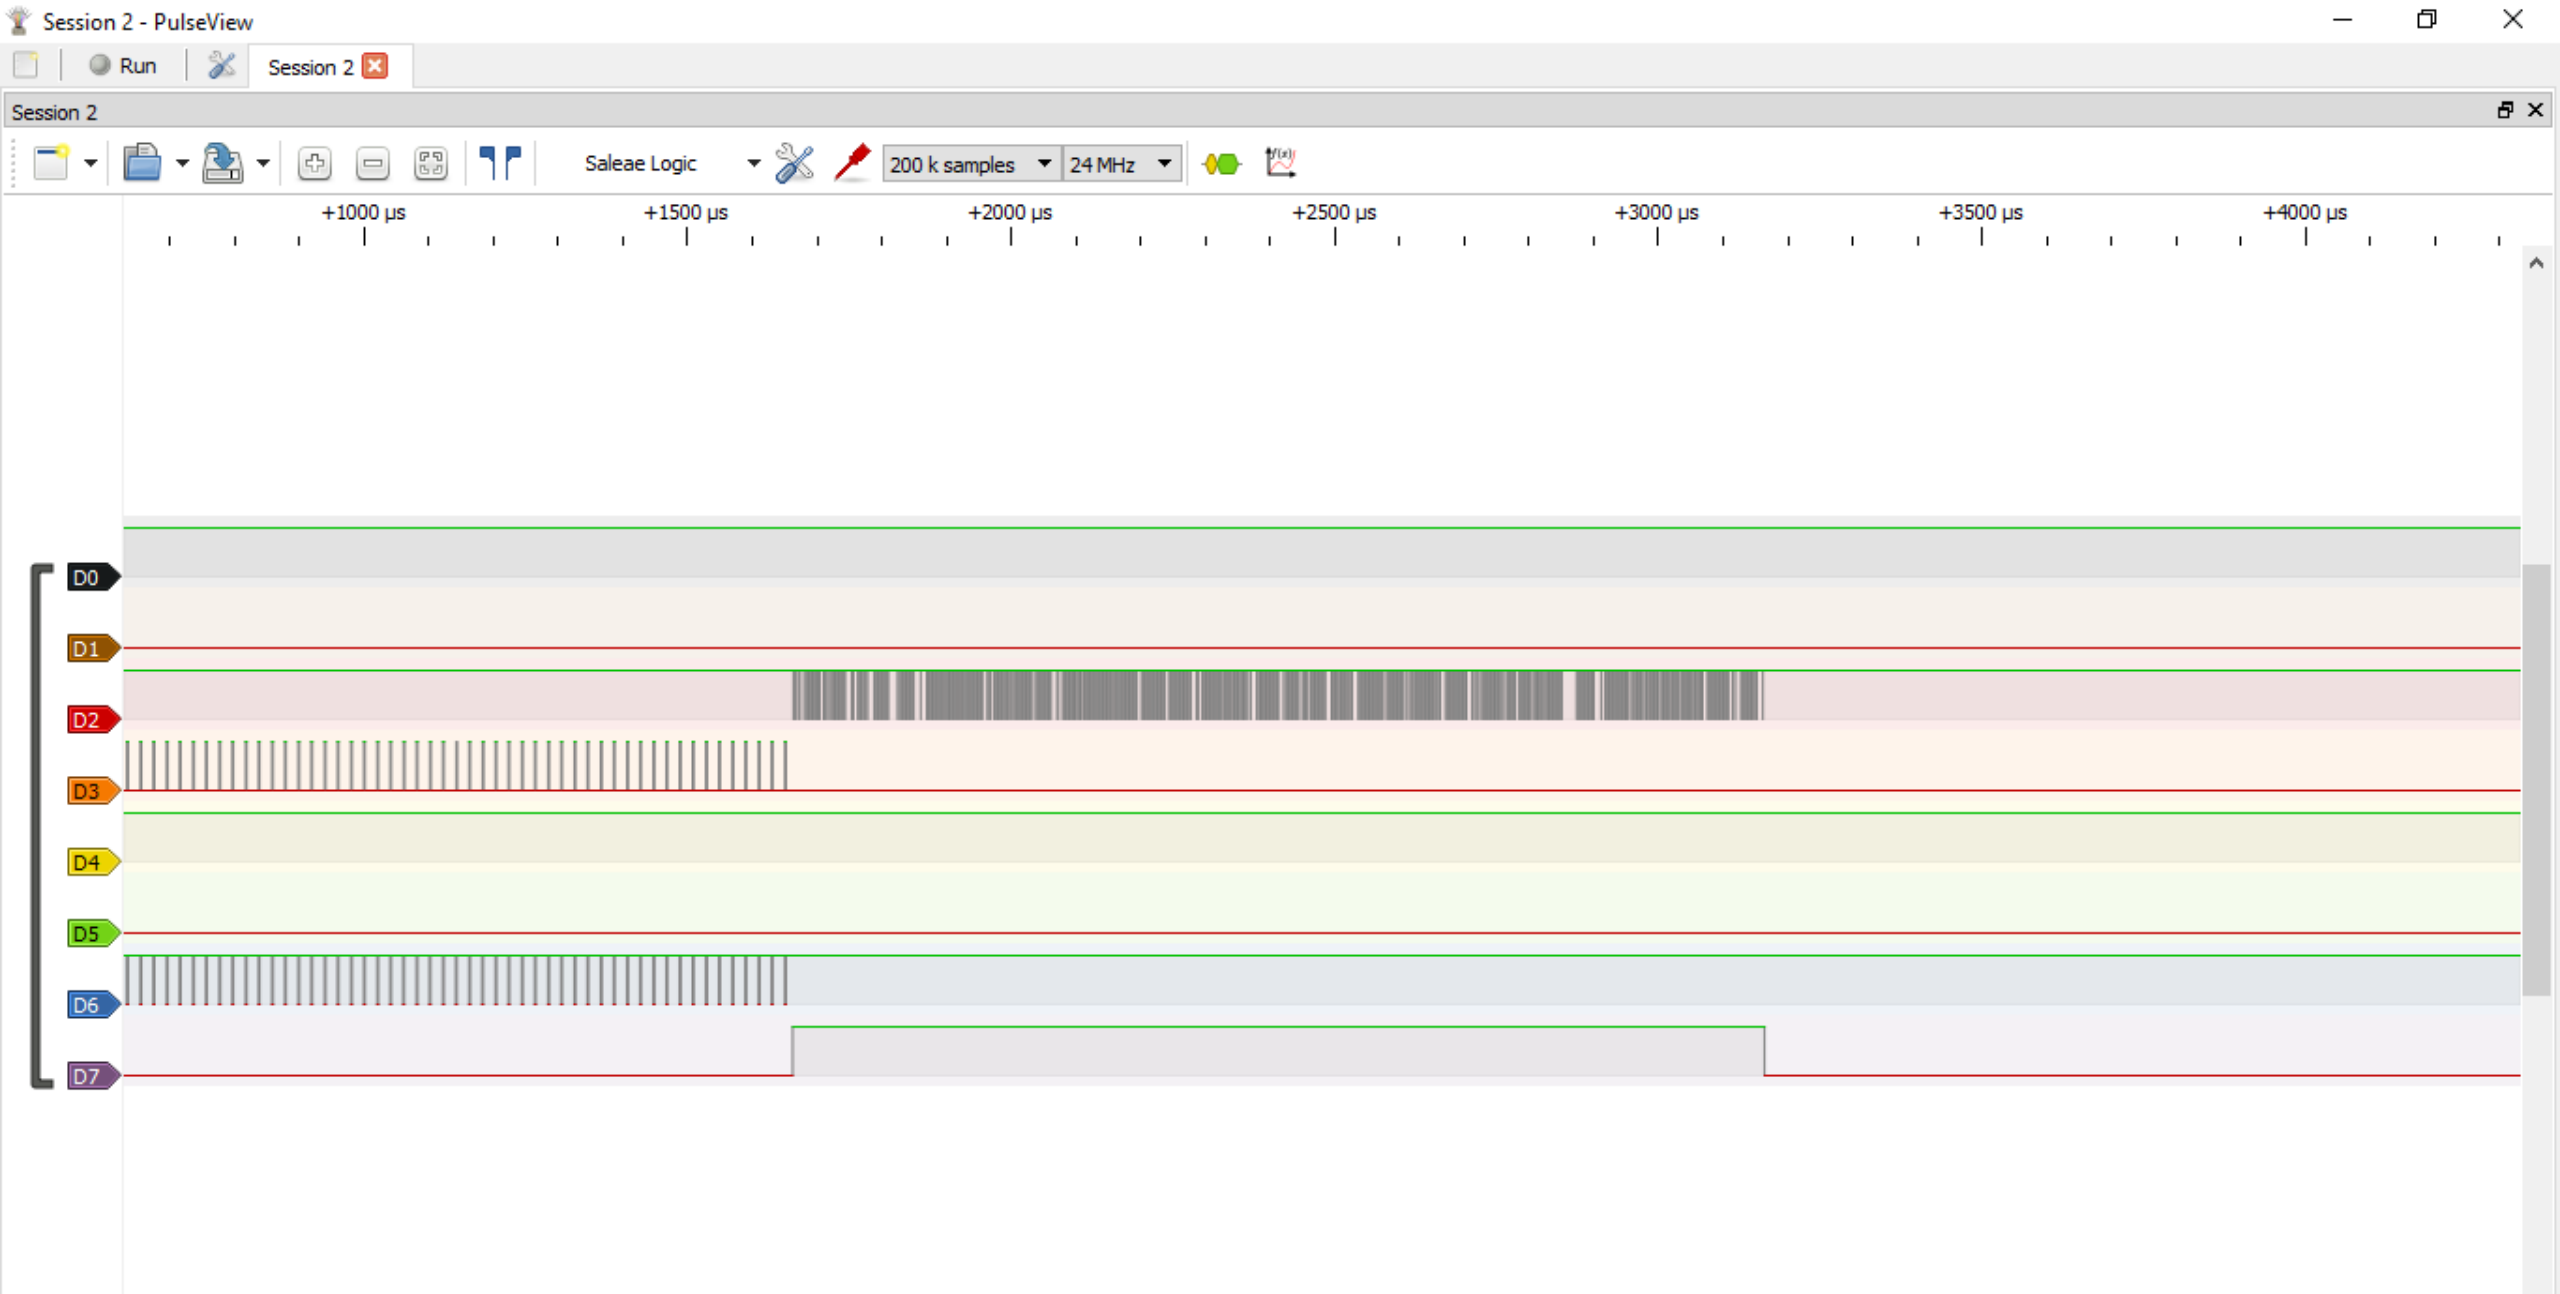
Session 2 - PulseView
Run
Session 2
Session 2
Saleae Logic
200 k samples
24 MHz
+1000 µs
+1500 µs
+2000 µs
+2500 µs
+3000 µs
+3500 µs
+4000 µs
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

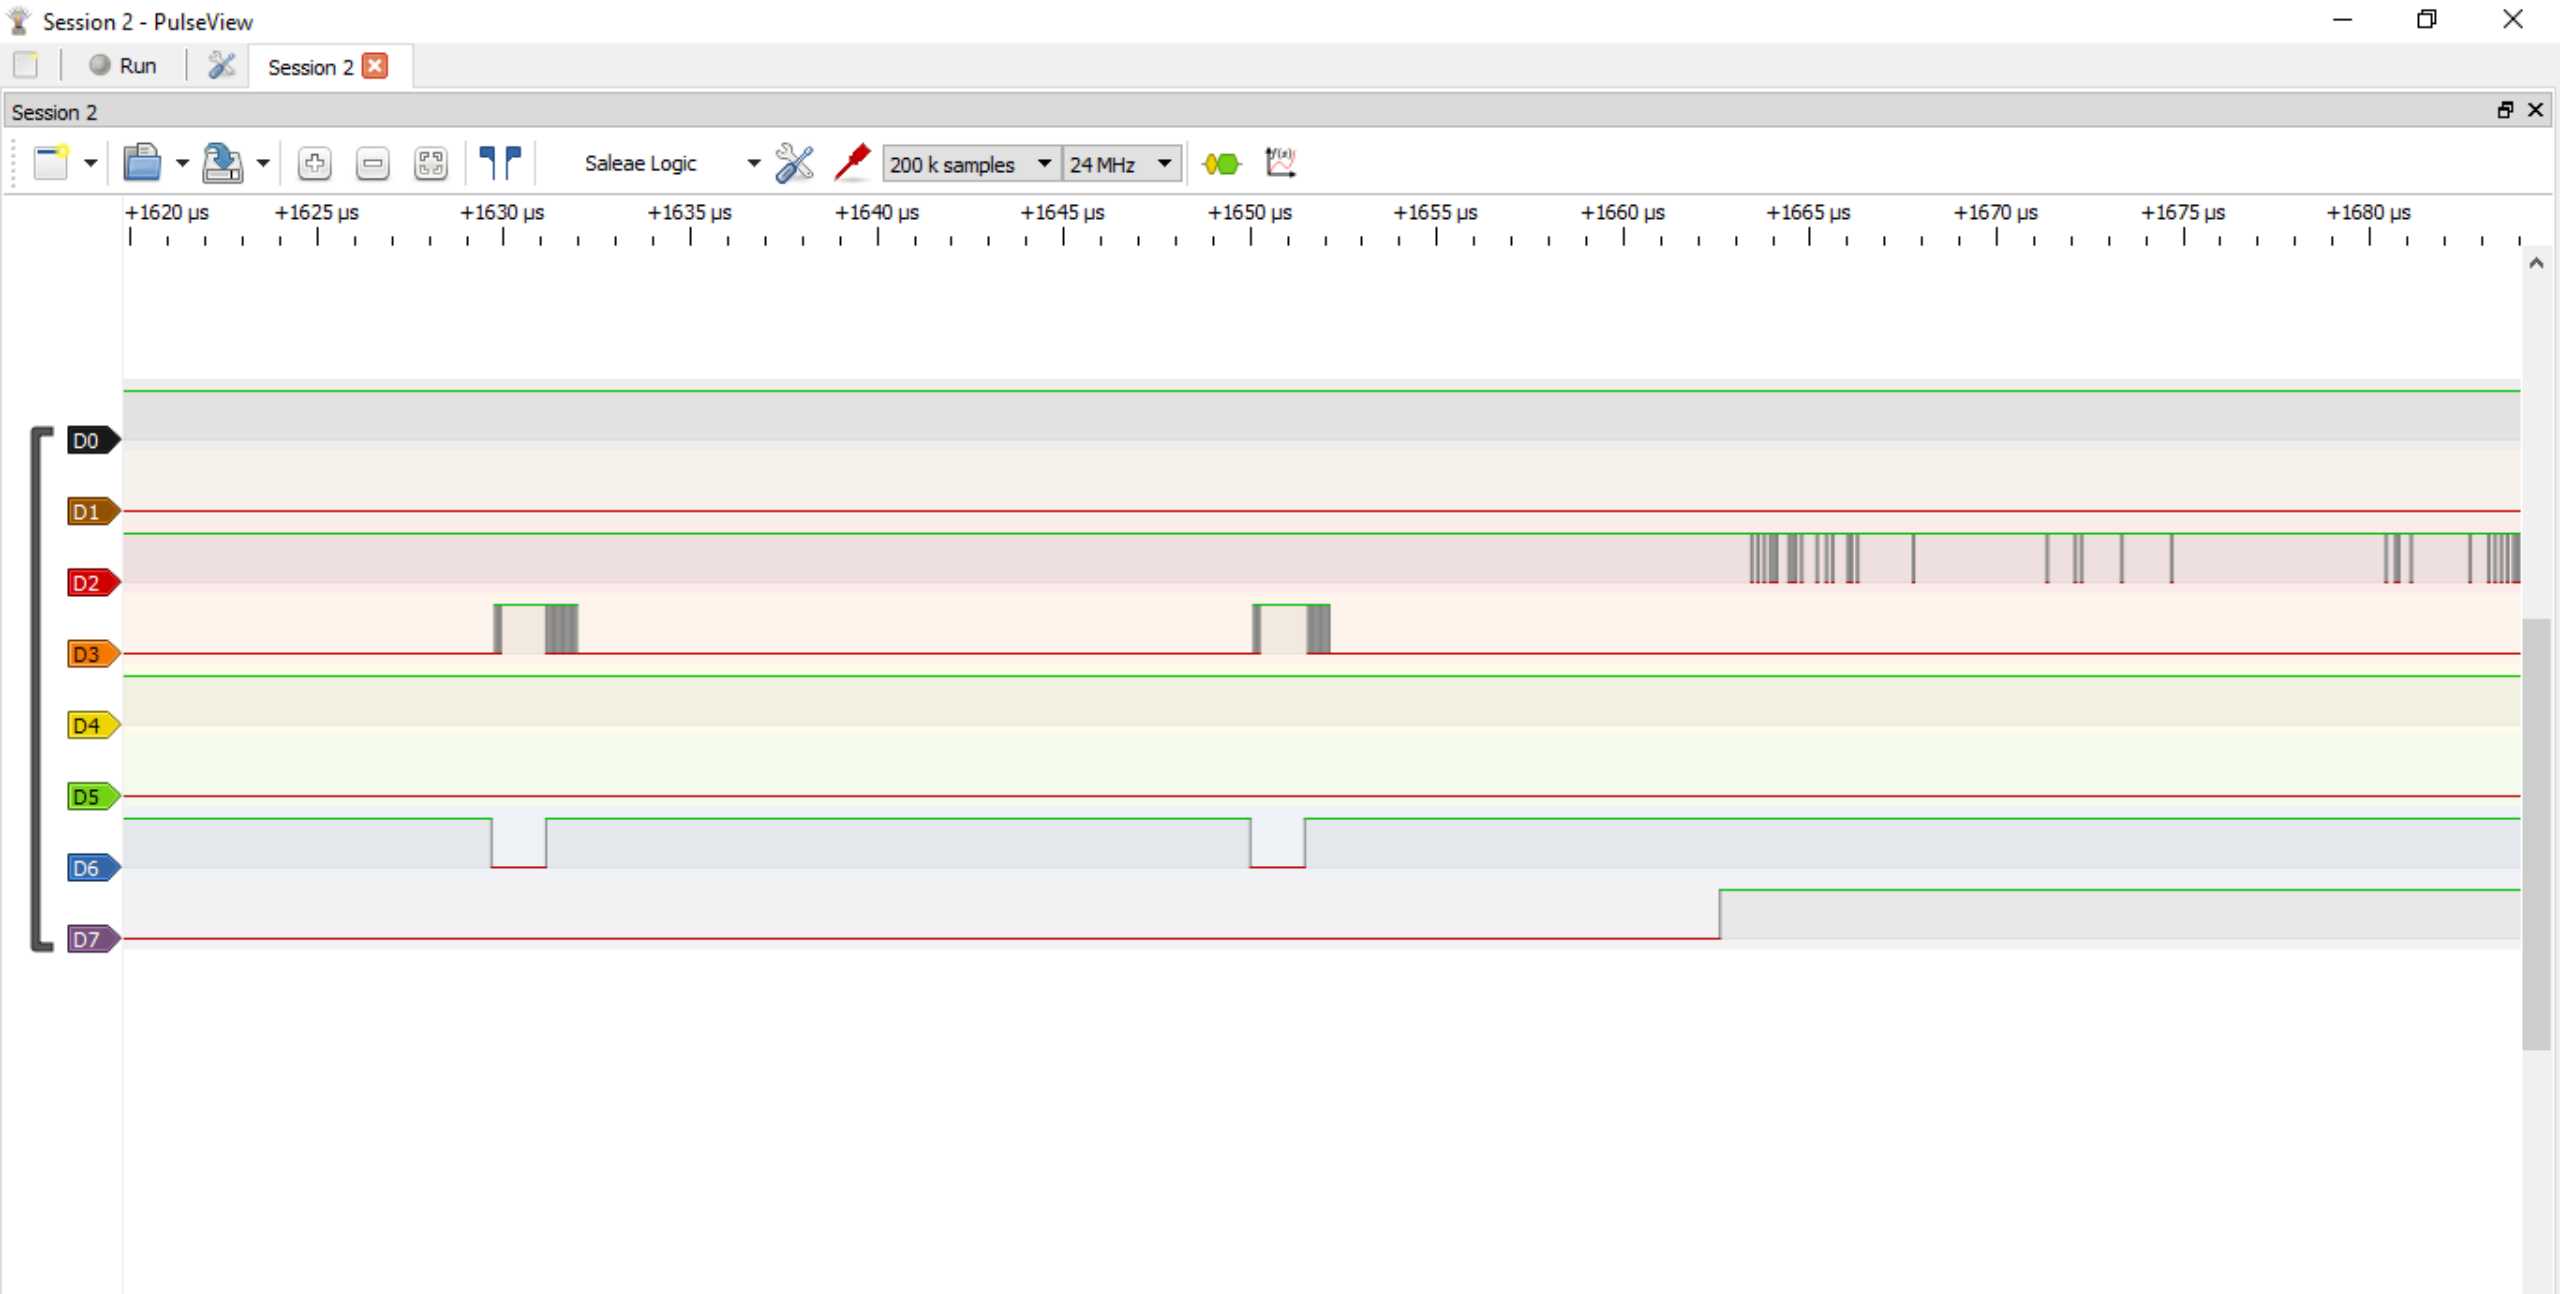
Session 2 - PulseView
Run
Session 2
Session 2
Saleae Logic
200 k samples
24 MHz
+1620 µs
+1625 µs
+1630 µs
+1635 µs
+1640 µs
+1645 µs
+1650 µs
+1655 µs
+1660 µs
+1665 µs
+1670 µs
+1675 µs
+1680 µs
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Session 2 - PulseView
Run
Session 2
Session 2
Saleae Logic
200 k samples
24 MHz
+1649500 ns
+1650000 ns
+1650500 ns
+1651000 ns
+1651500 ns
+1652000 ns
+1652500 ns
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

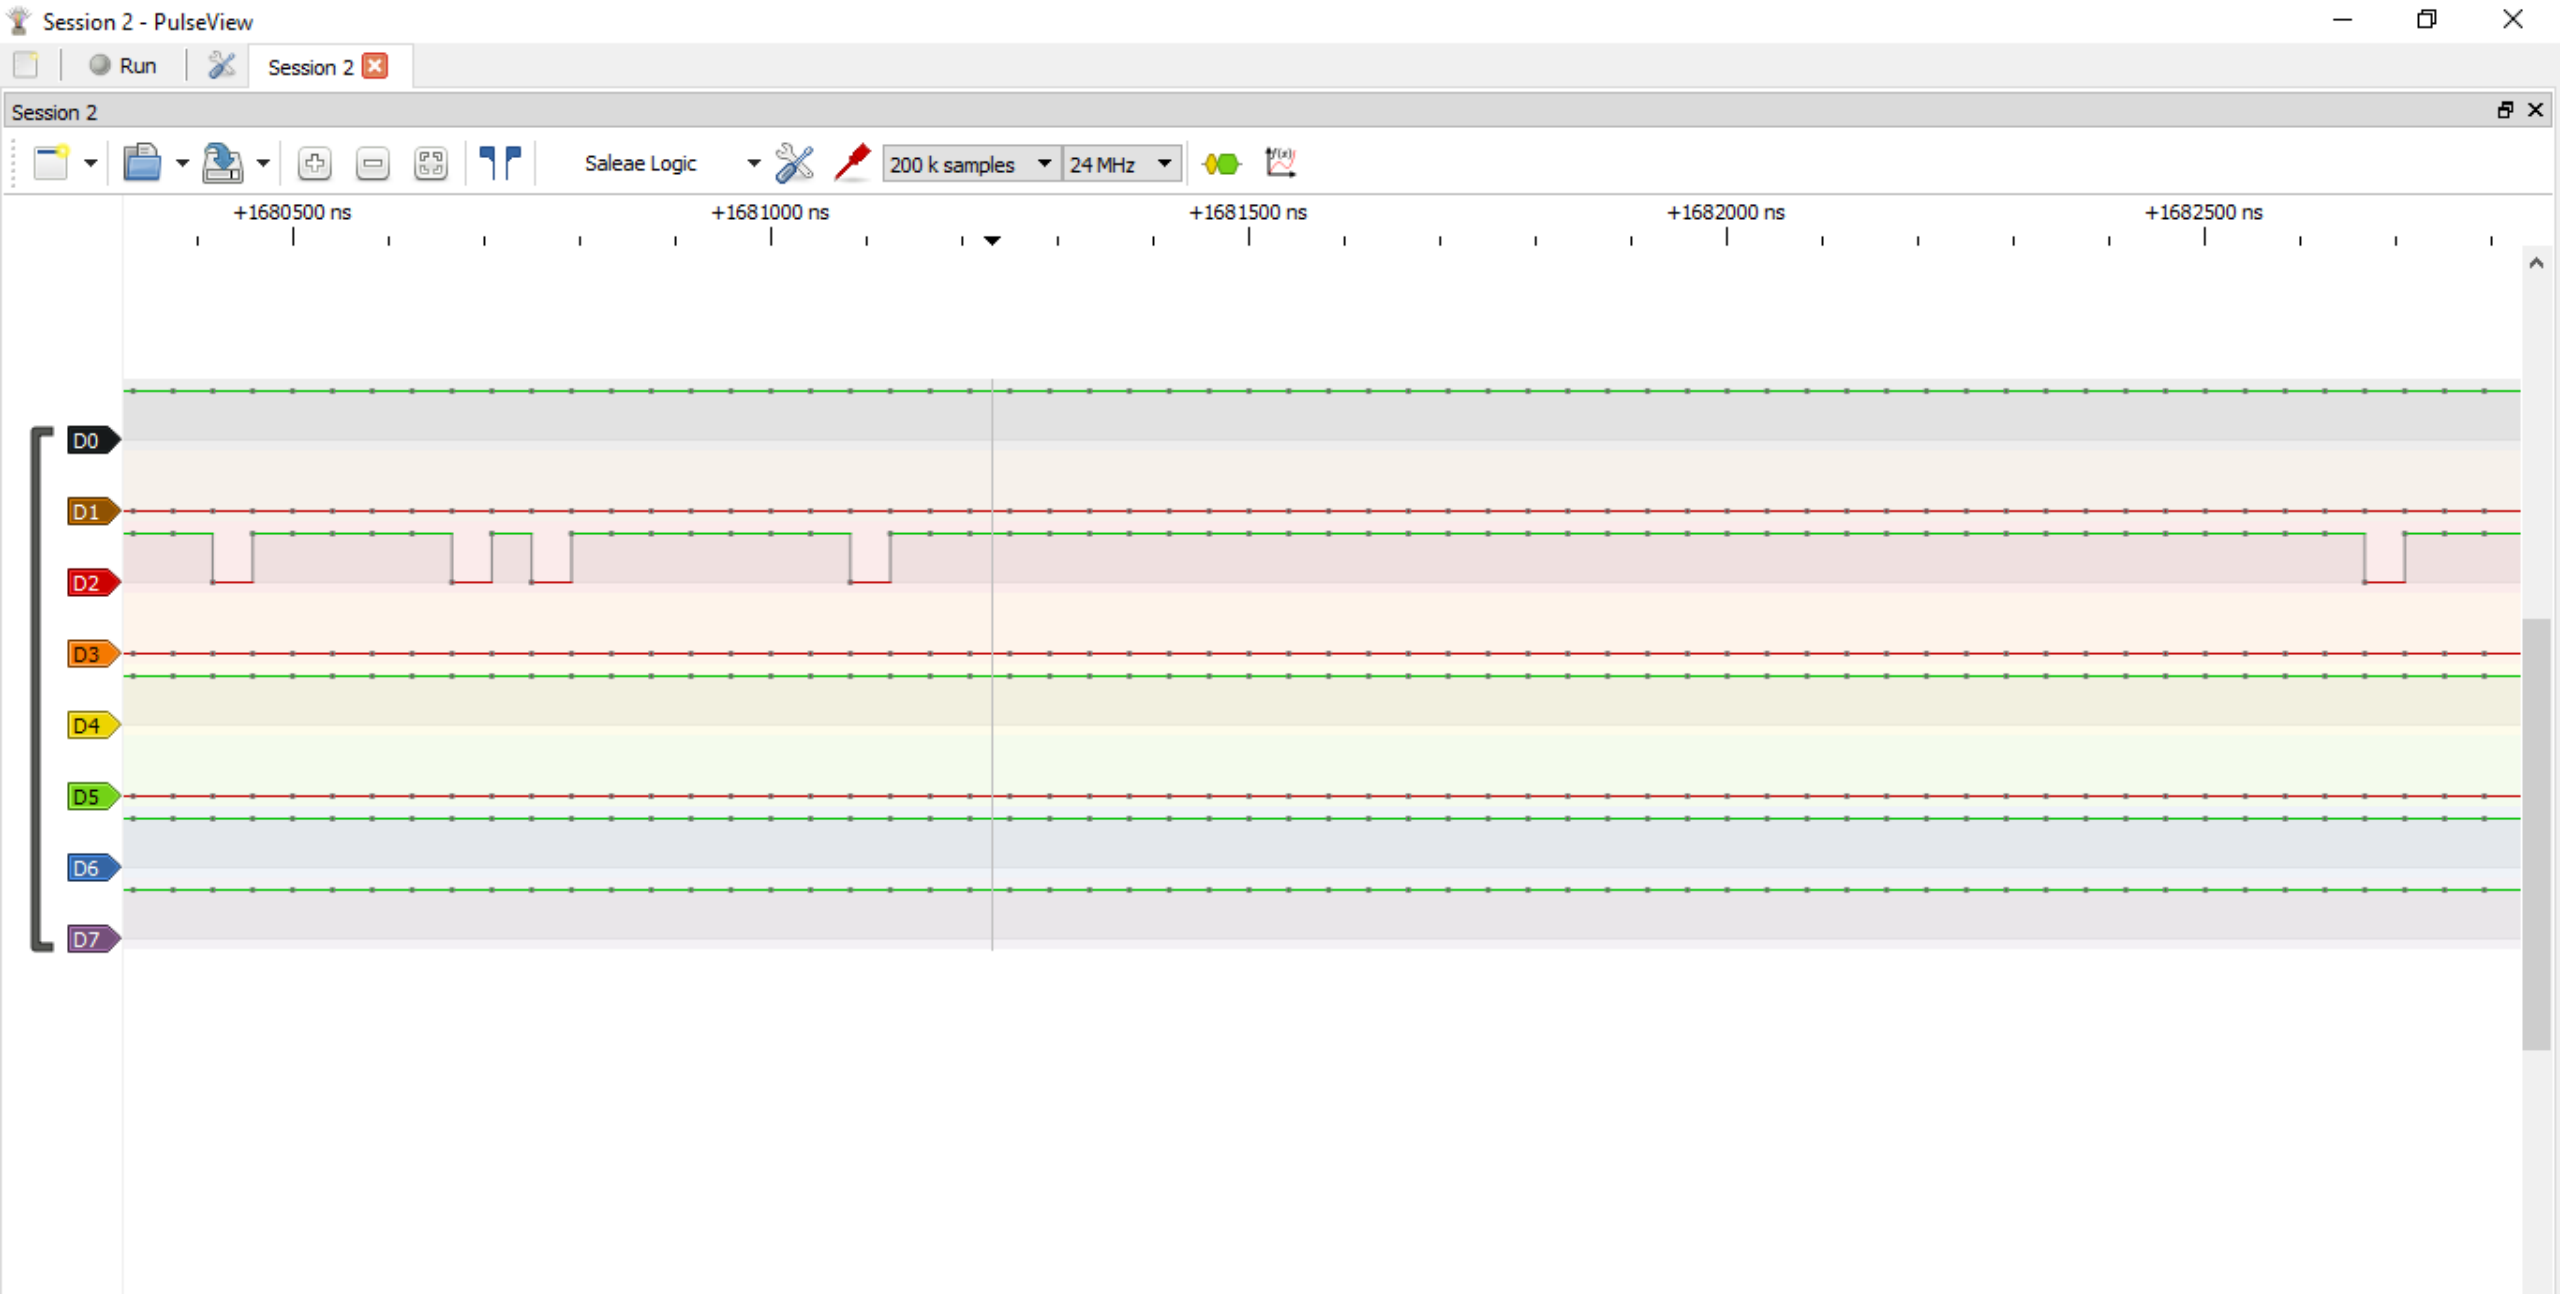
Session 2 - PulseView
Run
Session 2
Session 2
Saleae Logic
200 k samples
24 MHz
+1680500 ns
+1681000 ns
+1681500 ns
+1682000 ns
+1682500 ns
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7