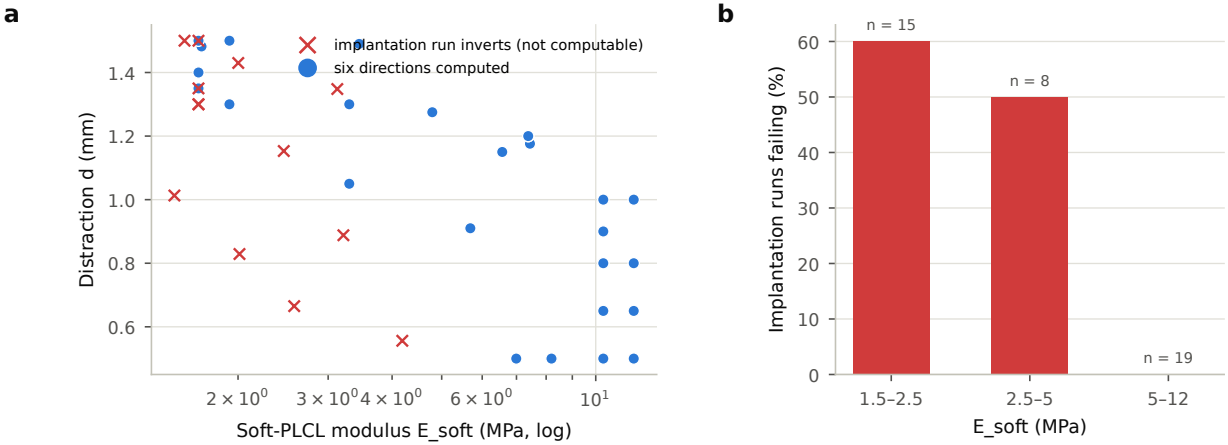
a
implantation run inverts (not computable)
six directions computed
Distraction d (mm)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
2 × 10^0
3 × 10^0
4 × 10^0
6 × 10^0
10^1
Soft-PLCL modulus E_soft (MPa, log)
b
n = 15
n = 8
n = 19
Implantation runs failing (%)
60
50
40
30
20
10
0
1.5–2.5
2.5–5
5–12
E_soft (MPa)