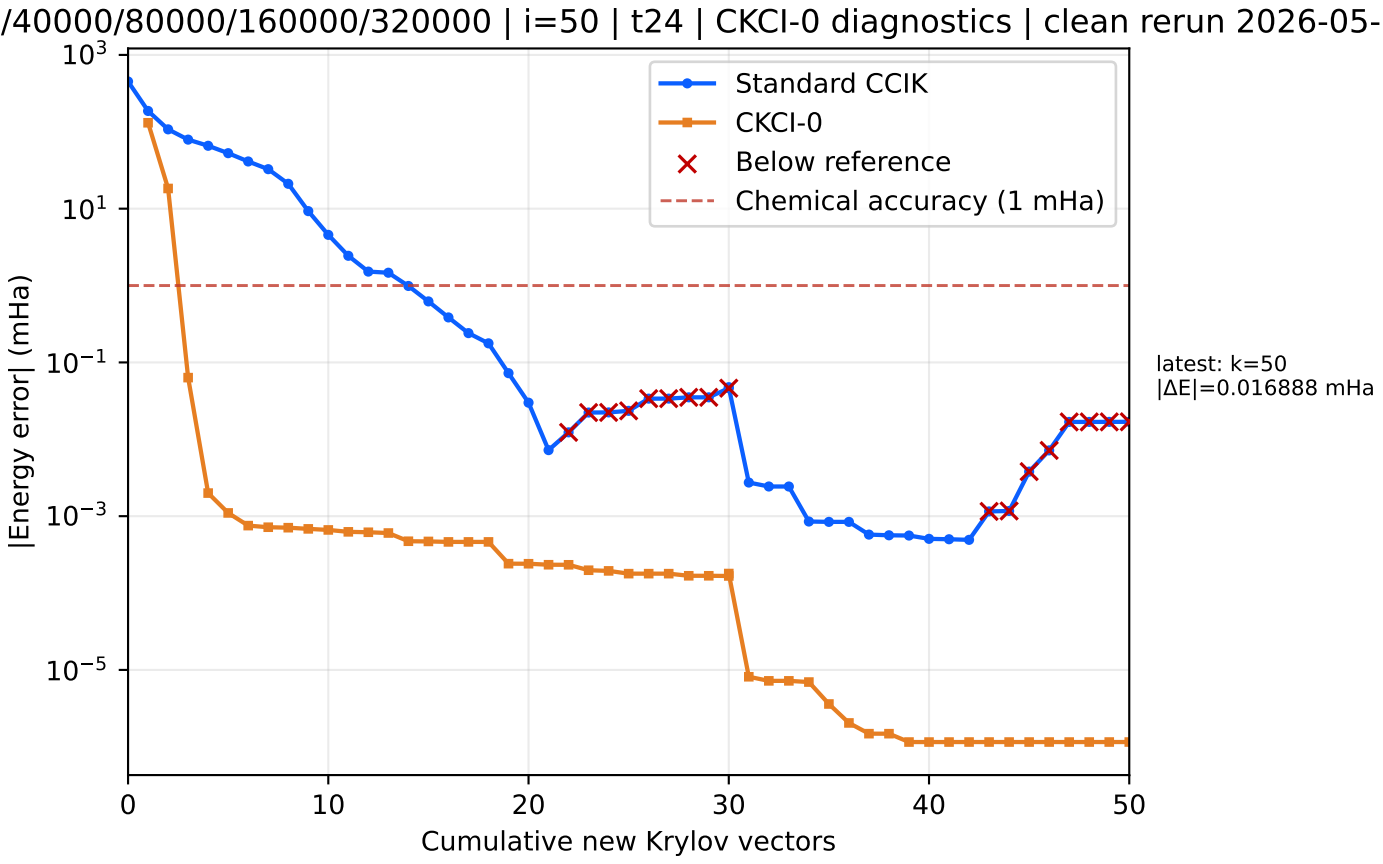
/40000/80000/160000/320000 | i=50 | t24 | CKCI-0 diagnostics | clean rerun 2026-05-
Standard CCIK
CKCI-0
Below reference
Chemical accuracy (1 mHa)
latest: k=50
|ΔE|=0.016888 mHa
|Energy error| (mHa)
Cumulative new Krylov vectors
10^{3}
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
0
10
20
30
40
50