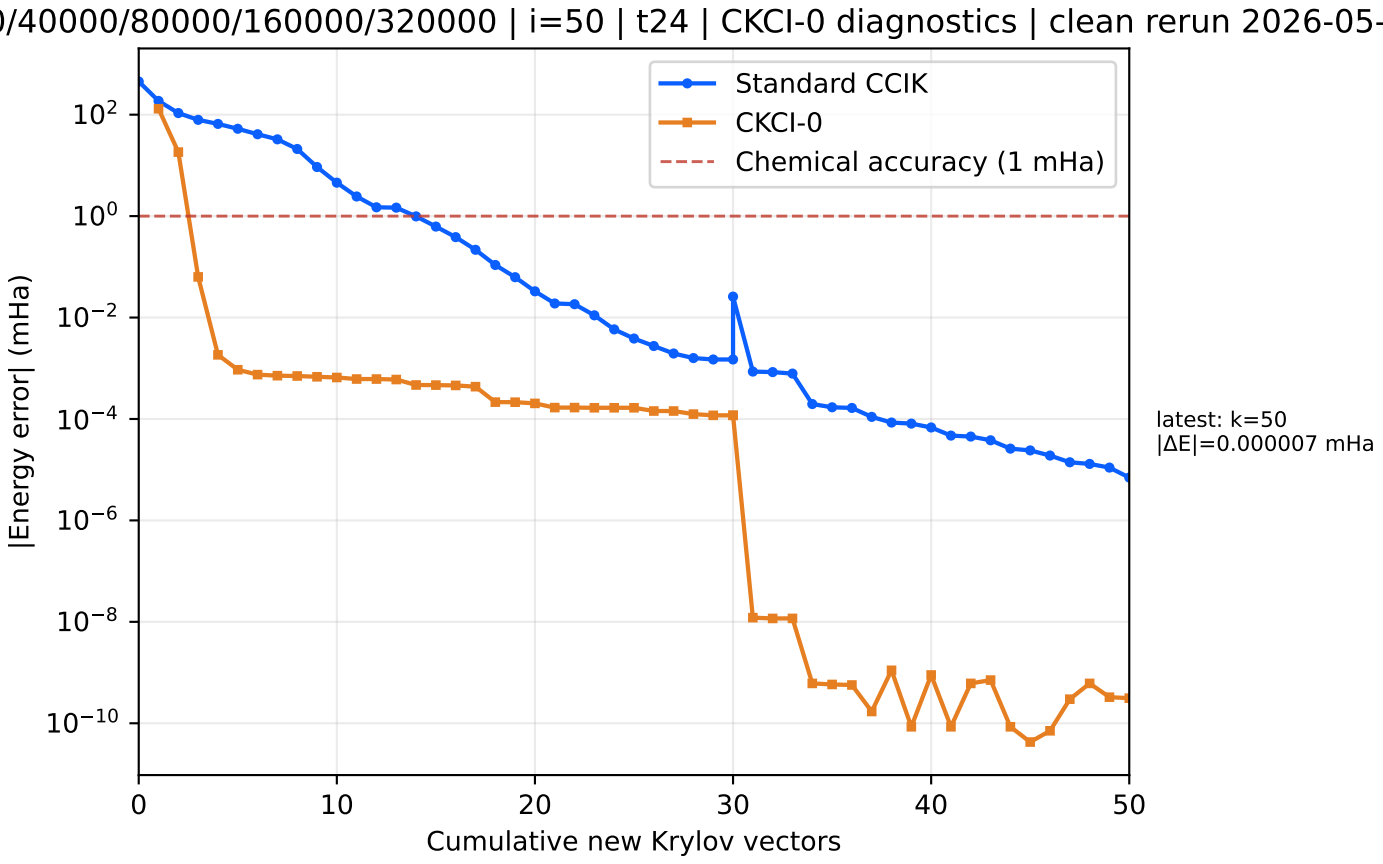
0/40000/80000/160000/320000 | i=50 | t24 | CKCI-0 diagnostics | clean rerun 2026-05-
Standard CCIK
CKCI-0
Chemical accuracy (1 mHa)
|Energy error| (mHa)
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
0
10
20
30
40
50
Cumulative new Krylov vectors
latest: k=50
|ΔE|=0.000007 mHa