

**elevation (1:5)**

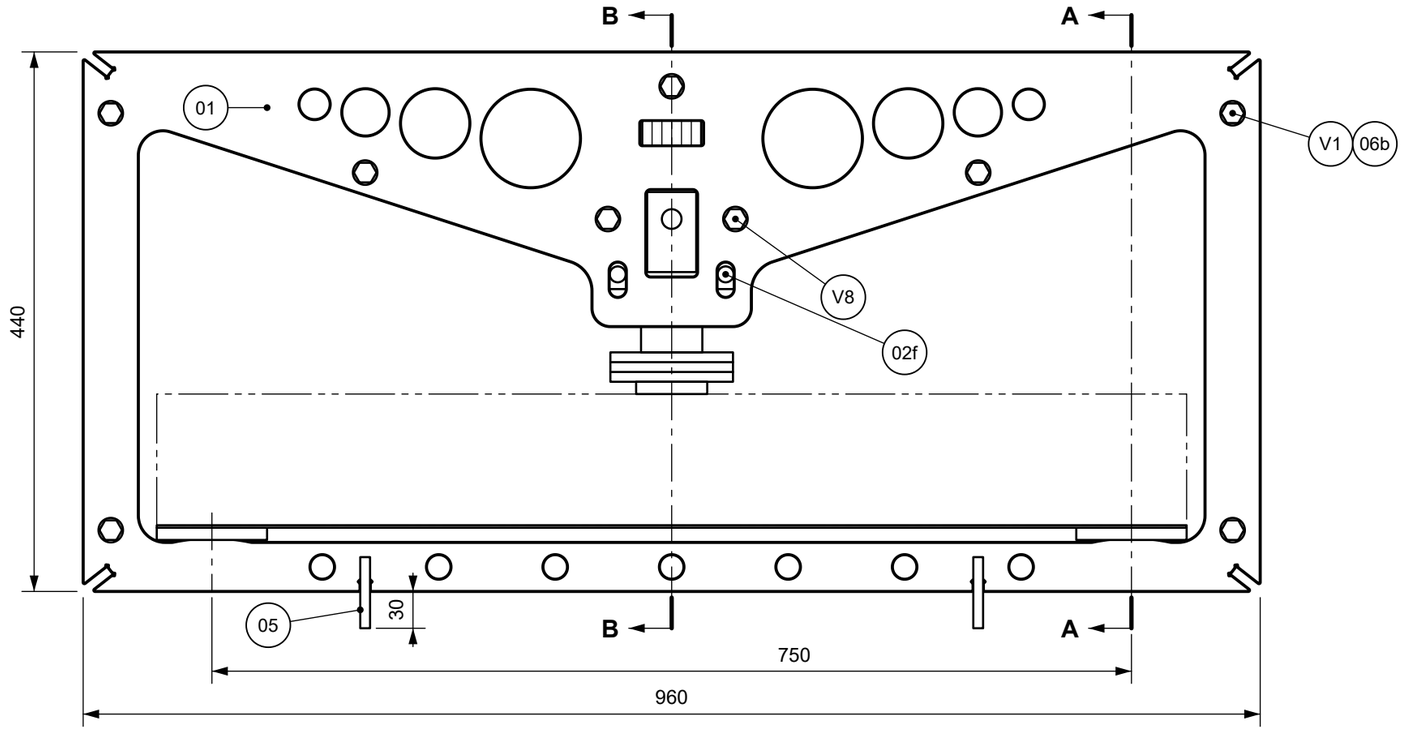



**perspective (sans echelle)**

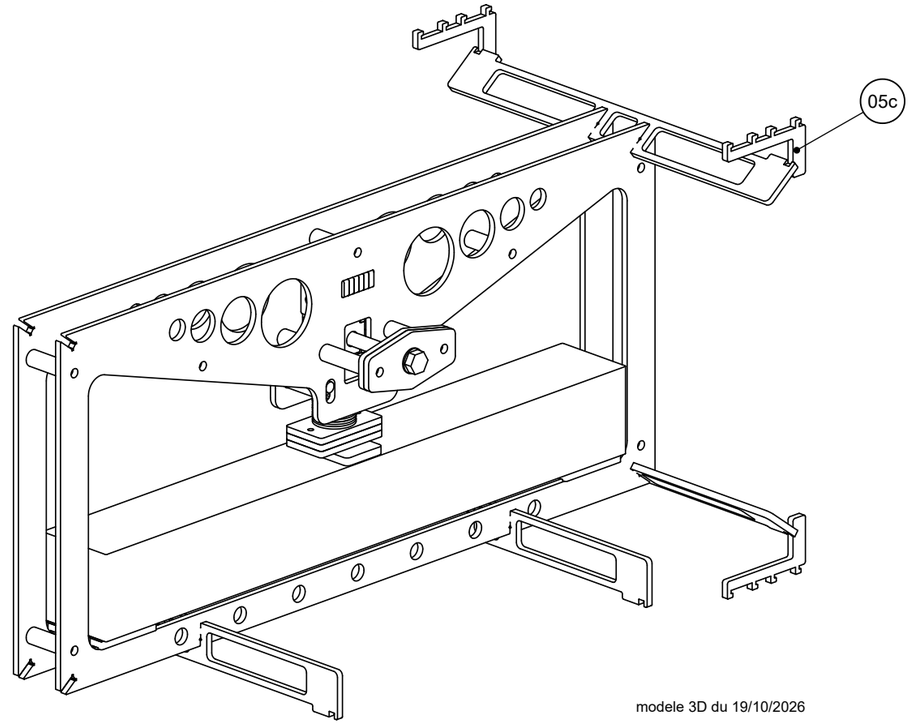


modele 3D du 19/10/2026


Pieds couches, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :
debout, les pieds couches restent sur la paillasse.

**coupe A-A (1:2)**

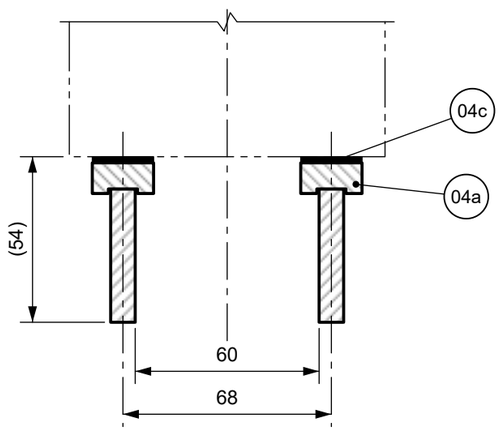


Les flancs portent SOUS les plats colles :
la face laterale de la poutre reste degagee.
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.

**coupe B-B (1:2,5)**

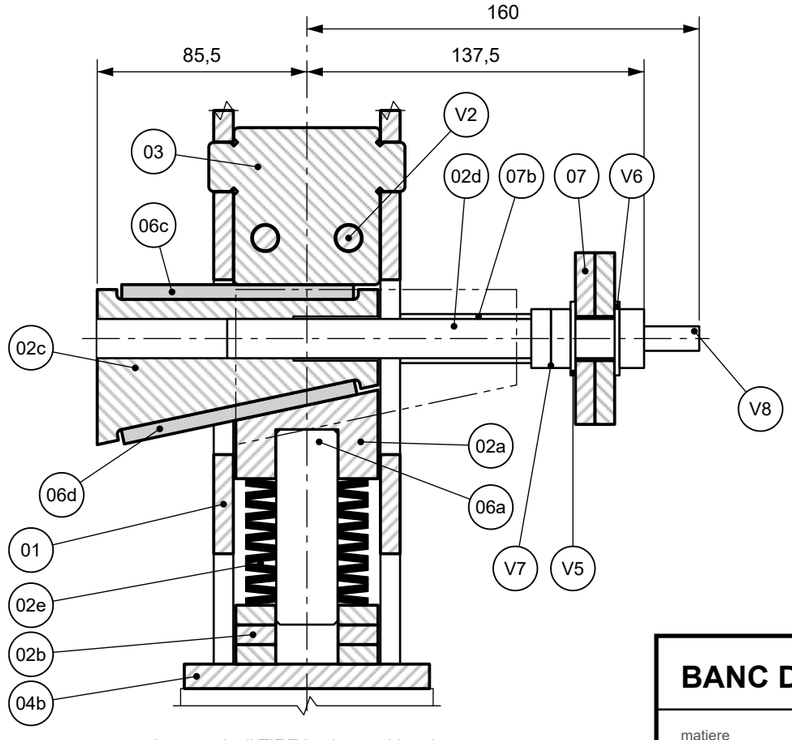


**NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs)**

| rep. | piece | z bas | z haut |
|---|---|---|---|
| 03 | traverse, 6 plaques | 325,7 | 389,7 |
| 06c | plaque de frottement haute | 319,7 | 325,7 |
| 02c | coin au repos, a y = 0 | 282,7 | 319,7 |
| 06d | plaque de frottement basse, y = 0 | 276,6 | 282,7 |
| 02a | coulisseau, a y = 0 | 246,6 | 276,6 |
| 06a | tourillon | 187,1 | 266,6 |
| 02e | pile Belleville libre (+ cales V4) | 195 | 246,6 |
| 02b | poussoir, 3 plateaux visses (V3) | 171 | 195 |
| 04b | patin de charge | 161 | 171 |
| - | poutrelle (eprouvette) | 54 | 161 |
| 04c | plats colles | 52 | 54 |
| 04a | patins d appui, x = +/- 375 | 42 | 52 |
| 02d | vis M16 : axe | 303,7 | |

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.
Pile Belleville, 12 rondelles EN 16983 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.
Reglage par coin acier a 12 deg et vis M16 normale aux flancs :
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de vis.
Hors tout couche sur pieds : 960 x 518,4 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 518,4 en plan ; etuve 538 x 528,4 x 1400.
Masse du cadre 34,5 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la vis vers l interieur :
la tete appuie, par deux rondelles trempees, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la vis ne retiendrait rien.
Douille sur la tete : 116,7 mm devant la tete de vis dans l etuve de 528,4, 10 de marge pour le decentrage du cadre.
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.

| **BANC DE FLEXION - ENSEMBLE** | | rep. 00 | indice B 05/10/2026 |
|---|---|---|---|
| matiere: voir nomenclature | brut: - | quantite: 1 | |
| echelle: 1:5 sauf indication | cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion: poutrelle 103x107x840 | |