




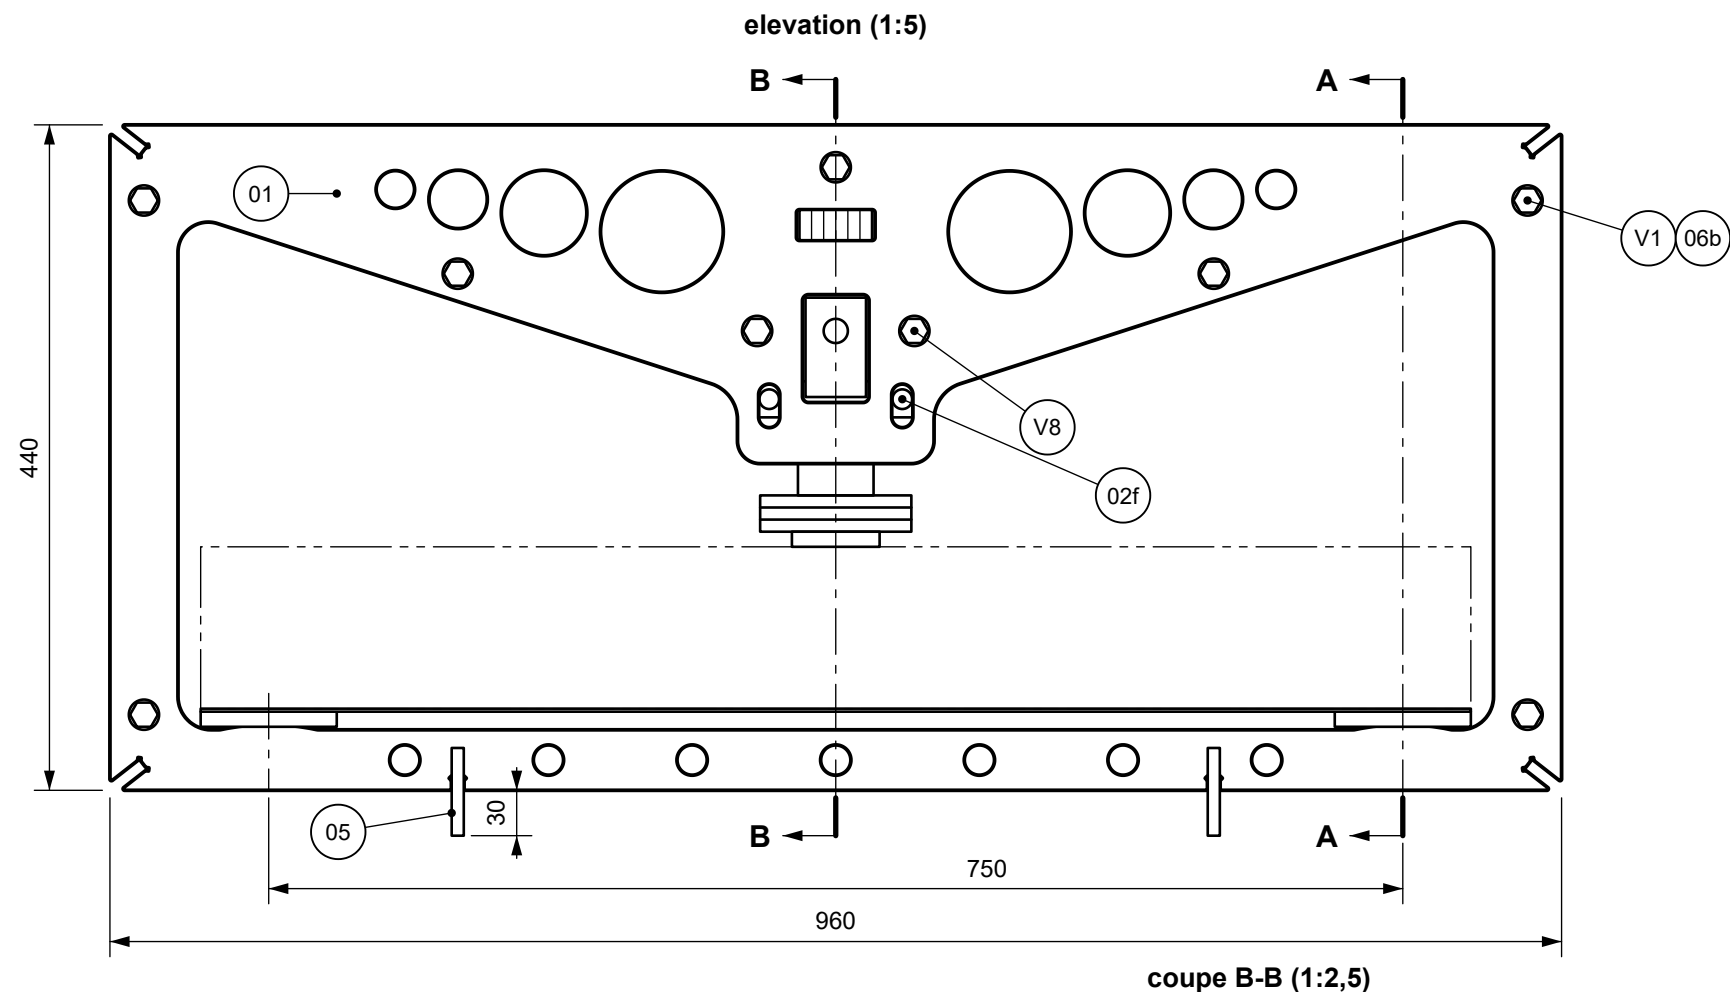

Les flancs portent SOUS les plats colles :  
la face laterale de la poutre reste degagee.  
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.

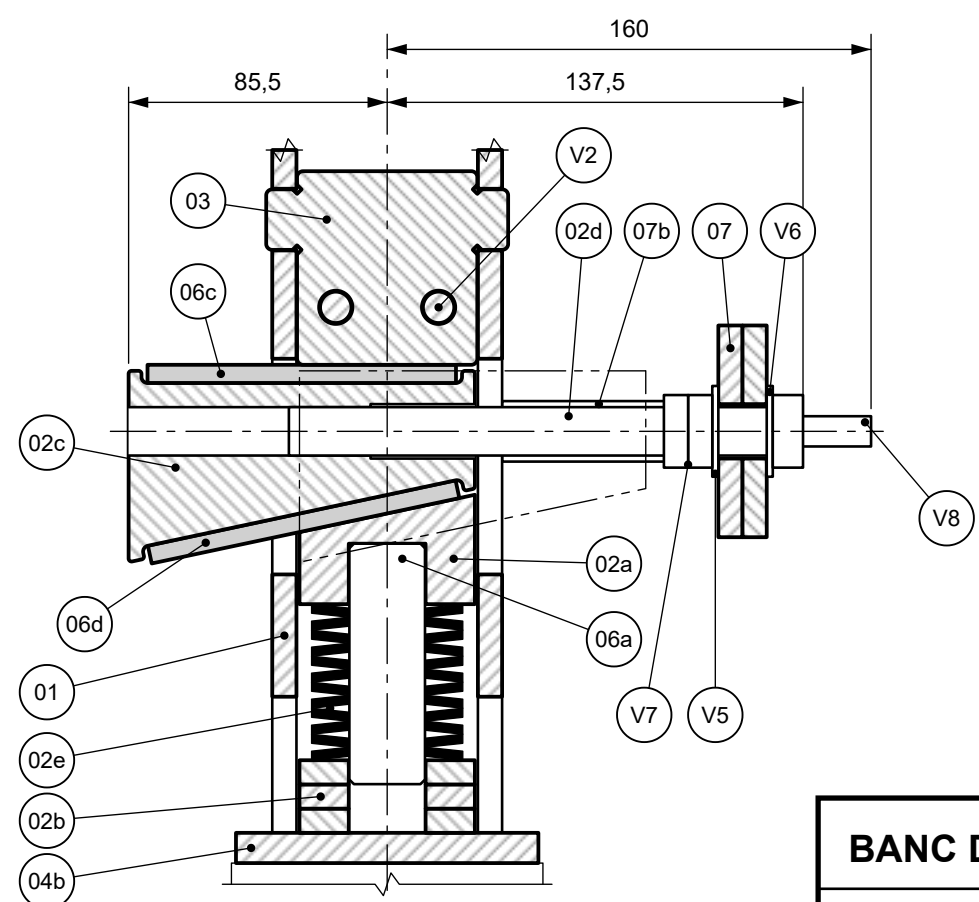

Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la vis vers l interieur :  
la tete appuie, par deux rondelles trempees, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la vis ne retiendrait rien.  
Douille sur la tete : 116,7 mm devant la tete de vis dans l etuve de 528,4, 10 de marge pour le decentrage du cadre.  
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.

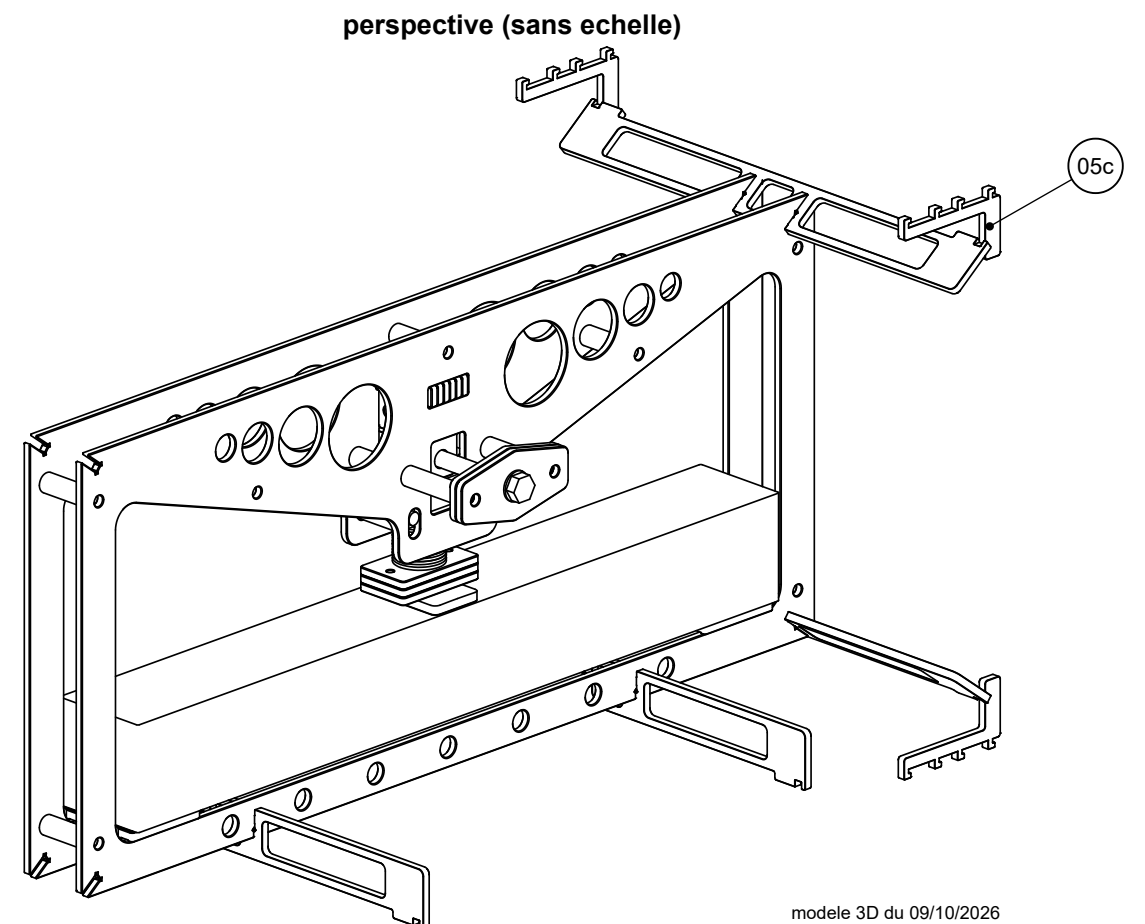

Pieds couches, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :  
debout, les pieds couches restent sur la pailleasse.

NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs)

| rep. | piece                              | z bas | z haut |
|------|------------------------------------|-------|--------|
| 03   | traverse, 6 plaques                | 325,7 | 389,7  |
| 06c  | plaque de frottement haute         | 319,7 | 325,7  |
| 02c  | coin au repos, a y = 0             | 282,7 | 319,7  |
| 06d  | plaque de frottement basse, y = 0  | 276,6 | 282,7  |
| 02a  | coulisseau, a y = 0                | 246,6 | 276,6  |
| 06a  | tourillon                          | 187,1 | 266,6  |
| 02e  | pile Belleville libre (+ cales V4) | 195   | 246,6  |
| 02b  | poussoir, 3 plateaux visses (V3)   | 171   | 195    |
| 04b  | patin de charge                    | 161   | 171    |
| -    | poutrelle (eprouvette)             | 54    | 161    |
| 04c  | plats colles                       | 52    | 54     |
| 04a  | patins d appui, x = +/- 375        | 42    | 52     |
| 02d  | vis M16 : axe                      | 303,7 |        |

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.  
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.  
Pile Belleville, 12 rondelles EN 16983 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.  
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.  
Reglage par coin acier a 12 deg et vis M16 normale aux flancs :  
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de vis.  
Hors tout couche sur pieds : 960 x 518,4 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.  
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 518,4 en plan ; etuve 538 x 528,4 x 1400.  
Masse du cadre 34,4 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

| BANC DE FLEXION - ENSEMBLE |                          | rep. 00               | indice B<br>05/10/2026 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| matiere                    | brut                     | quantite              |                        |
| voir nomenclature          | -                        | 1                     |                        |
| echelle                    | cotes en mm              | banc de flexion       |                        |
| 1:5 sauf indication        | tol. generale ISO 2768-m | poutrelle 103x107x840 |                        |