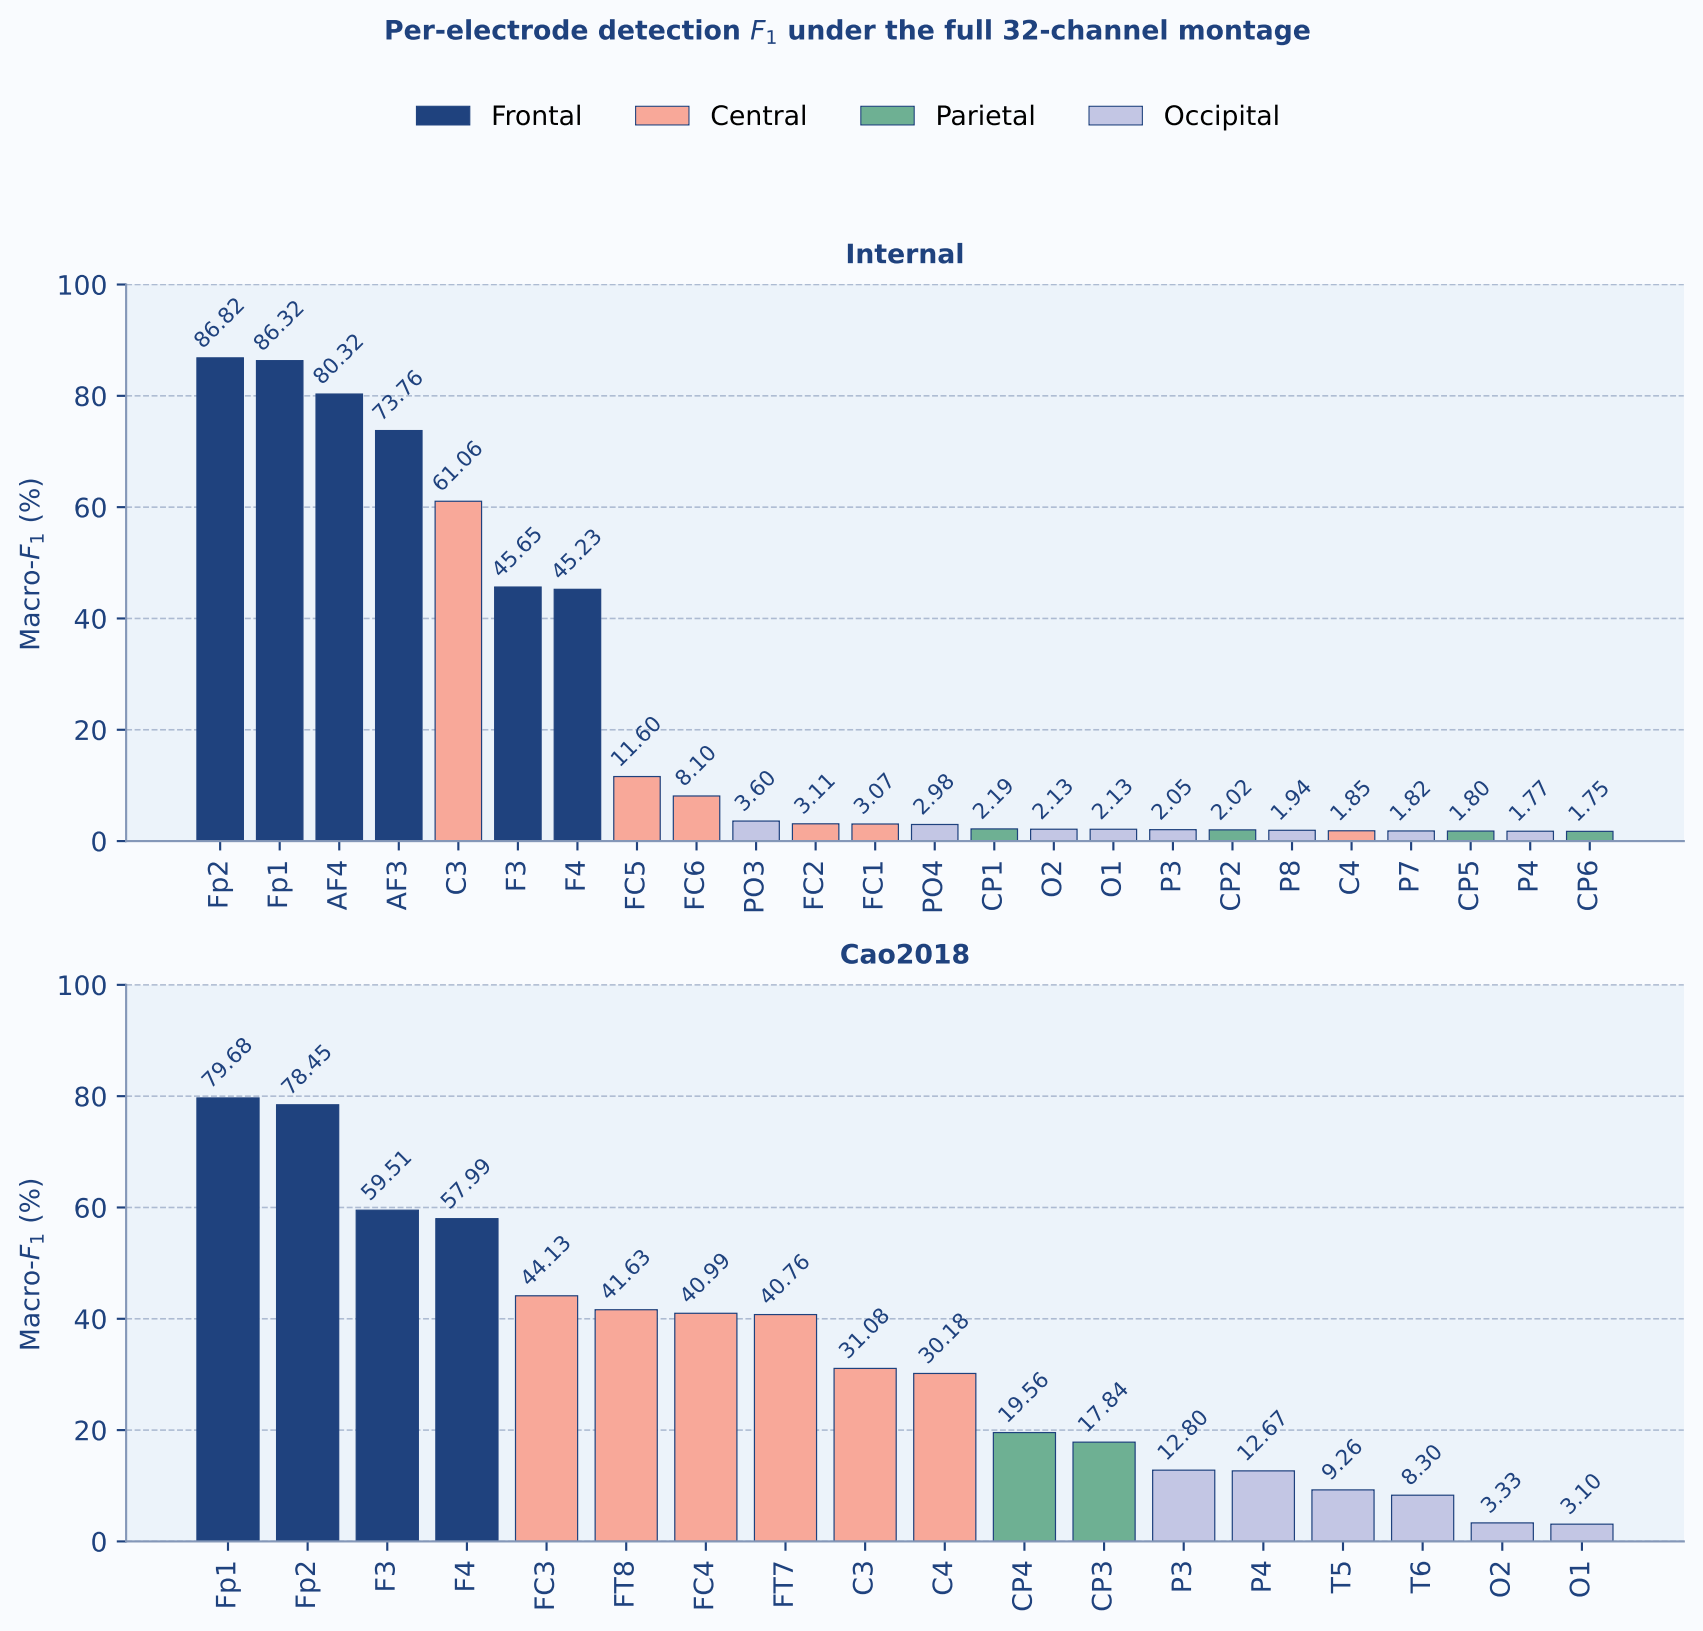
Per-electrode detection F_1 under the full 32-channel montage
Frontal
Central
Parietal
Occipital
Internal
Macro-F_1 (%)
0
20
40
60
80
100
86.82
86.32
80.32
73.76
61.06
45.65
45.23
11.60
8.10
3.60
3.11
3.07
2.98
2.19
2.13
2.13
2.05
2.02
1.94
1.85
1.82
1.80
1.77
1.75
Fp2
Fp1
AF4
AF3
C3
F3
F4
FC5
FC6
PO3
FC2
FC1
PO4
CP1
O2
O1
P3
CP2
P8
C4
P7
CP5
P4
CP6
Cao2018
Macro-F_1 (%)
0
20
40
60
80
100
79.68
78.45
59.51
57.99
44.13
41.63
40.99
40.76
31.08
30.18
19.56
17.84
12.80
12.67
9.26
8.30
3.33
3.10
Fp1
Fp2
F3
F4
FC3
FT8
FC4
FT7
C3
C4
CP4
CP3
P3
P4
T5
T6
O2
O1