

#### AARHUS SCHOOL OF ENGINEERING

#### SUNDHEDSTEKNOLOGI 2. SEMESTERPROJEKT

### Dokumentation

#### Gruppe 1

Lise Skytte Brodersen (201407432) Mads Fryland Jørgensen (201403827) Albert Jakob Fredshavn (201480425) Malene Cecilie Mikkelsen (201405722) Mohamed Hussein Mohamed (201370525) Sara-Sofie Staub Kirkeby (201406211) Martin Banasik (201408398) Cecilie Ammizbøll Aarøe (201208778)

Vejleder Studentervejleder Lars Mortensen Aarhus Universitet

Gruppe med lemmer	
Lise Skytte Brodersen (201407432)	Dato
Mads Fryland Jørgersen (201403827)	 Dato
Albert Jakob Fredshavn (201480425)	Dato
Malene Cecilie Mikkelsen (201405722)	Dato
Mohamed Hussein Mohamed (201370525)	Dato
Sara-sofie Staub Kirkeby (201406211)	– Dato
Martin Banasik (201408398)	– ————————————————————————————————————
Cecilie Ammitzbøll Aarøe (201208778)	Dato
/ejleder	
Lars Mortensen	— ————————————————————————————————————

## **Ordliste**

## Indholdsfortegnelse

Ordlis	e	iii
Kapite	l 1 Kravspecifikation	1
1.1	Indledning	1
1.2	Funktionelle krav	1
	1.2.1 Aktør-kontekstdiagram	1
	1.2.2 Aktørbeskrivelse	2
	1.2.3 Use case-diagram	2
	1.2.4 Use Cases	3
1.3	Ikke-funktionelle krav	6
	1.3.1 (F)URPS+ $\dots$	6
Kapite	l 2 Design	9
2.1	$\label{eq:indedning} Indledning \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	9
2.2	Hardware arkitektur	9
	2.2.1 Græseflader	10
2.3	Software arkitektur	10
	2.3.1 GUI	10
	2.3.2 UML klassediagram	13
	2.3.3 Appliktationsmodel	14
Kapite	1 3 Acceptest	21
3.1	Accepttest af Use Cases	21
	3.1.1 Use Case 1	21
	3.1.2 Use Case 2	21
	3.1.3 Use Case 3	22
	3.1.4 Use Case 4	23
	3.1.5 Use Case 5	23
3.2	Accepttest af ikke-funktionelle krav	23

# Kravspecifikation


#### 1.1 Indledning

Kravspecifikationen vil beskrive, ud fra en række modeller, hvordan EKG-systemet fungerer. Helt generelt er EKG-måling en simpel metode, til at måle hjertets elektriske aktivitet via elektroder, som registrerer elektriske impulser, placeret på huden. Ud fra disse impulser dannes en graf, som benyttes til at analysere hjertets funktionalitet ud fra P-, Q-, R-, S- og T-takkerne, og dermed konkludere om den pågældende patient har et raskt eller sygt hjerte, samt hvilken sygdom der er tale om. Helt specifikt for denne opgave er formålet, at identificere sygdommen atrieflimmer via et virtuelt EKG-signal.

#### 1.2 Funktionelle krav

De funktionelle krav vil nedenstående beskrives ud fra Aktør-kontekstdiagram, aktørbeskrivelse, Use Cases samt Use Case diagram.

#### 1.2.1 Aktør-kontekstdiagram

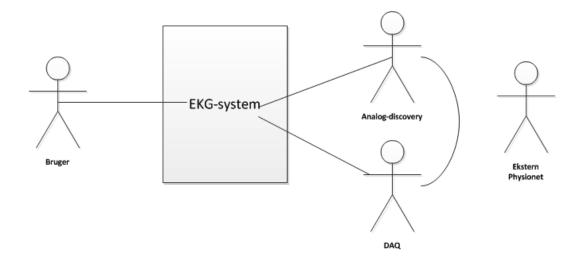

Figur 1.1: Aktør-kontekstdiagram


Data hentes ned fra den ekstern aktør, physionet, og via Analog-discovery omdannes csvfilens data til et analogt signal, der sendes til EKG-systemet. Ud fra disse data danner EGK-systemet en graf. Programmet detekterer markørudsving i EKG-grafen, som derefter valideres og analyseres af brugeren.

#### 1.2.2 Aktørbeskrivelse

Aktørnavn	Type	Beskrivelse
Bruger	Primær	Brugeren er den aktør, der ønsker at foretage målingerne, som omfatter EKG samt diagnosticering af artieflimmer. Brugeren er en person, der har kendskab til EKG-systemet. Fx sundhedsfaglig personale
Analog-discovery	Sekundær	Analog-discovery omdanner data fra den eksterne aktør, physionet, til et analog signal
DAQ	Sekundær	DAQ'en omdanner det analoge signal fra analog- discovery til et digitalt signal, som EKG-systemet kan generere en graf ud fra
Physionet	Ekstern	Physionet er en database, hvor der ligger mange forskellige EKG-signaler. Det er ud fra disse EKG-signaler, virtuelle patienter skabes.

 $Tabel~1.1:~Akt \"{o}rbeskrivelse$ 

#### 1.2.3 Use case-diagram

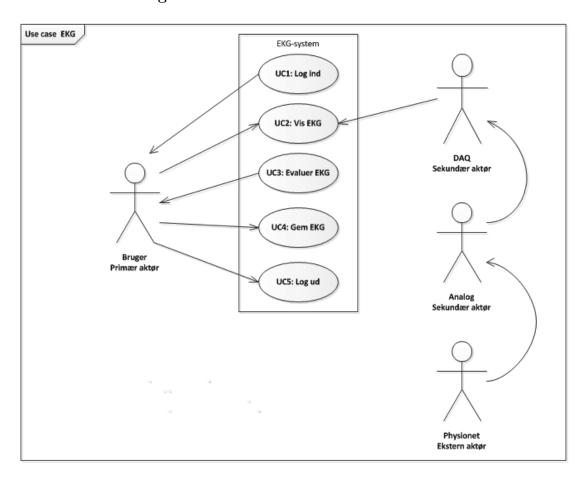

Figur 1.2: Use case-diagram

Brugeren, den primære aktør bliver bedt om sit log ind, inden EKG-vinduet vises. Brugeren vælger indstillinger og trykker på "start-knappen. EKG-dataerne fra den eksterne aktør, Physionet, behandles i Analog samt i DAQ'en, de sekundære aktør, hvor efter data vises som en EKG-graf i EKG-vinduet. Brugeren kan ud fra denne graf evaluere EKG-signalet i forhold til at diagnosticere atrieflimmer. Brugeren gemmer EKG-målingen i databasen og logger ud.

#### 1.2.4 Use Cases

#### Use Case 1

Navn		Log ind
Use case ID		1
Samtidige forløb		1
Primær aktør		Brugeren
Initialisere		Brugeren ønsker at logge ind
Forudsætninger		At der er logget ud efter en tidligere måling
Resultat		Brugeren bliver logget på og kan foretage en måling
Hovedforløb	1.	Brugeren indtaster username samt password
	2.	Brugeren trykker på "Login-knappen". Login-vinduet lukkes ned mens CPR-vinduet åbnes [2.a Username eller password er forkert]
Undtagelser	2a.	Besked vises på skærmen med tekst, der informerer om, at username eller password er forkert. Der forsættes i UC1 ved punkt 1

Tabel 1.2: Fully dressed Use Case 1.

#### Use Case 2

Navn	Vis EKG
Use case ID	2
Samtidige forløb	1
Primær aktør	Brugeren
Primær aktør Sekundær aktør	Brugeren Analog

Ekstern aktør		Physionet
Initialisere		Brugeren ønsker at foretage en EKG-måling
Forudsætninger		Brugeren er logget ind og EKG-vinduet er vist samt Analog og DAQ'en er koblet til og data er hentet ned
Resultat		EKG-graf bliver vist
Hovedforløb	1.	Brugeren indtaster virtuel patients CPR-nummer [1.a CPR-nummeret findes ikke]
	2.	Brugeren vælger indstillinger [2.a Brugeren er tilfreds med default-indstillingerne]
	3.	Målingen startes ved at trykke på "Start"
	4.	EKG-data illustreres på en graf
Undtagelser	1a.	CPR-nummeret findes ikke. Besked vises på skærmen med tekst, der informerer om, at CPR-nummeret ikke er gyldigt. UC2 startes forfra med nyt CPR-nummer
	2a.	Der blev ikke ændret i default-indstillingerne. Der fortsættes ved punkt 2 i hovedforløbet med default indstillingerne

Tabel 1.3: Fully dressed Use Case 2.

#### Use Case 3

Navn		Evaluer EKG	
Use case ID		3	
Samtidige forløb		1	
Primær aktør		Brugeren	
Initialisere		Use Case 2 er gennemført	
Resultat		Brugeren kan ud fra EKG-graf diagnosticere sygdommen atrieflimmer	
Hovedforløb	1.	Brugeren validere programmets analyse af EKG-signalet	
	2.	Brugeren stiller diagnosen atrieflimmer [2.a Atriefrekvensen er ikke i intervallet 220-300 pr. minut]	
Undtagelser	2a.	Det er ikke muligt at diagnosticere atrieflimmer ud fra grafen. Use case 3 afsluttes og Use case 2 gentages med evt. nye tidsindstillinger	

1.2. Funktionelle krav ASE

Tabel 1.4: Fully dressed Use Case 3.

#### Use Case 4

Navn		Gem EKG
Use case ID		4
Samtidige forløb		1
Primær aktør		Brugeren
Initialisere		Brugeren ønsker at gemme EKG i databasen
Forudsætninger		Use case 3 er gennemført
Resultat		EKG er gemt i databasen
Hovedforløb	1.	Brugeren trykker på "Gem-knappen". En messagebox kommer frem med besked om at data er gemt
	2.	Brugeren trykker på "Ok"knappen for at lukke messageboxen og EKG-vinduet vises igen
Undtagelser		

Tabel 1.5: Fully dressed Use Case 4.

#### Use Case 5

Navn	Log ud		
Use case ID	5		
Samtidige forløb	1		
Primær aktør	Brugeren		
Initialisere	Brugeren ønsker at logge ud		
Forudsætninger	Der skal være logget ind		
Resultat	Brugeren bliver logget ud, og EKG-vinduet lukkes og login-vinduet fremkommer		
Hovedforløb 1.	Brugeren trykker på "log ud-knappen"og EKG-vinduet lukkes, mens login-vinduet fremkommer		
Undtagelser			

Tabel 1.6: Fully dressed Use Case 5.

#### 1.3 Ikke-funktionelle krav

De ikke-funktionelle krav er udarbejdet ved brug af (F)URPS+. De er alle prioriteret ved MoSCoW metoden - Must (skal være med), Should (bør være med, hvis muligt), Could (kunne have med, hvis det ikke influerer på andet), Won't/Would (ikke med nu, men med i fremtidige opdateringer).

#### 1.3.1 (F)URPS+

MoSCoW er angivet i parentes med hhv. M, S, C eller W.

#### Usability

- (M) Brugeren skal kunne starte en default-måling maksimalt 20 sek. efter opstart af programmet
- (M) Brugeren skal have mulighed for at ændre tidsintervallet før målingerne foretages
- (M) Login-vinduet skal indholde en "login-knap til at logge på og få vist EKG-vinduet
- (M) EKG-vinduet skal indeholde en "start-knap til at igangsætte målingerne
- (M) EKG-vinduet skal indeholde en "stop-knap til at afslutte målingerne før den valgte tid
- (M) EKG-vinduet skal indeholde en "log ud-knap
- (M) EKG-vinduet skal indeholde en "gem-knap
- (M) Information-vinduet skal indeholde en "gem-knap
- (M) Målingen stopper automatisk efter det valgte tidsinterval

#### Reliability

• (M) Systemet skal have en effektiv MTBF (Mean Time Between Failure) på 20 minutter og en MTTR (Mean Time To Restore) på 1 minut.

$$Availability = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{20}{20 + 1} = 0,952 = 95,2\% \tag{1.1}$$

#### Performance

- (M) Der skal vises en EKG-graf i EKG-vinduet, hvor spænding vises op af y-aksen (-1V til 1V) og tiden på x-aksen
- (M) Grafen skal være scrollbar på x-aksen, så brugeren selv ved brug af musen kan vælge det udsnit af grafen, der skal vises mere detaljeret

• (M) Skal tage en sample over et brugerbestemt interval, hvor frekvensen er tilpasset målingerne, således at grafen er analyserbar

#### Supportability

• (M) Softwaren er opbygget af trelagsmodellen


#### 2.1 Indledning

Formålet med design afsnittet er at beskrive hardwaren og softwaren for EKG-systemet. Det beskrives vha. diagrammer og skitser som tydeligør, hvordan de forskellige klassers funktionalitet er, og hvordan klasserne snakker sammen.

#### 2.2 Hardware arkitektur

I dette projekt er hardwaren blevet udleveret, derfor vil hardware arkitekturen ikke blive beskrevet ned i mindste detalje, men derimod kun hardwarens overordnede funktion. Hardwaren for systemet består af en National Instruments DAQ og en signalgenerator fra Analog Discovery. Disse er begge forbundet til en computer via USB-porte.

I dette projekt bliver EKG-signalet ikke målt fysisk via en patient, men simuleret via et signal, som er hentet ned fra websiden PhysioNet <sup>1</sup>.

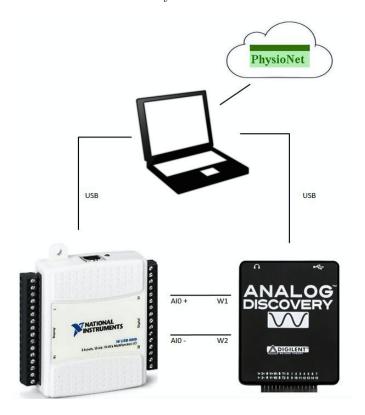

Figur 2.1: Grafisk illustration of hardware opsætning

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.physionet.org

Som det ses på den overstående figur, er denne opstilling meget simpel. Figur 2.1 viser, hvordan de forskellige komponenter relaterer til hinanden. Display hardwaren vil i dette projekt være en computer, hvilket er et krav fra softwarens side, således at der kan vises et EKG-signal i form af en graf.

Som beskrevet ovenfor er det Analog Discovery, som sammen med EKG-signalets informationer fra PhysioNet, skaber vores fiktive patient. Før EKG-signalet vises på computerens skærm, skal det igennem de forskellige komponenter i opstillingen. Analog Discovery modtager EKG-signalets information som en CSV-fil, denne fil omdanner Analog Discovery til et analogt signal, som herefter sendes videre til DAQ'en. I DAQ'en digitaliseres det analoge signal, og tilpasses, så det efterfølgende kan udskrives på computer skærmen, i form af en EKG graf.

#### 2.2.1 Græseflader

Grænseflader af forbindelserne imellem de forskellige dele af hardwaren.

Forbindelse	Signaltype	Funktionalitet
DAQ - Computer	Digital	DAQ'en konverterer det analoge signal til digitalt og videresender det til com- puteren. Informationen sendes begge ve- je.
Computer - Analog Discovery	Digital	Computeren simulerer et EKG-signal og sender det til Analog Discovery.
Analog Discovery - DAQ	Analog	Analog Discovery konverterer signalet fra digitalt til analogt og videresender det til DAQ'en.


Tabel 2.1: Beskrivelse af grænseflader.

#### 2.3 Software arkitektur

I dette projekt arbejdes der med objektorienteret programmering i programmeringssproget C#. Projektet er opbygget i henhold til trelagsmodellen, som er beskrevet i Rapporten under afsnittet Baggrund. Præsentationslaget består af 4 GUI'er, logiklaget af en enkelt klasse, og datalaget består af 3 klasser, hvoraf den ene er en blackbox.


#### 2.3.1 GUI

I dette afsnit vil GUI'erne beskrives nærmere. Grafiklaget består i alt af 4 GUI'er eller vinduer - Login-vindue, CPR-vindue, EKG-vindue og Gem\_måling-vindue.

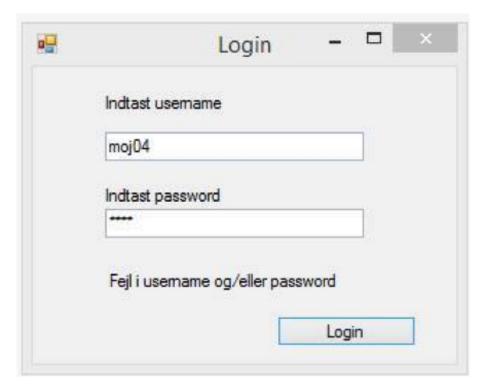

Figur 2.2: Login-vindue

Når programmet startes op, vil et Login-vindue fremkomme på skærmen. Her skal brugeren logge ind for at få adgang til programmet, ved at indtaste sit personlige username og password. Bliver enten username eller password ikke godkendt, returneres en fejlmeddelelse, i form af en linje tekst nedenfor login-felterne. Bliver login godkendt åbnes CPR-vinduet.

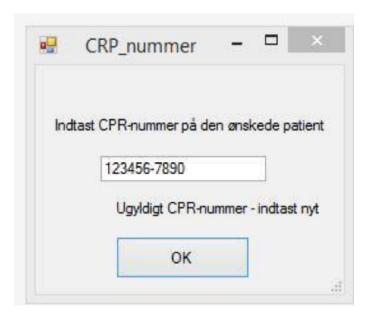


Figur 2.3: CPR-vindue

Her bliver brugeren bedt om at indskrive CPR-nummeret på den fiktive patient. CPR-nummeret bruges til at identificere personen i forbindelse med fremtidige målinger, samt

til gemme målingerne i hvad der svarer til den fiktive persons journal. Hvis CPR-nummeret ikke bliver godkendt, vil brugerne blive gjort opmærksom på dette via en fejlmelding.


Når CPR-nummeret bliver godkendt, åbner det primære vindue, EKG-vinduet.

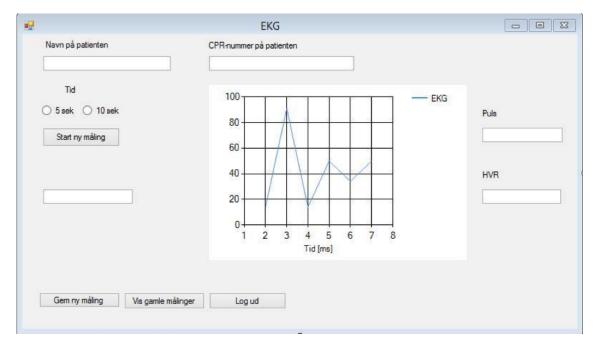

 $Figur \ 2.4: EKG-vindue$ 


EKG-vinduet er, hvor man kan køre og se målinger fra. Der er knapper til at vælge, hvor lang tid man ønsker en måling skal køre over. Til højre kan grafen for EKG-signalet ses, efter der er trykket "Start ny måling". Yderligere til højre kan der ses puls og HVR for den pågældende graf. Til venstre under knappen "Start ny måling"ses et tom tekstfelt. I dette tekstfelt vil diagnosen for EKG-signalet udskrives. Nederst er der knapper til at gemme målingerne, samt at logge ud fra programmet. Hvis man logger ud, kommer man tilbage til Login-vinduet.

Det sidste vindue der er, forekommer når man trykker på "Gem ny måling". Her kommer der et pop-up vindue op, som bekræfter, at EKG-målingen er gemt.

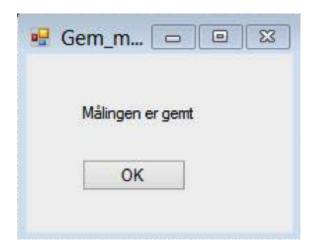

 $Figur~2.5:~Gem\_~m\"{a}ling\text{-}vindue$ 

#### 2.3.2 UML klassediagram

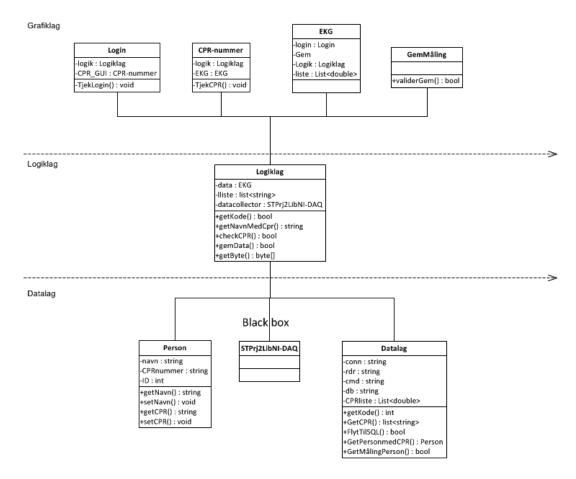

Figur 2.6: UML-klassediagram over softwaren

På gruppens UML diagram, er det lettere at få en forståelse, for selve koden. Her er det meget tydeligt, at koden er opbygget efter trelagsmodellen. Grafiklaget er bygget op af GUI'er, som bliver interfacen for selve bruger-interaktionen. I dette lag sker der som udgangspunkt intet behandlingsarbejde. Der kan læses mere om opsætningen, og funktionerne

af grafiklaget under 'GUI'.

Logiklaget består af en enkelt klasse, som fungerer som programmets primære styring. Logiklaget er til for, at grafiklaget ikke har direkte adgang til datalaget. Det er altså i dette lag alt programmets data bliver behandlet. Her bliver EKG'et f.eks. analyseret og login, samt CPR, bliver valideret i forhold til det data, der ligger i datalaget.

Datalaget består af to klasser, og en blackbox. I dette lag bliver der primært sørget for forbindelsen til databasen. Klassen "Datalag" er kernen i dette lag. Her bliver der sørget for at gemme og hente informationer fra databasen. Det er i dette lag, hvor data'en som logiklaget arbejder med, kommer fra. Klassen "Person", er til for at binde alle personinformationer sammen, sådan at vi i stedet for at kalde 4 attributter, kan nøjes med at kalde et enkelt objekt.


#### 2.3.3 Appliktationsmodel

Applikationsmodel vil i almindelig forstand indeholde en overordnet domænemodel, herefter klassediagram samt sekvensdiagram og tilsidst et opdateret klassediagram, hvor metoderne fra sekvensdiagram er inkluderet.

Applikationsmodellen for dette projekt består af en overordnet domænemodel, herefter sekvensdiagram for de forskellige Use Cases med tilhørende opdateret klassediagram, som beskriver metodekald og kommunikation mellem klasserne. Klassediagrammerne er undladt, da de er irrevalt for dokumentationen for projektet. Applikationsmodellen er udarbejdet udfra Use Cases, hvilket medfører at metoderne er fiktive, altså ikke hentet direkte fra softwaren.

#### Domænemodel


Domænemodellen er skabt på baggrund af de fem Use Cases. Gennem navneordanalyse af Use Casene er de konceptuelle klasser fundet. I modellen beskrives, hvordan de konceptuelle klasser interagerer med hinanden. Controlleren er ikke en konceptuelle klasse, men er den, der sørger for at systemet fungerer optimalt.

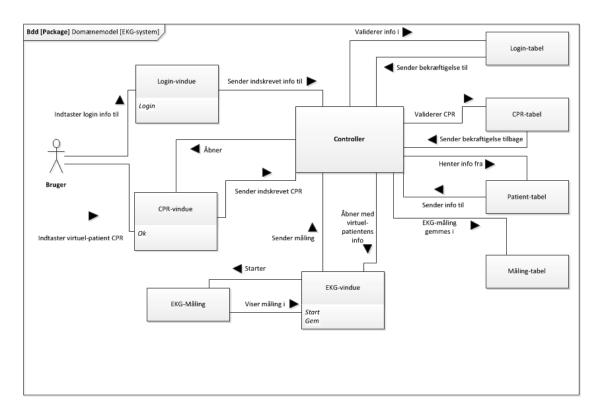


Figur 2.7: Domænemodel af EKG-systemet

#### Sekvensdiagram


Sekvensdiagrammerne beskriver step-by-step via fiktive metoder forløbet i de forskellige Use Cases. Der er lavet et sekvensdiagram for hver Use Cases for at gøre systemet mere overskueligt. Et sekvensdiagram består af boundary-klasser og domain-klasser fra domænemodellen, samt en controller-klasse, som har navn efter den specifikke Use Case.

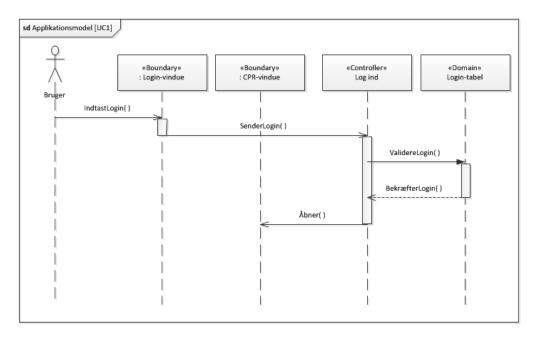


Figur 2.8: Sekvensdiagram for UC1

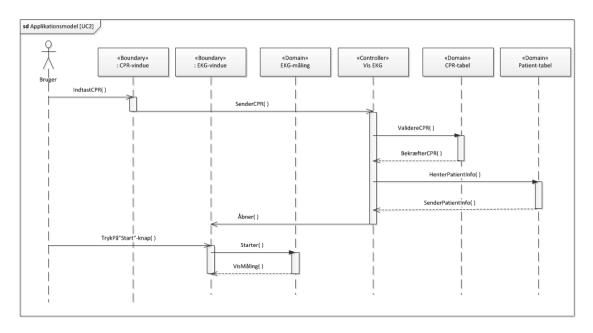


Figur 2.9: Sekvensdiagram for UC2

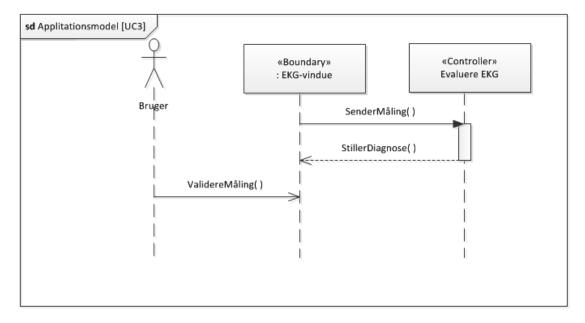

Figur 2.10: Sekvensdiagram for UC3

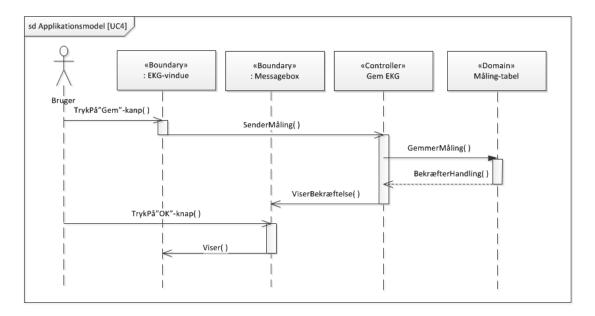


Figur 2.11: Sekvensdiagram for UC4

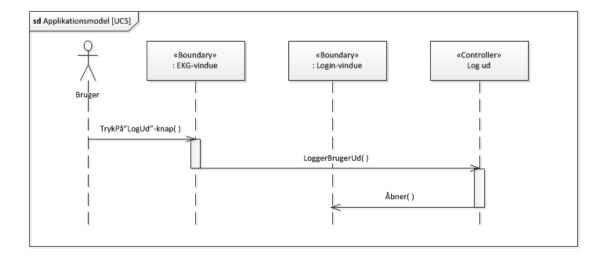


Figur 2.12: Sekvensdiagram for UC5

#### Opdateret Klassediagram

De opdateret klassediagrammer indeholder metoderne fra de dertilhørende sekvensdiagrammer - dette giver et overblik over, hvilke metoder de forskellige klasser består af.

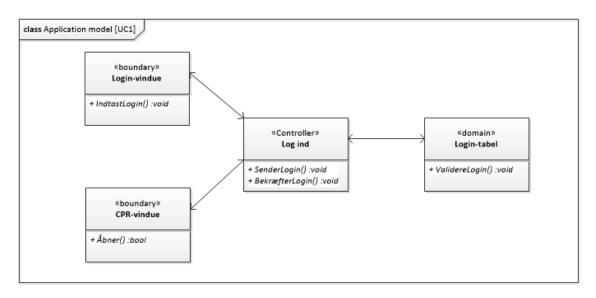


Figur 2.13: Klassediagram for UC1

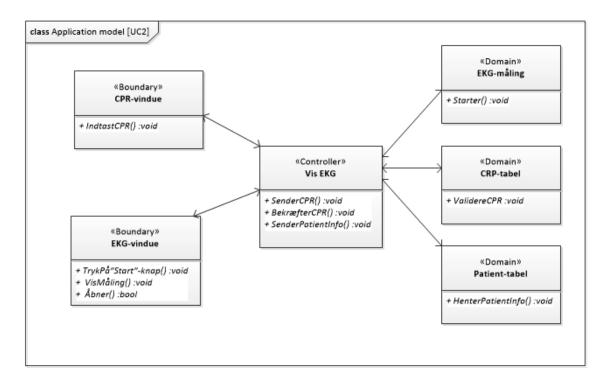


Figur 2.14: Klassediagram for UC2


2.3. Software arkitektur ASE

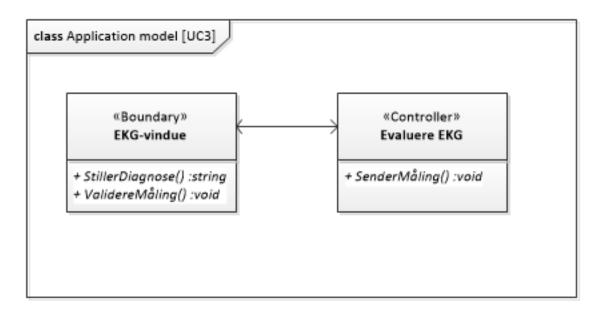

Figur 2.15: Klassediagram for UC3

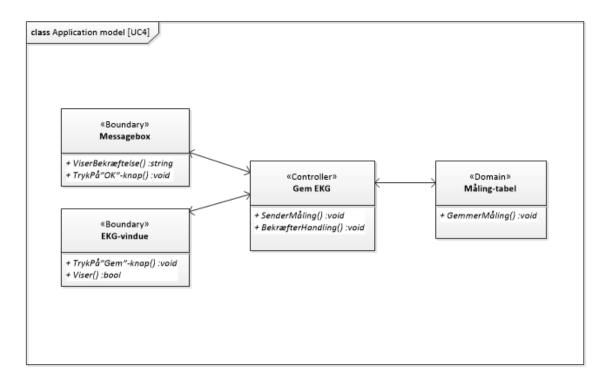

Figur 2.16: Klassediagram for UC4

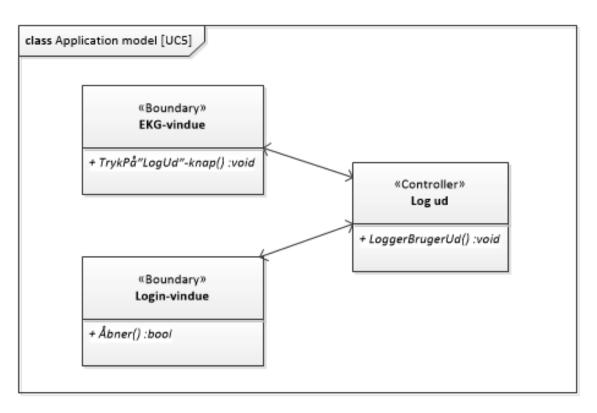

 $Figur\ 2.17:\ Klassediagram\ for\ UC5$ 

# Acceptest 3

#### 3.1 Accepttest af Use Cases

#### 3.1.1 Use Case 1

#### Log ind

	Test Forventet result		Faktiske observationer	Godkendt
	Hoved scenarie			
1.	Indtast username samt password	Username- og pas- swordboks bliver udfyldt		
2.	Tryk på "Login-knap- pen.	Login bliver god- kendt. Login-vinduet lukkes ned mens CPR-vinduet åbnes		
	Exentions			
2a.	Username eller password er forkert	Besked vises på skær- men med tekst, der in- formerer om, at bru- gernavn eller password er forkert		

Tabel 3.1: Accepttest of Use Case 1.

#### 3.1.2 Use Case 2

#### Vis EKG

	Test		Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt	
	Hovedsc	enarie				
1.	1. Indtast virtuel patients CPR-nummer					

ST3PRJ3 Gruppe X 3. Acceptest

2.	Vælg indstillinger	Indstillinger bliver valgt
3.	Tryk på "Start ny målling"	Målingen startes i EKG-vinduet
4.	EKG-data illustreres på en graf	En analyserebar graf fremvises i EKG- vinduet
1.a	$\begin{array}{ccccc} CPR\text{-}ummeret & fin-\\ des & ikke. & Besked\\ vises & med & tekst, & der\\ informerer & om, & at\\ CPR\text{-}nummeret & ikke\\ er & gyldigt & & \end{array}$	•
2.a	Ingen ændring i indstillinger	Målingen foretages med default- indstillingerne

Tabel 3.2: Accepttest of Use Case 2.

#### 3.1.3 Use Case 3

#### **Evaluer EKG**

Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
Hoved scenarie			
Validere program- mets analyse af EKG-signalet	Det er muligt at se små fluktuationer, som kan aflæses på EKG-grafen		
Stil diagnosen atrie- flimmer	Atrieflimmer kan aflæses ud fra EKG-grafen		
Exentions			
	Ÿ.		
	Hovedscenarie  Validere programmets analyse af EKG-signalet  Stil diagnosen atrieflimmer  Exentions  Atriefrekvensen er ikke i intervallet 220-300	Validere programmets analyse af EKG-signalet som kan aflæses på EKG-grafen  Stil diagnosen atrieflimmer kan aflæses ud fra EKG-grafen  Exentions  Atriefrekvensen er ikke i intervallet 220-300 pr. minut  Det er ikke muligt at se små fluktuationer, som kan aflæses på EKG-grafen  Atrieflimmer kan aflæses ud fra EKG-grafen  Det er ikke muligt at diagnosticere atrieflimmer ud fra EKG-grafen	Validere program- mets analyse af små fluktuationer, EKG-signalet som kan aflæses på EKG-grafen  Stil diagnosen atrie- flimmer ses ud fra EKG-grafen  Exentions  Atriefrekvensen er ik- ke i intervallet 220-300 pr. minut flimmer ud fra EKG-

Tabel 3.3: Accepttest of Use Case 3.

#### 3.1.4 Use Case 4

#### Gem EKG

	Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
	Hoved scenarie			
1.	Tryk på "Gem-knap- pen.	Messagebox kommer frem med besked om at målingen er gemt		
2.	Tryk på "Ok-knappen	Målingen er gemt, vinduet lukkes og EKG- vinduet vises igen		
	Exentions			

Tabel 3.4: Accepttest of Use Case 4.

#### 3.1.5 Use Case 5

#### Log ud

	Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
	Hoved scenarie			
1.	Tryk på "log ud-knap- pen	EKG-vinduet lukkes ned, mens login- vinduet fremkommer		
	Exentions			

Tabel 3.5: Accepttest of Use Case 5.

#### 3.2 Accepttest af ikke-funktionelle krav

ST3PRJ3 Gruppe X 3. Acceptest

Ikke-funktionelt krav Usability	Test/handling	Forventet resultat	Faktiske vationer	obser-	Godkendt
Brugeren skal kunne starte en default-måling maksimalt 20 sekunder ef- ter opstart af program	Start program- met, hvorefter der vha. stopur måles opstartsti- den	At programmet er startet op in- denfor 20 sekun- der			
Brugeren skal have mulighed for at ændre tidsintervallet før målingerne foretages	Start programmet og ændrer indstillingerne i toolbar	At der er mulighed for at ændre indstillinger			
Login-vinduet skal indholde en login-knap til at logge på og få vist EKG-vinduet	login-knappen er synlig i GUI, og ved tryk på knappen vises EKG-vinduet	At EKG-vinduet vises			
EKG-vinduet skal indeholde en "start-knap"til at igangsætte målingerne	Startknappen er synlig i GUI, og ved tryk på knappen igangsættes måling	At målingen igangsættes			
EKG-vinduet skal indeholde en "stop-knap"til at afslutte målingerne	Stopknappen er synlig i GUI, og ved tryk på knappen afsluttes måling	At målingen afsluttes			
EKG-vinduet skal indeholde en "gem-knap"til at gemme målin- gerne	Gem-knappen er synlig i GUI, og ved tryk på knappen gem- mes måling i database	Messageboks vises på skærmen med teksten "Måling er gemt" og kan findes i databasen			

EKG-vinduet skal indeholde en "log ud-kanp til at logge ud	"log ud-knappen er synlig i GUI, og ved tryk på knap lukkes EKG-vinduet og login-vinduet vises	Login-vinduet vises	
Målingen stop- per automatisk efter det valgte tidsinterval	Der vælges et tidsinterval. Må- ling startes	Målingen stop- per efter det valgte tidsinter- val	
Reliability			
Systemet skal have en effektiv MTBF (Mean Time Between Failure) på 20 minutter og MT- TR (Mean Time To Restore) på 1 minut	Køre programmet i 20 minutter. Genstart derefter programmet, hvor der tages tid med et stopur	Programmet har kørt i 20 minut- ter og genstartes indenfor 1 minut	
Performance			
Der skal vises en EKG-graf i interfacet, hvor spænding vises op ad y-aksen (-1V til 1V) og tiden på x-aksen	Gennemfør en måling	At spændingen for EKG-signalet er op ad y-aksen, samt tiden hen ad x-aksen	
Det skal være muligt at kun- ne scrolle igen- nem målingerne hen ad x-aksen	Der gennemføres en måling hvor- efter der scrolles hen ad x-aksen	At der ved scrolling kan ses forskellige dele af EKG-signalet hen ad x-aksen	

ST3PRJ3 Gruppe X 3. Acceptest

over et bruger-	Gennemfør en måling, hvor et bestemt interval hen ad x-aksen er valgt	9
Supportability		
-	Kig i koden efter data-lag, logik-lag og GUI-lag	holder et data-

 $Tabel\ 3.6:\ Accept test\ af\ Ikke-funktionelle\ krav$