


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del FMP: Activado
Modo FCM: Pulso Toco
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo


** FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo

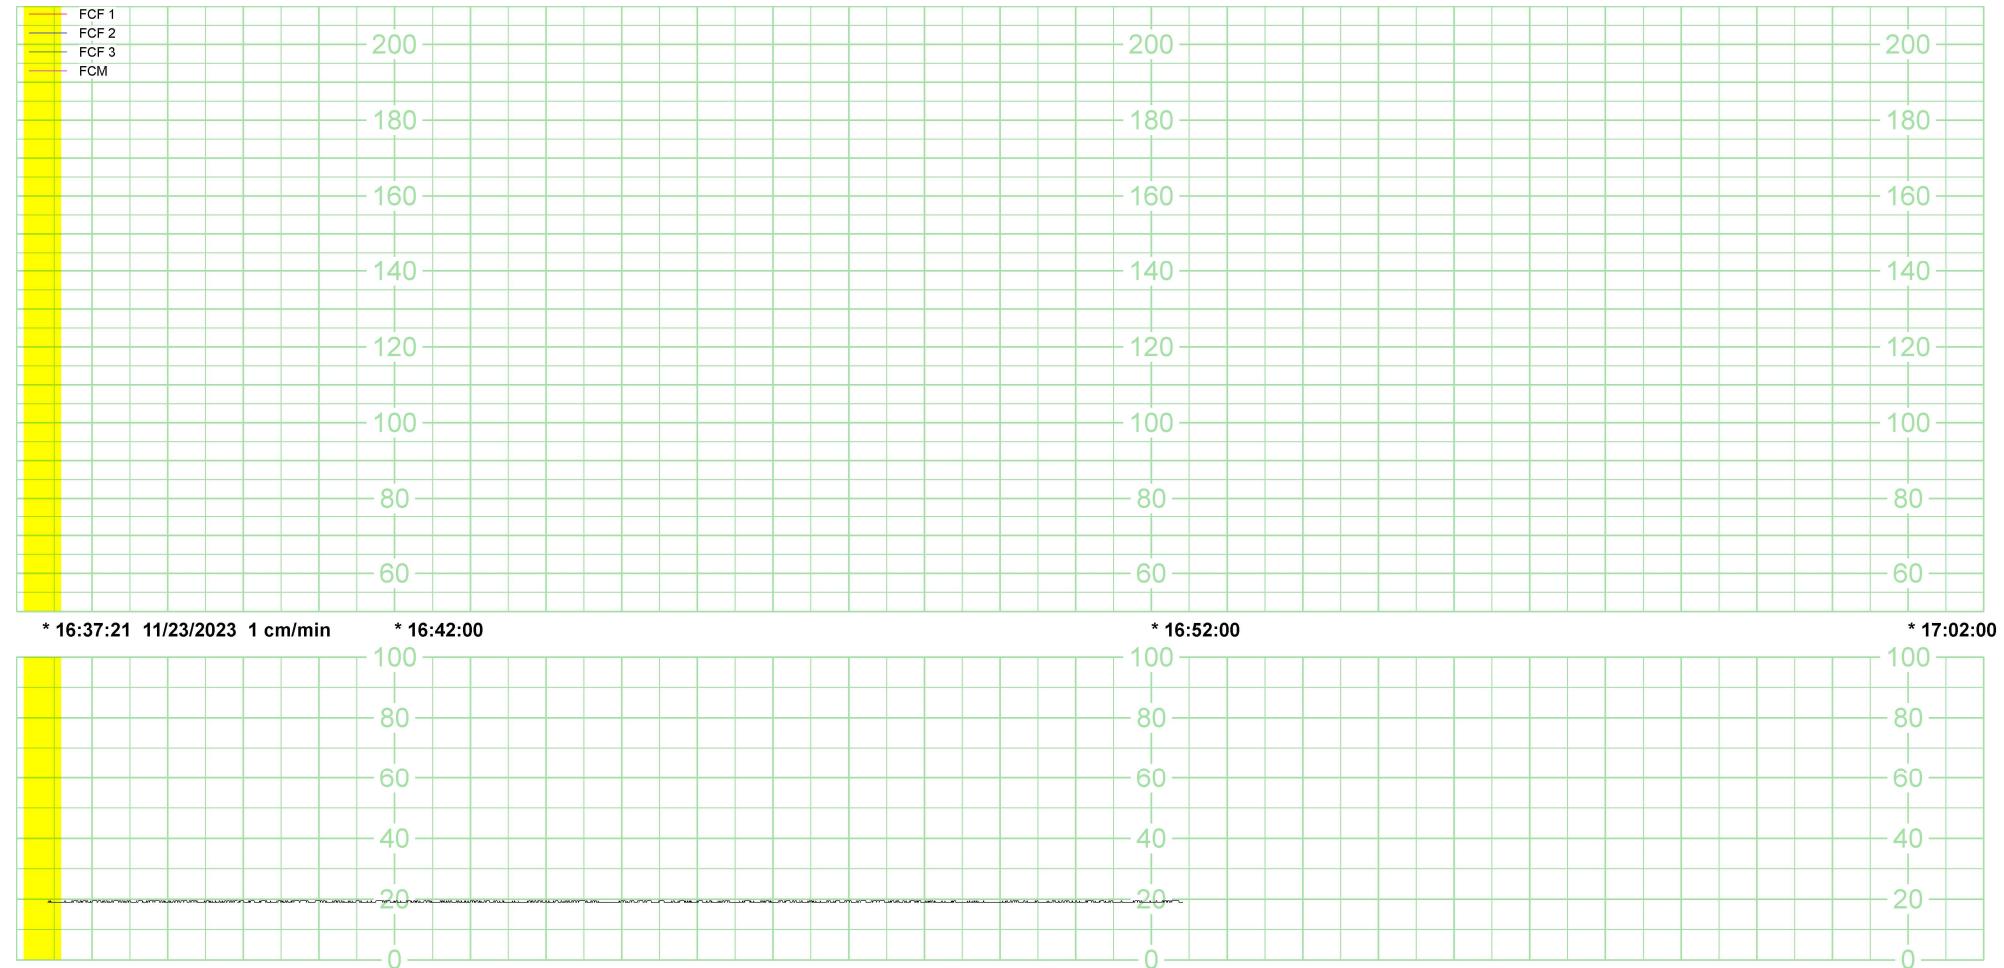


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco : externo
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo

Modo FCM: SpO2
** FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor


Alarma con acuse de recibo

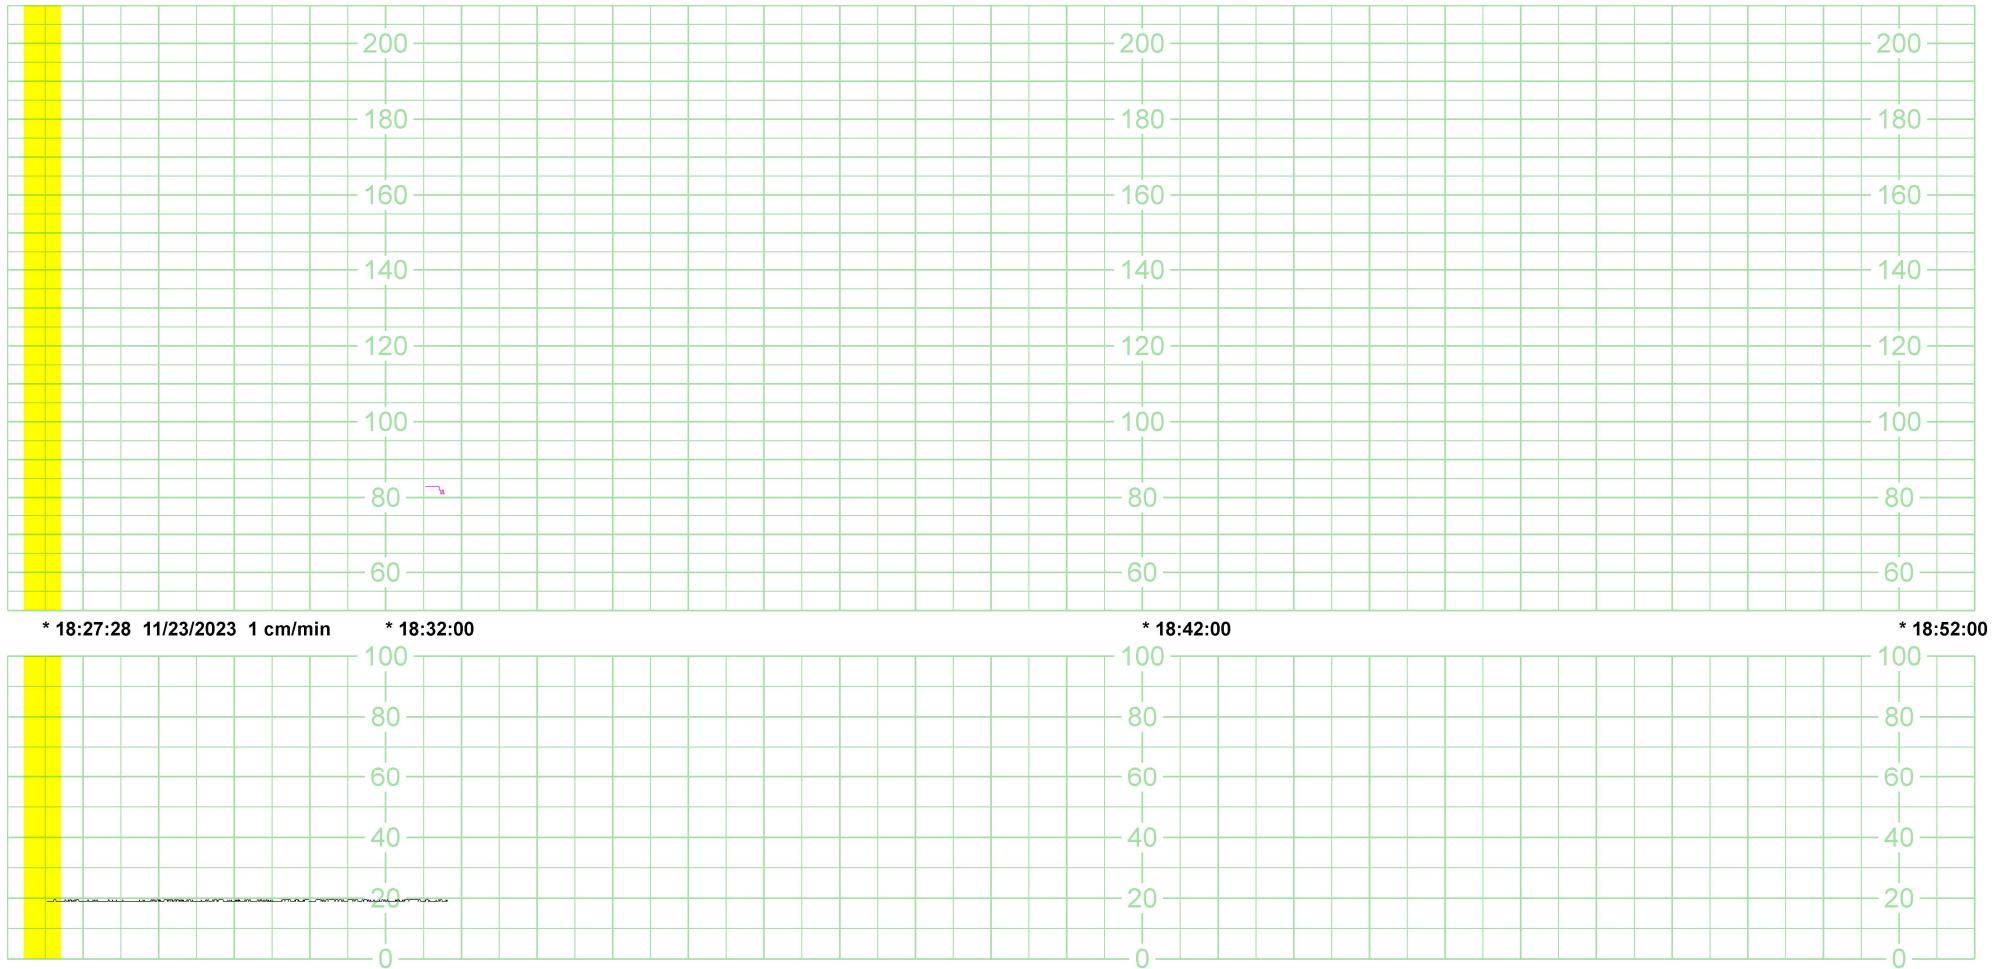


Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Modo Toco: externo
Modo FCM: Pulso Toco
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL.
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco : no transductor
Alarma con acuse de recibo

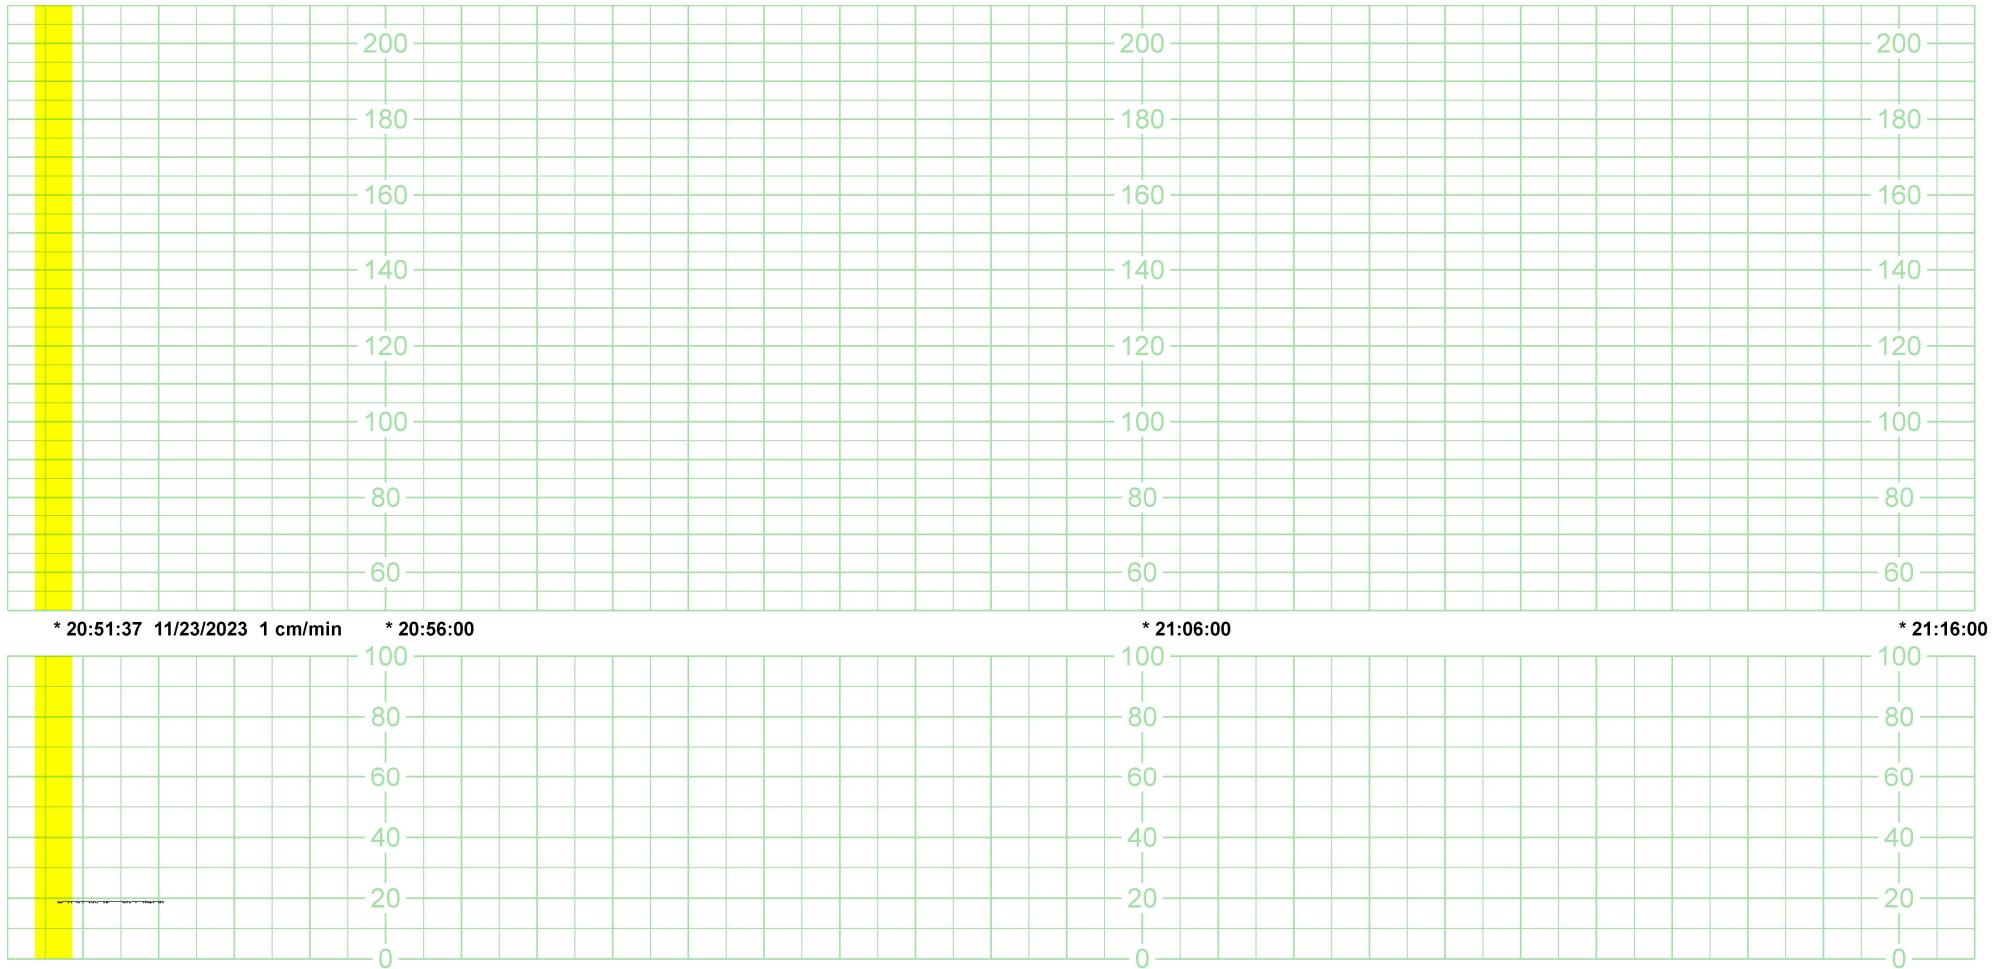


Estado del monitor: Activado
Modo FCFI: US
Estado del FMP: Activado
* FCFI: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: En espera
Modo FCFI: no transductor
Modo Toco: no transductor
Alarma con acuse de recibo

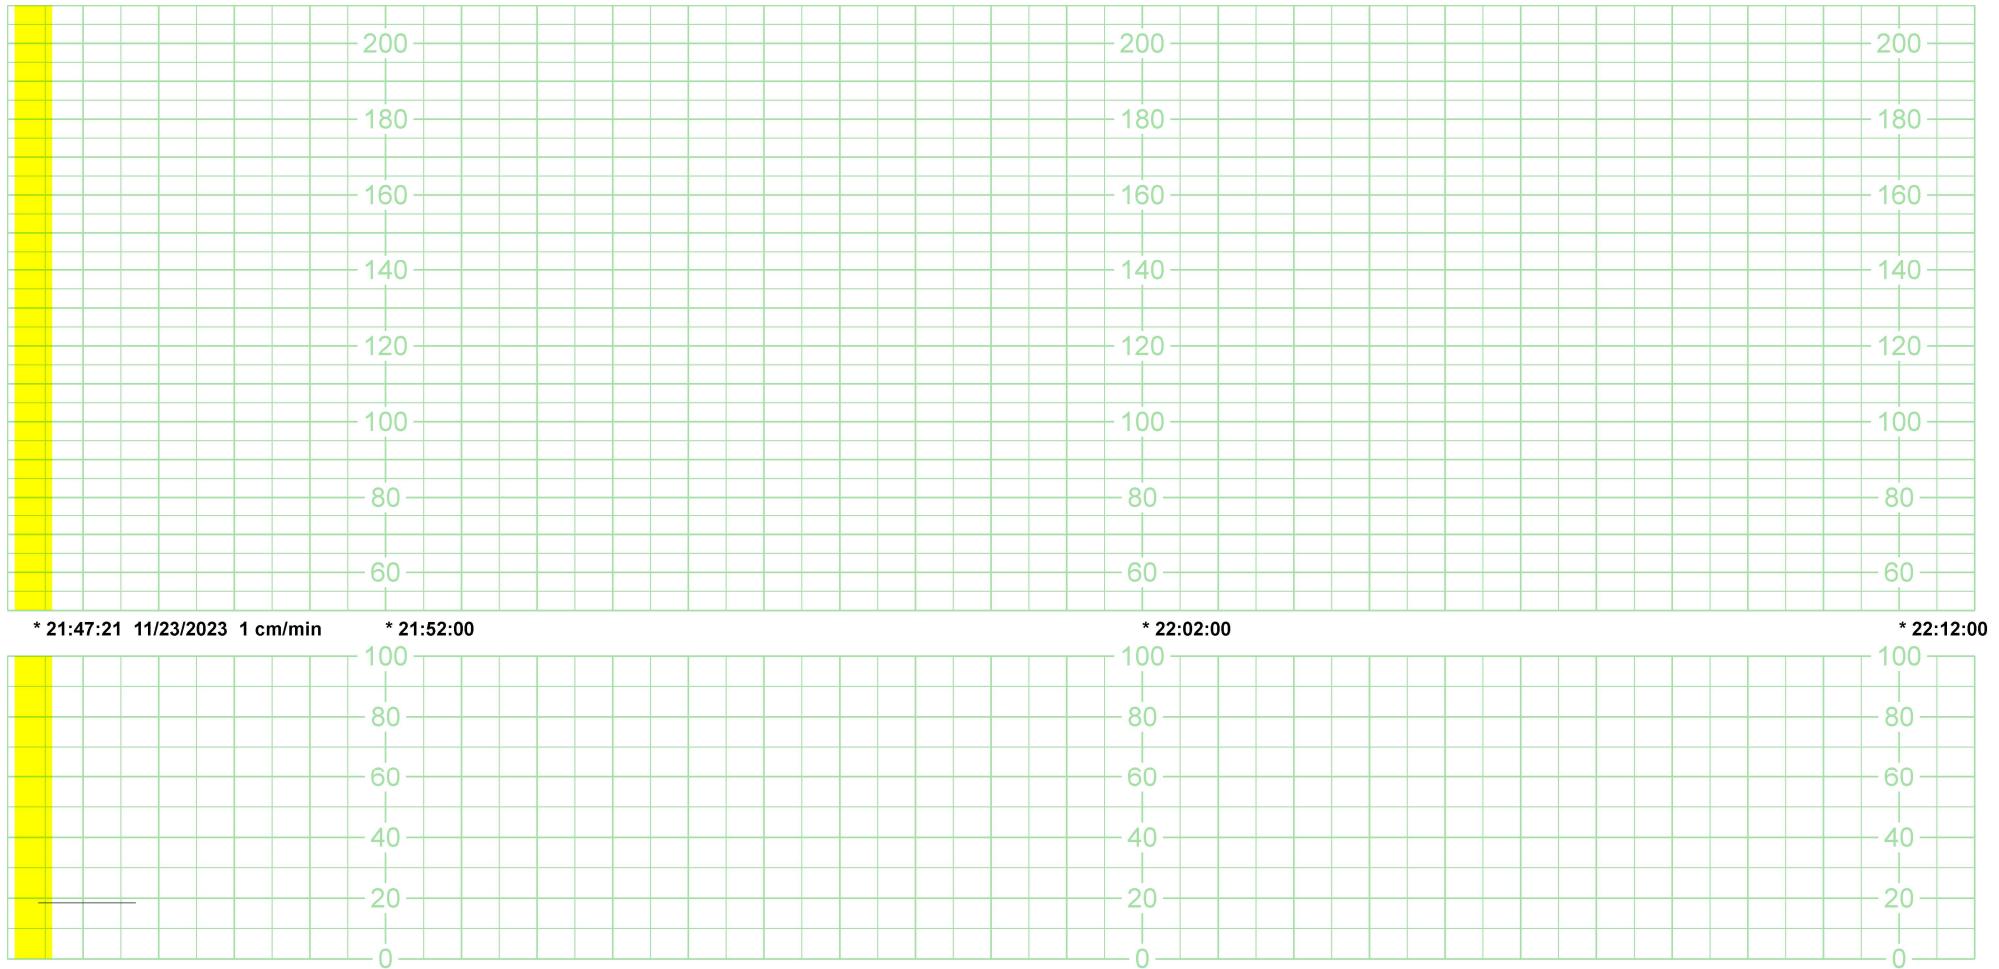

Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco : externo
Estado del FMP: Activado
Modo FCM: SpO2
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo
Modo Toco : no transductor
Modo FCF: no transductor
Estado del monitor: En espera

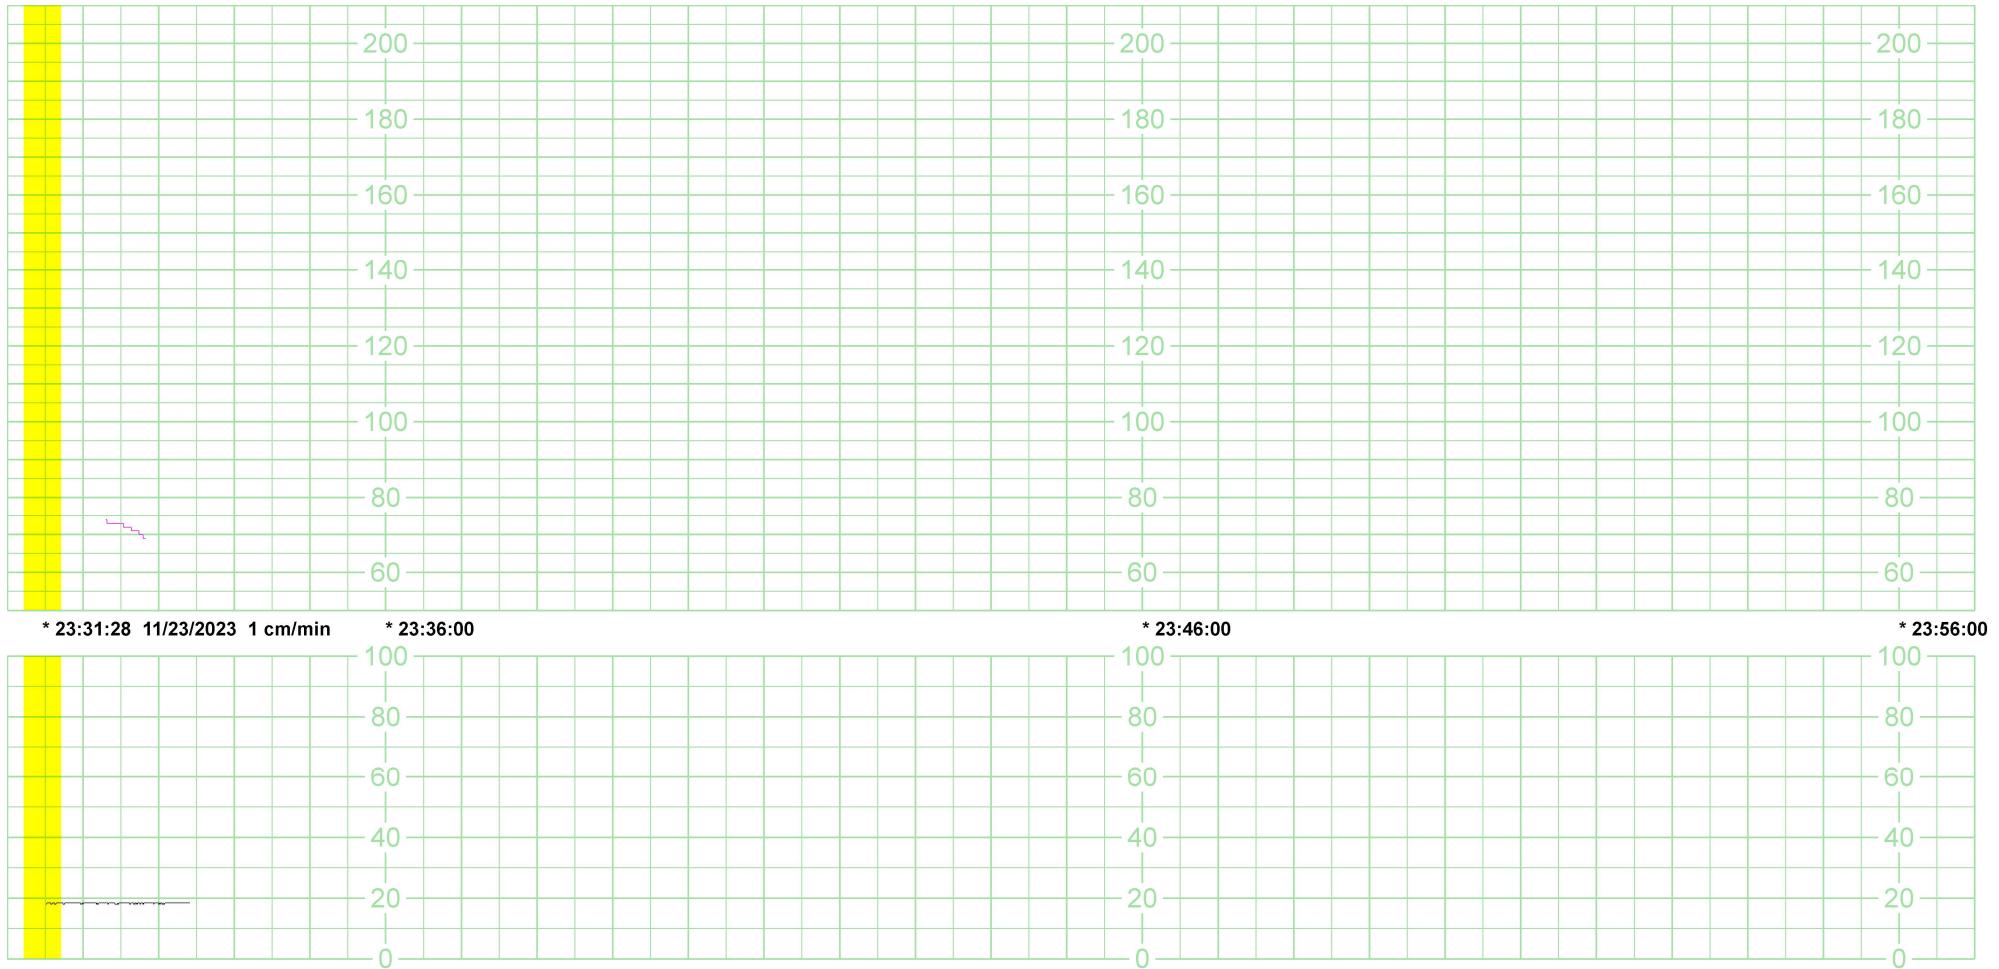

Estado del monitor: En espera

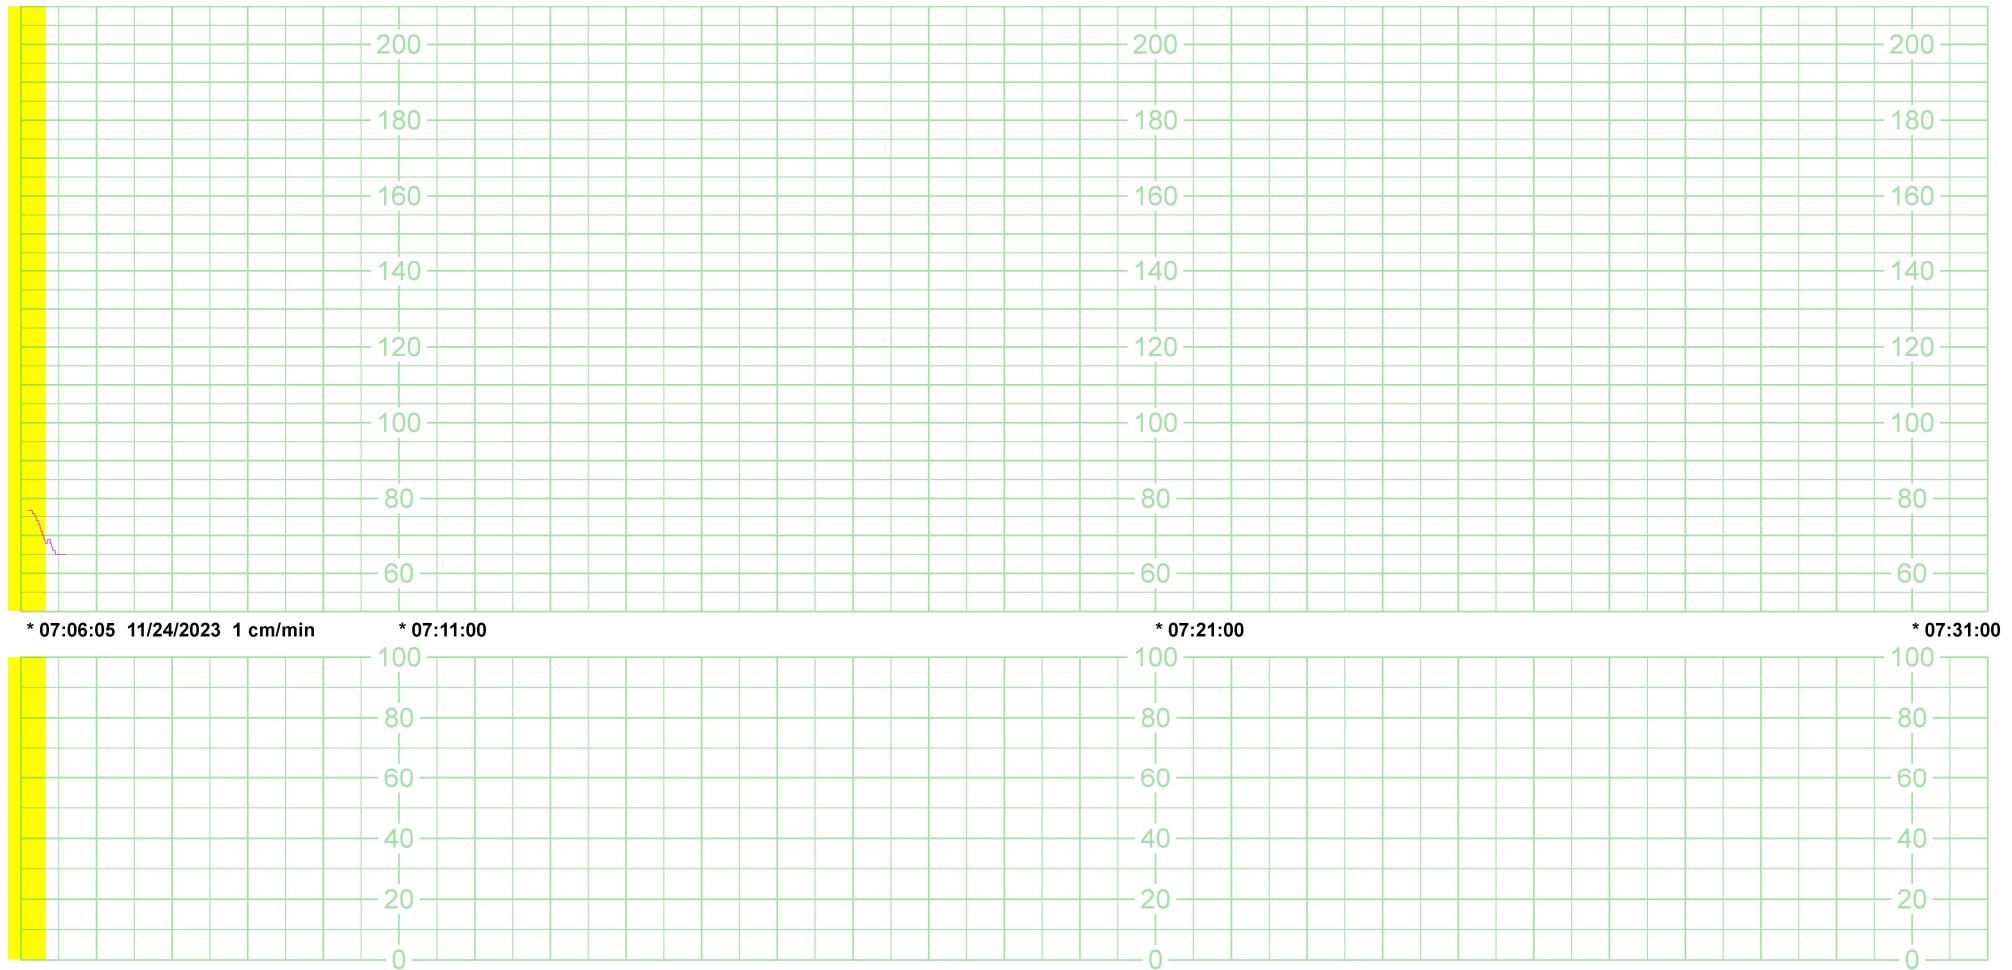


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo


* FCF1: PERDIDA SEÑAL

Modo FCM: Pulso Toco

Alarma con acuse de recibo

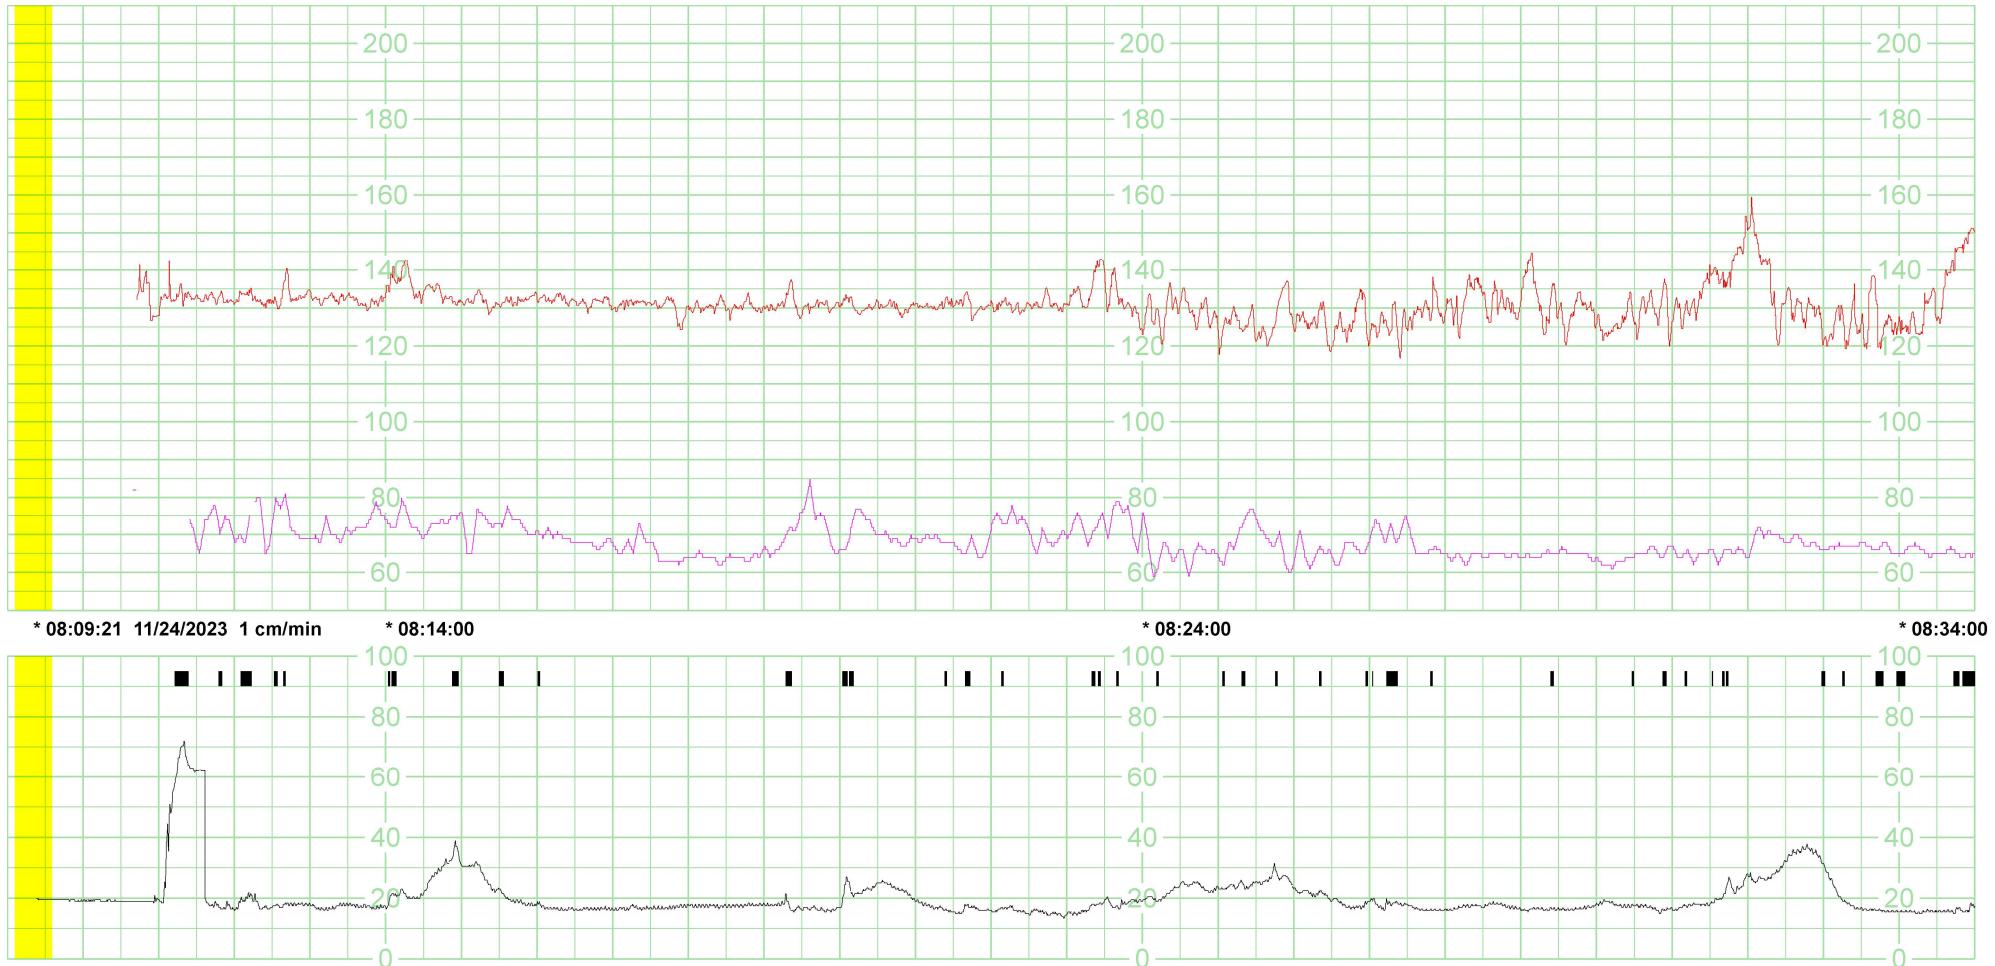


Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor

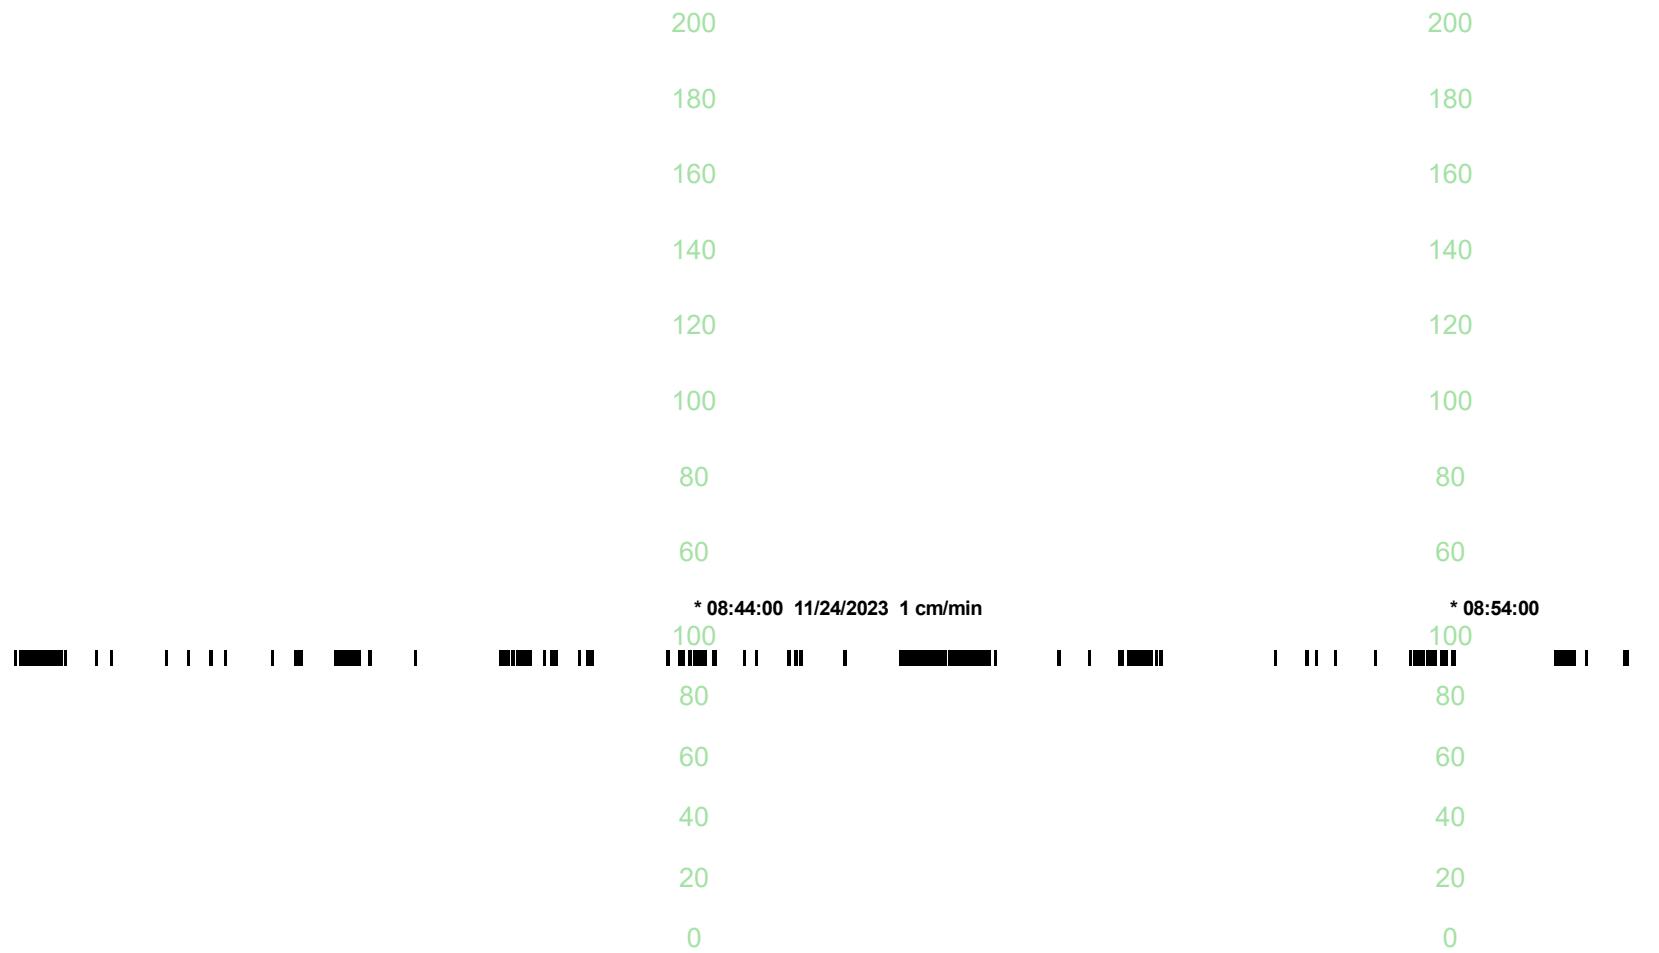


Estado del monitor: Activado
Modo FCFI: US
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCFI: no transductor


Estado del monitor: Activado
Modo FCFI: US
Estado del FMP: Activado

Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Modo FCM: Pulso Toco
Estado del monitor: En espera

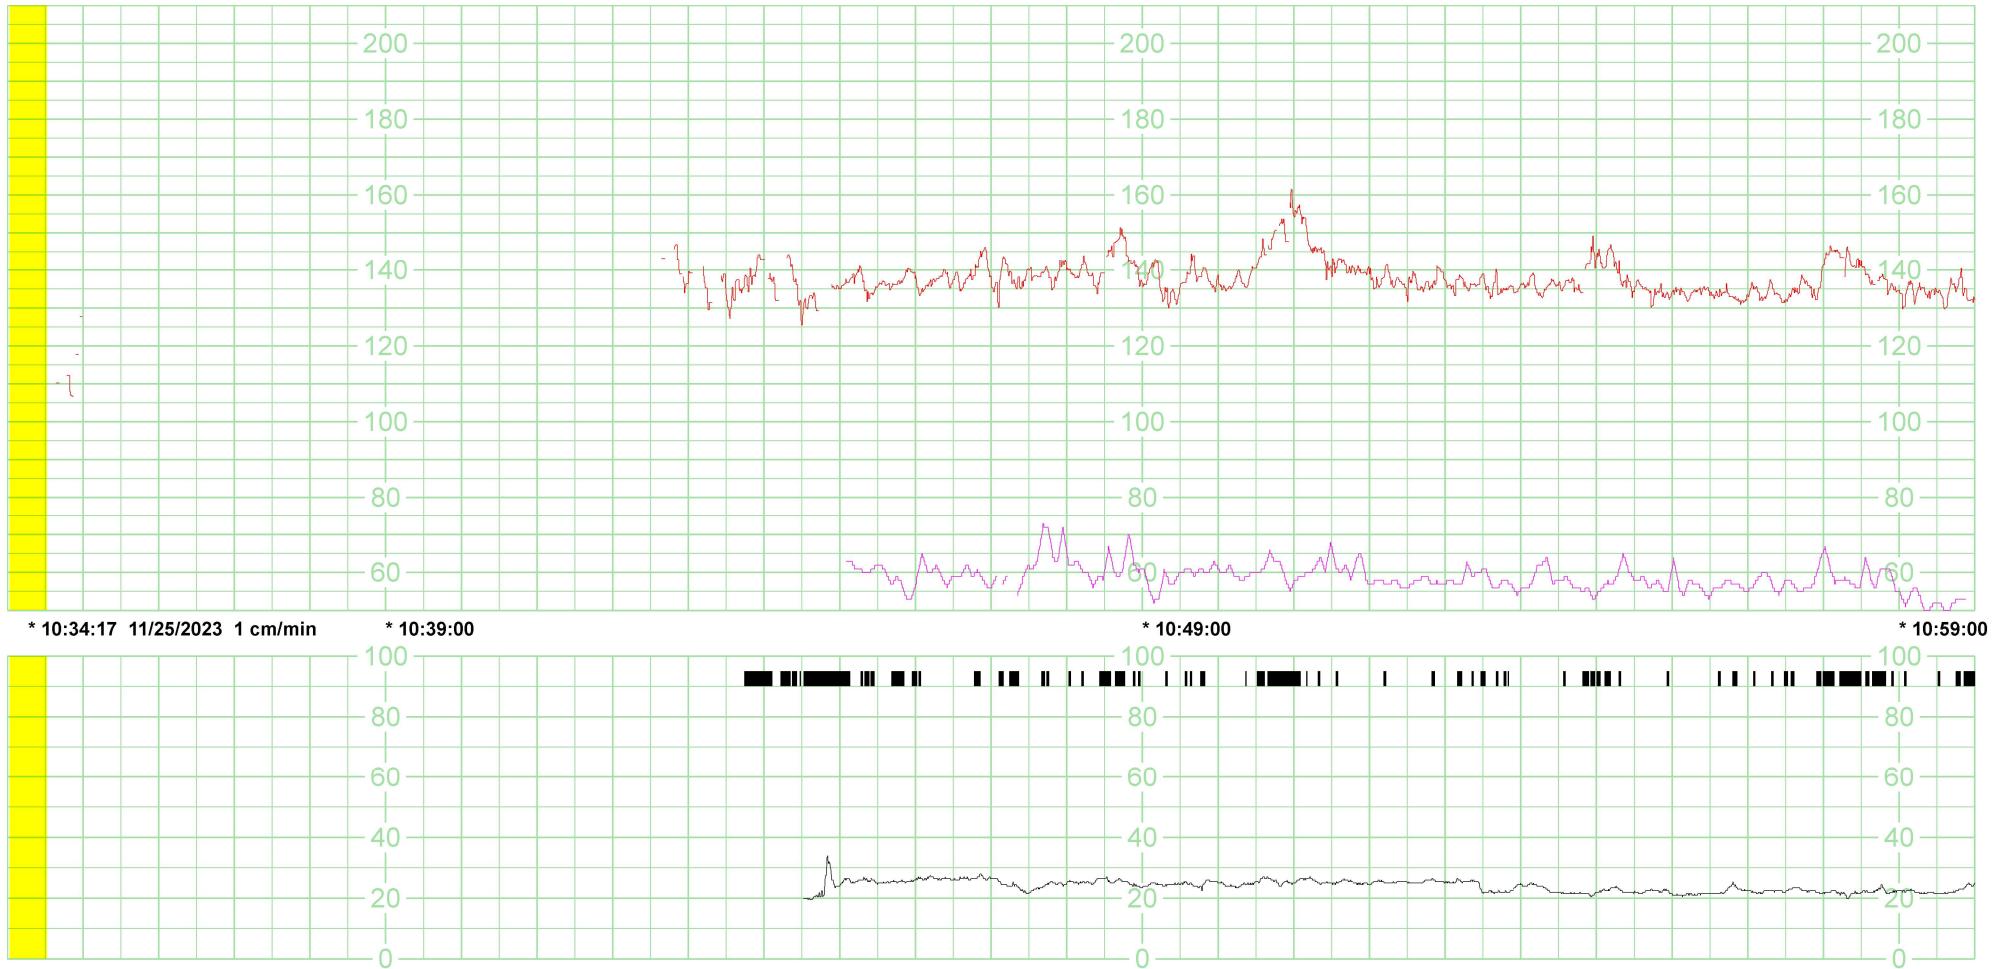

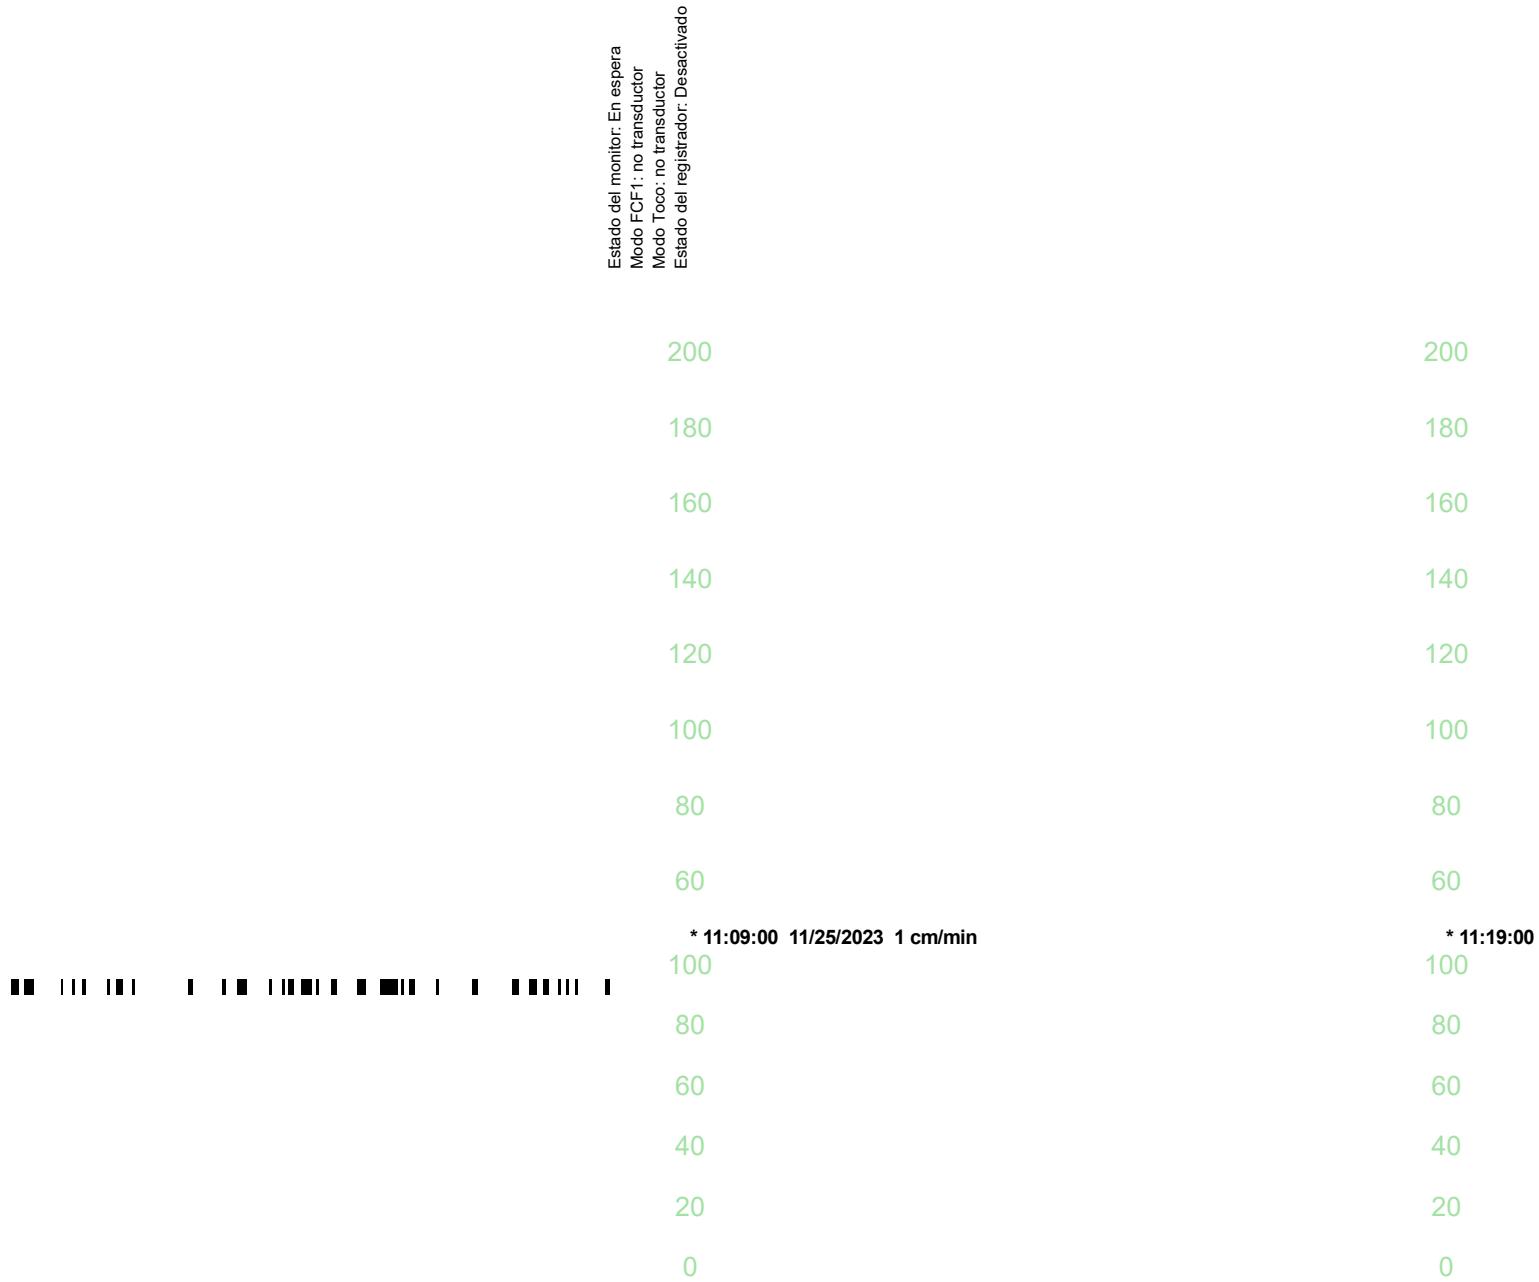


Estado del monitor: Activado
Modo FCFI: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
* FCFI: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: En espera
Modo FCFI: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Alarma con ause de recibo

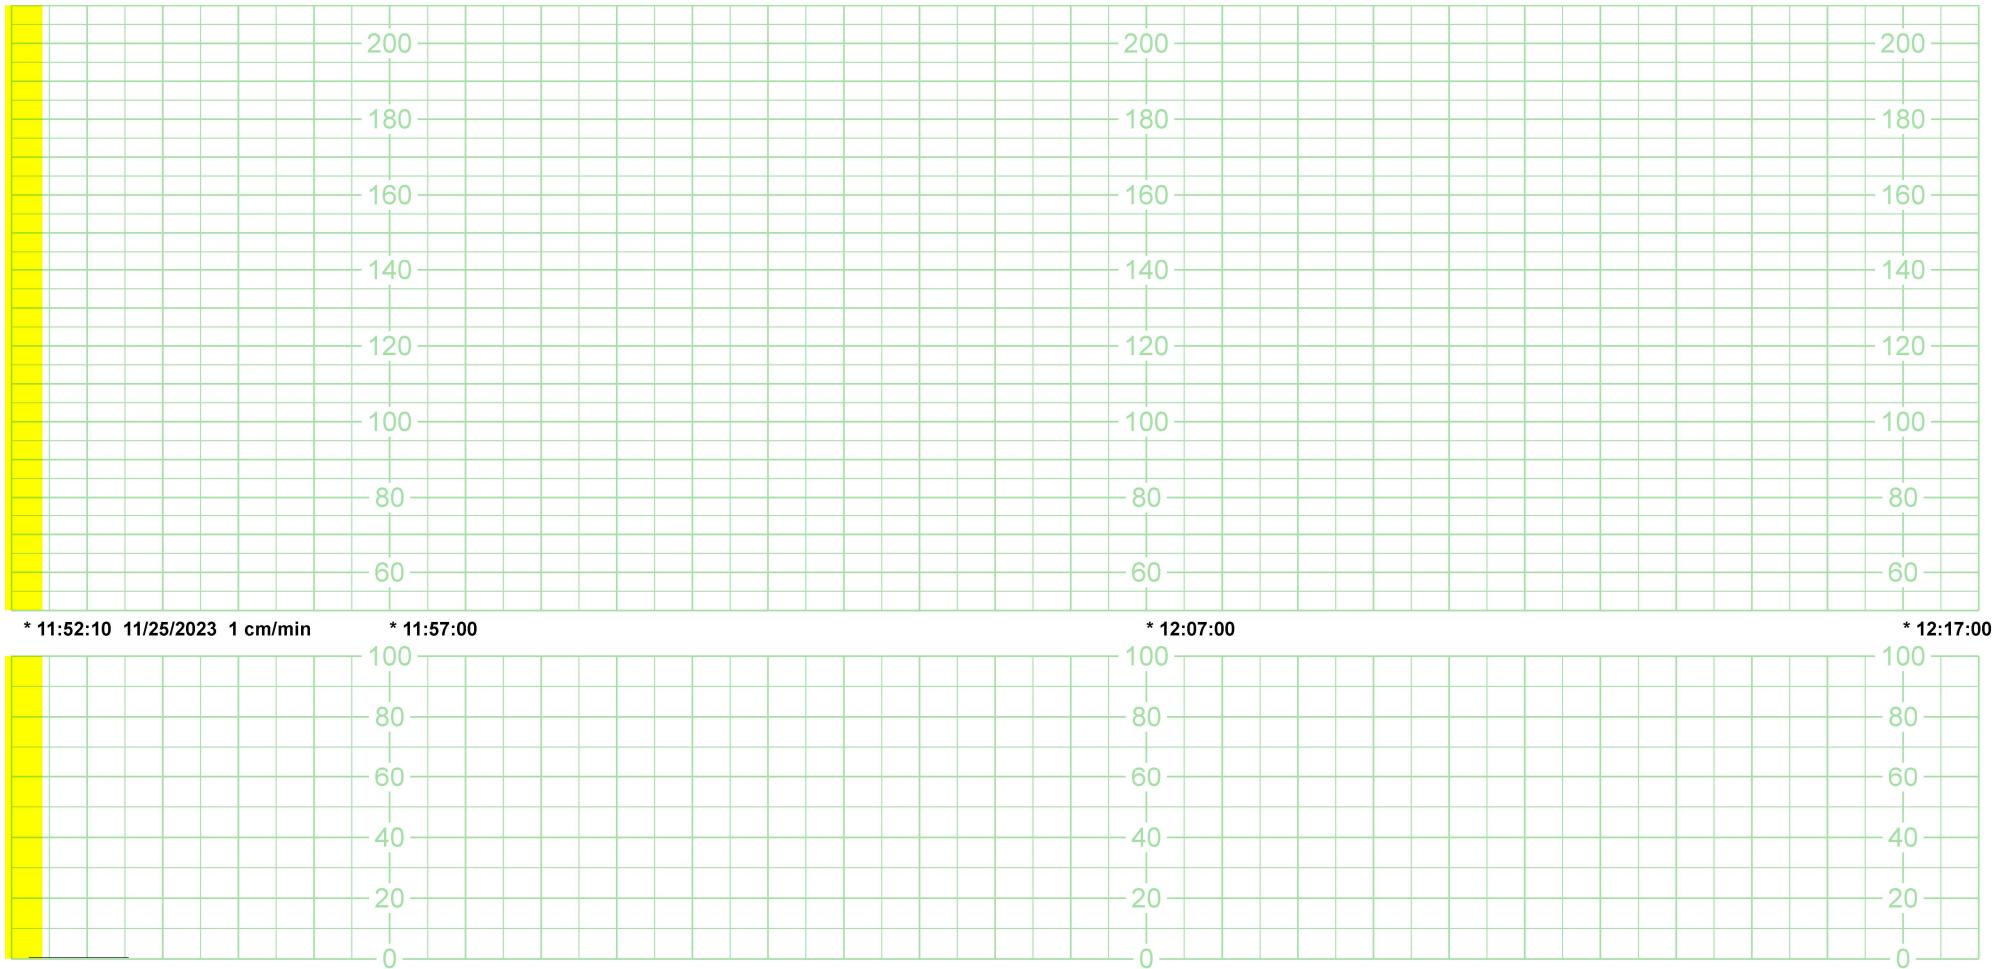


Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCF1: US
Modo Toco: externo
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo


** FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo

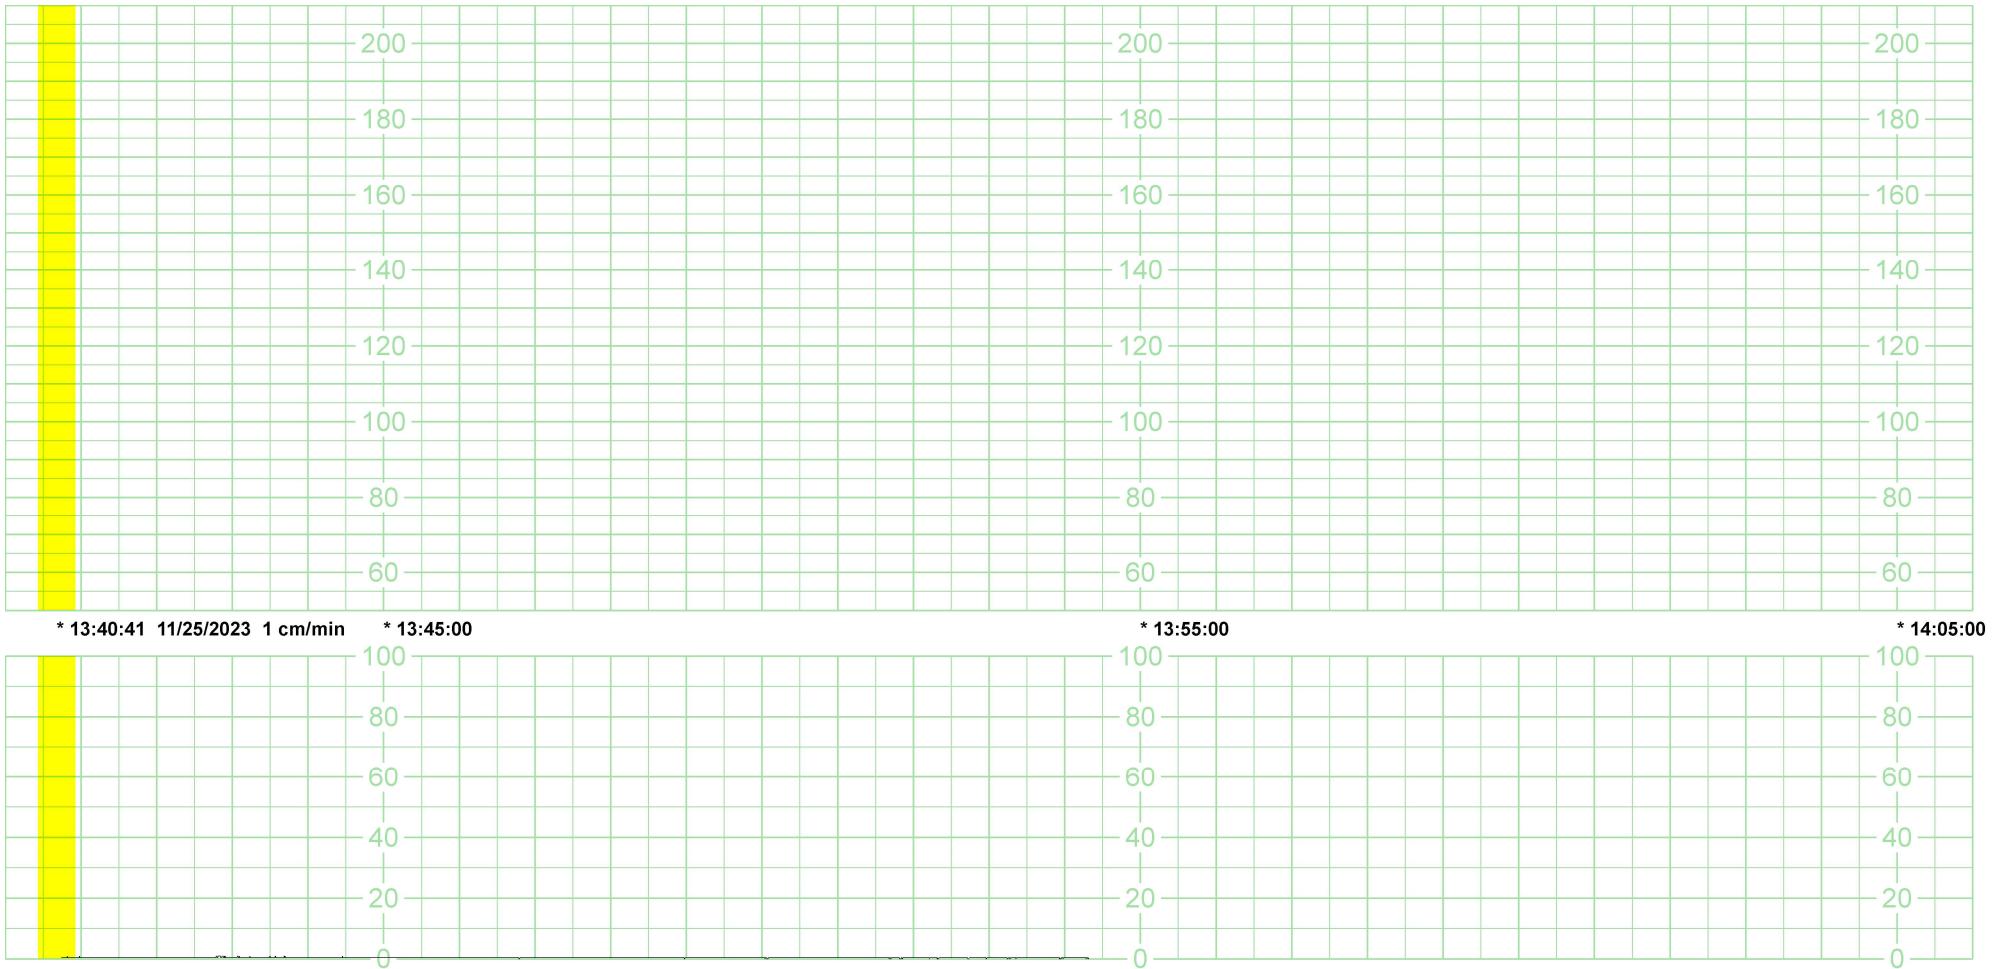

Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2/03A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA PACIENTE
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

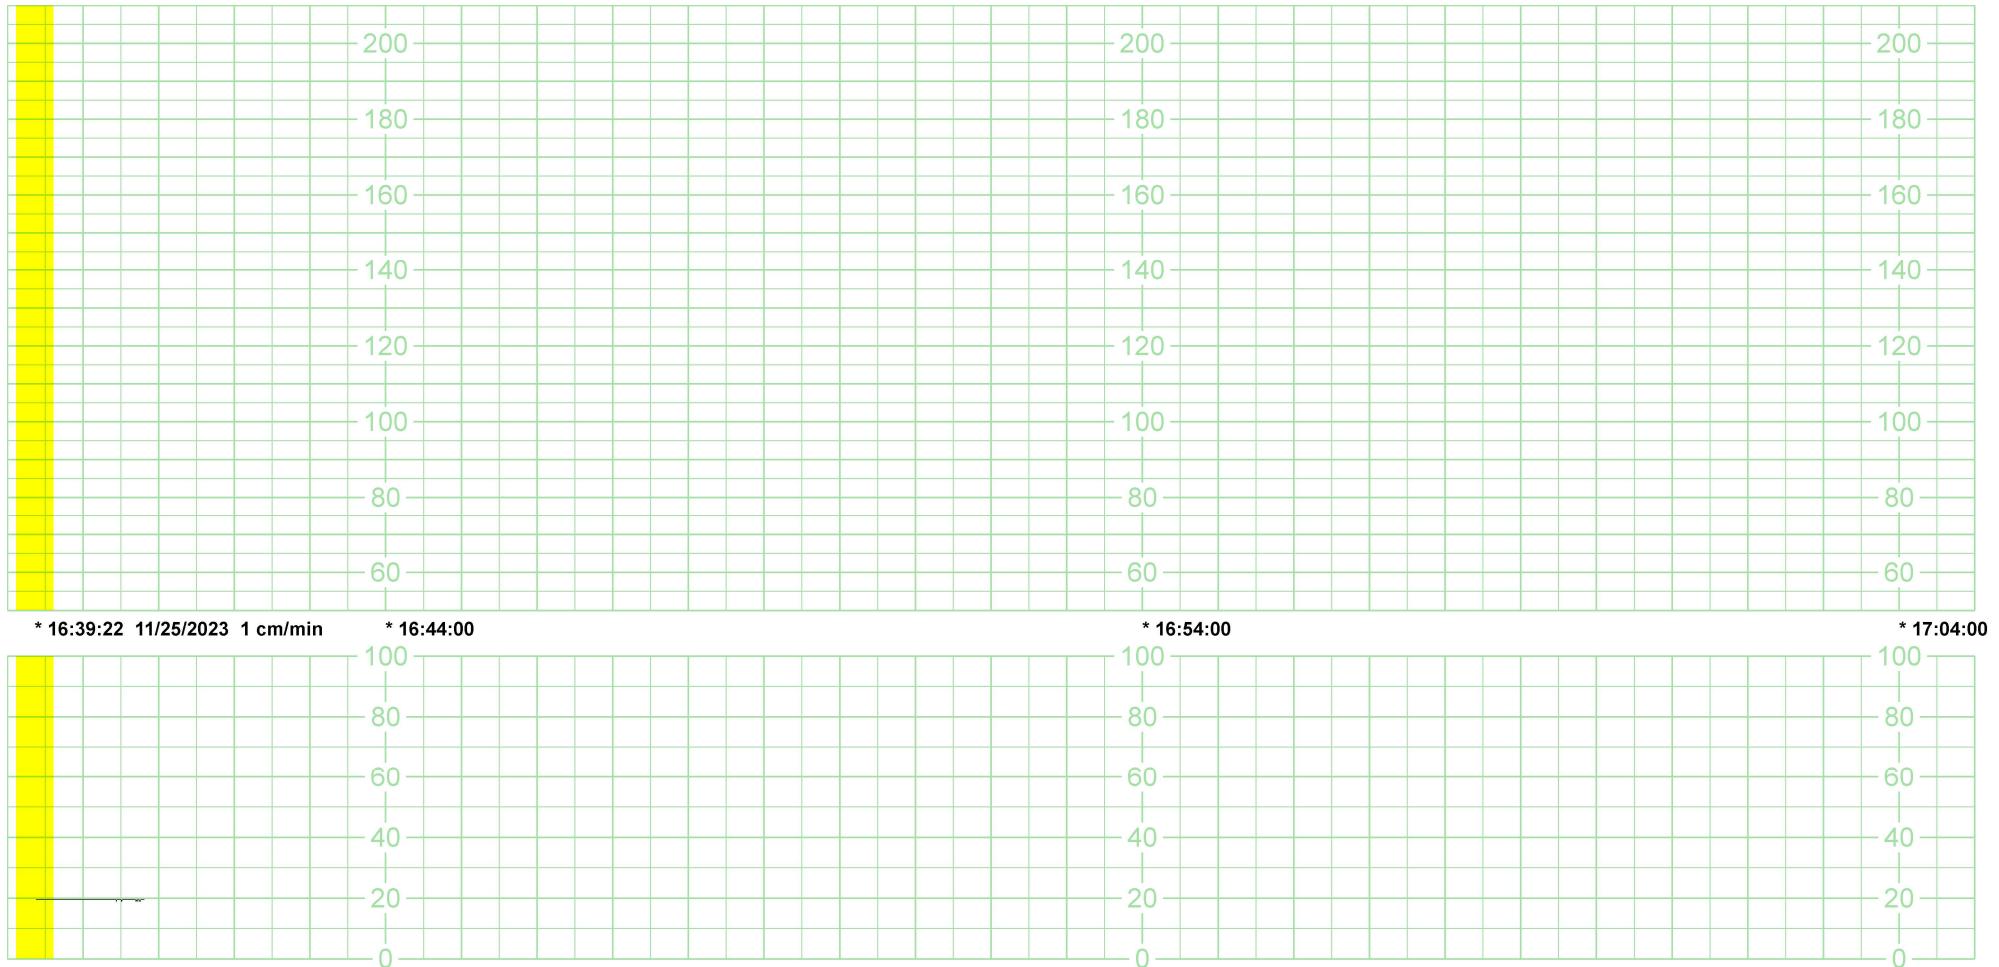

Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor
AJUSTES DE ALARMAS PARA PACIENTE

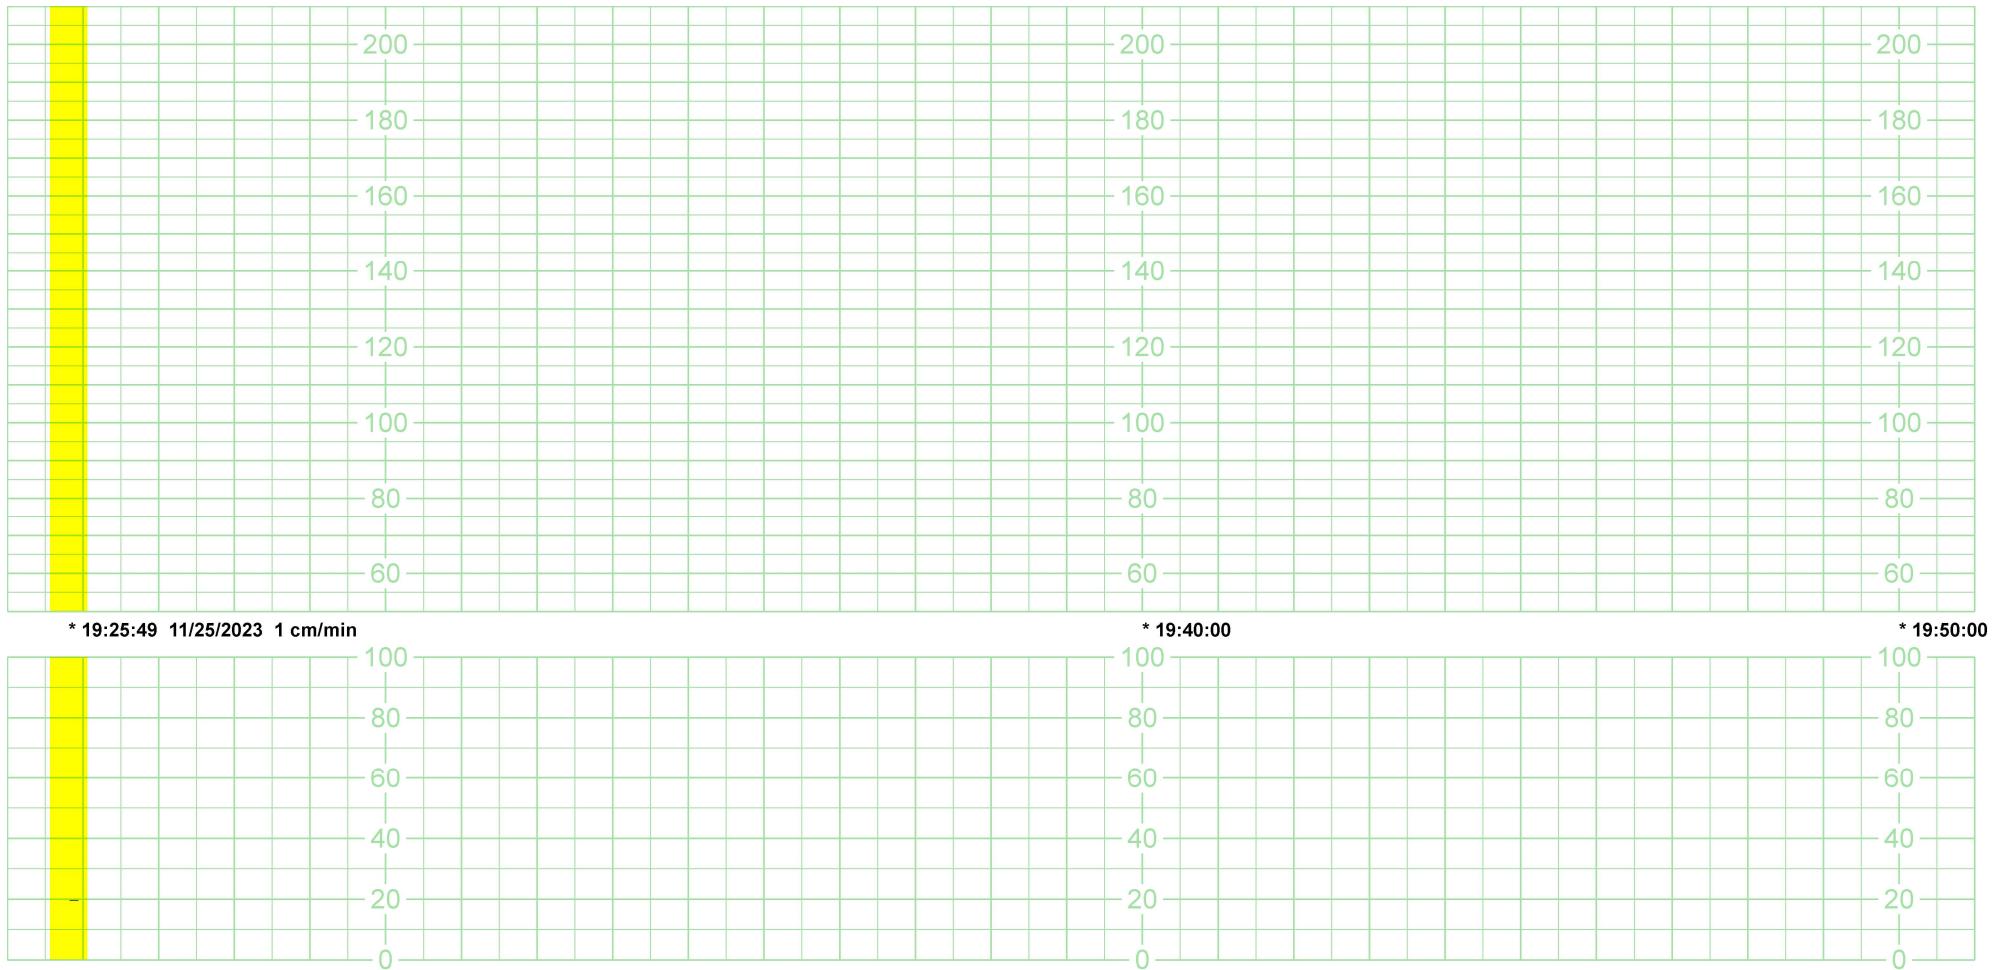


Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado


Modo Toco: externo


Estado del registrador: Activado

* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recebo


** FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recebo

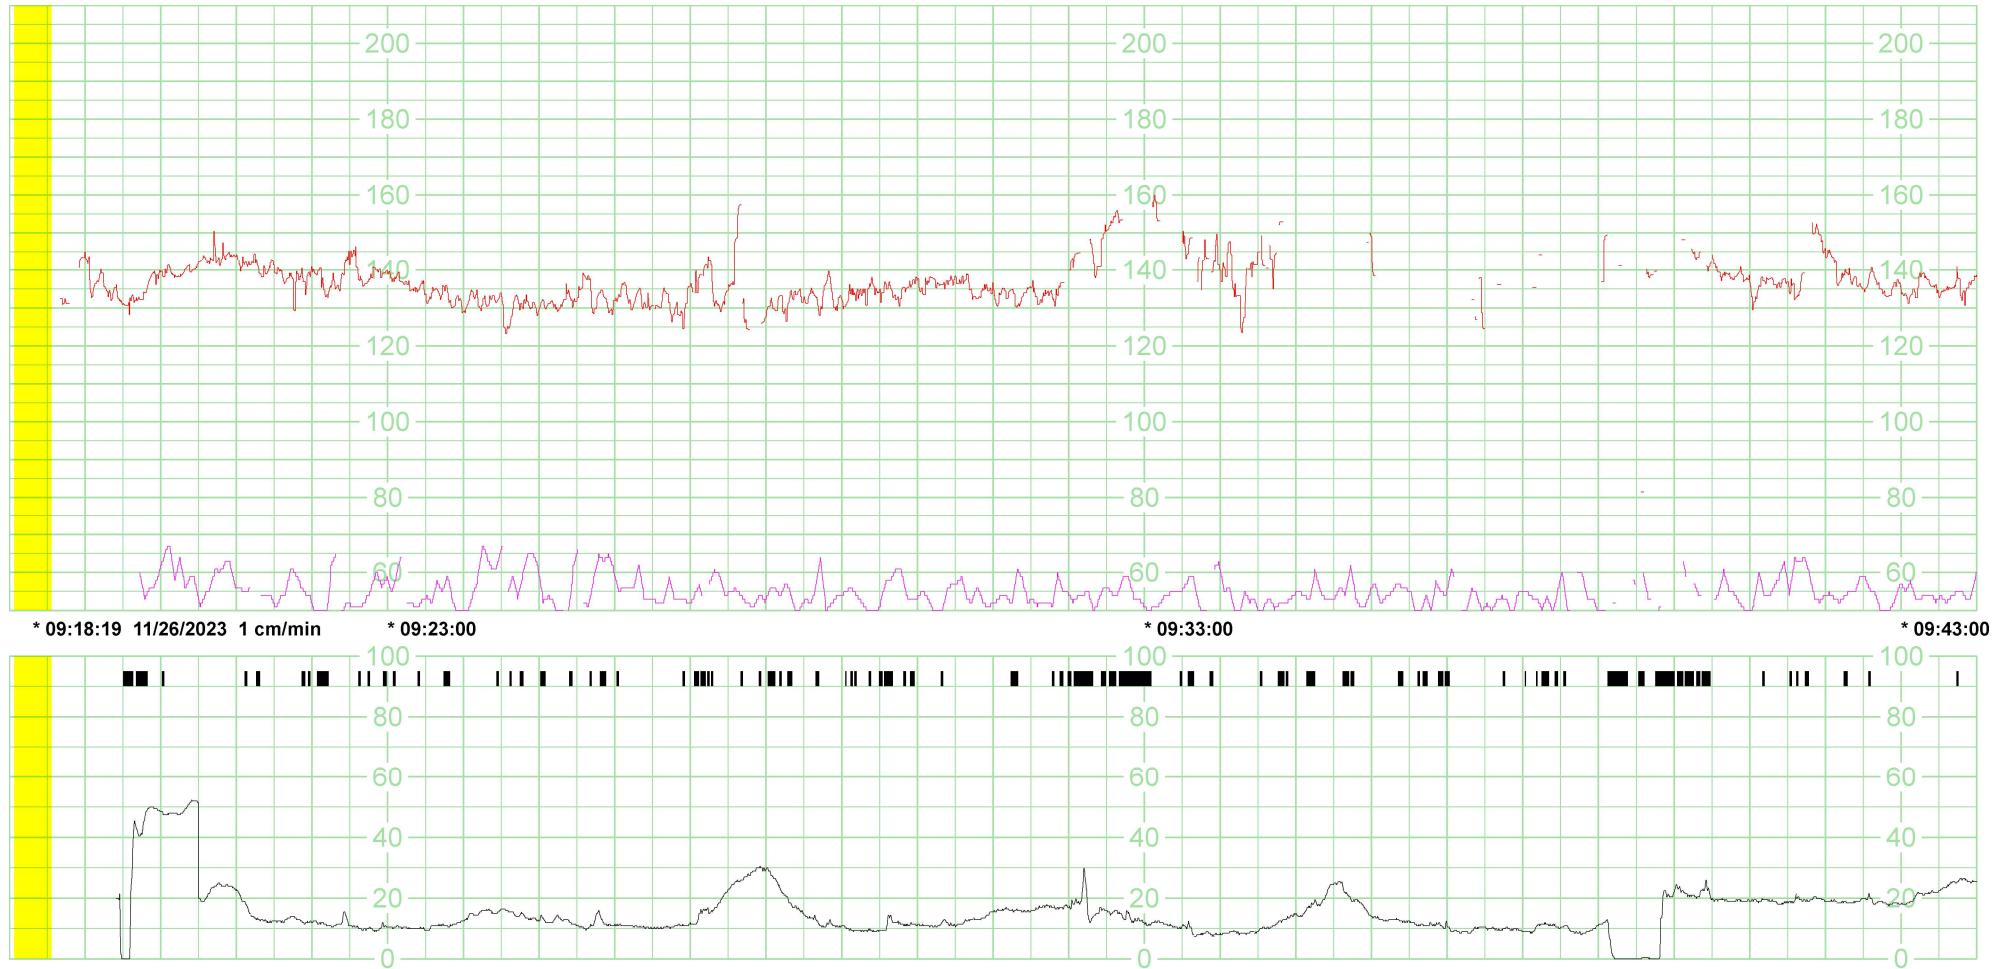

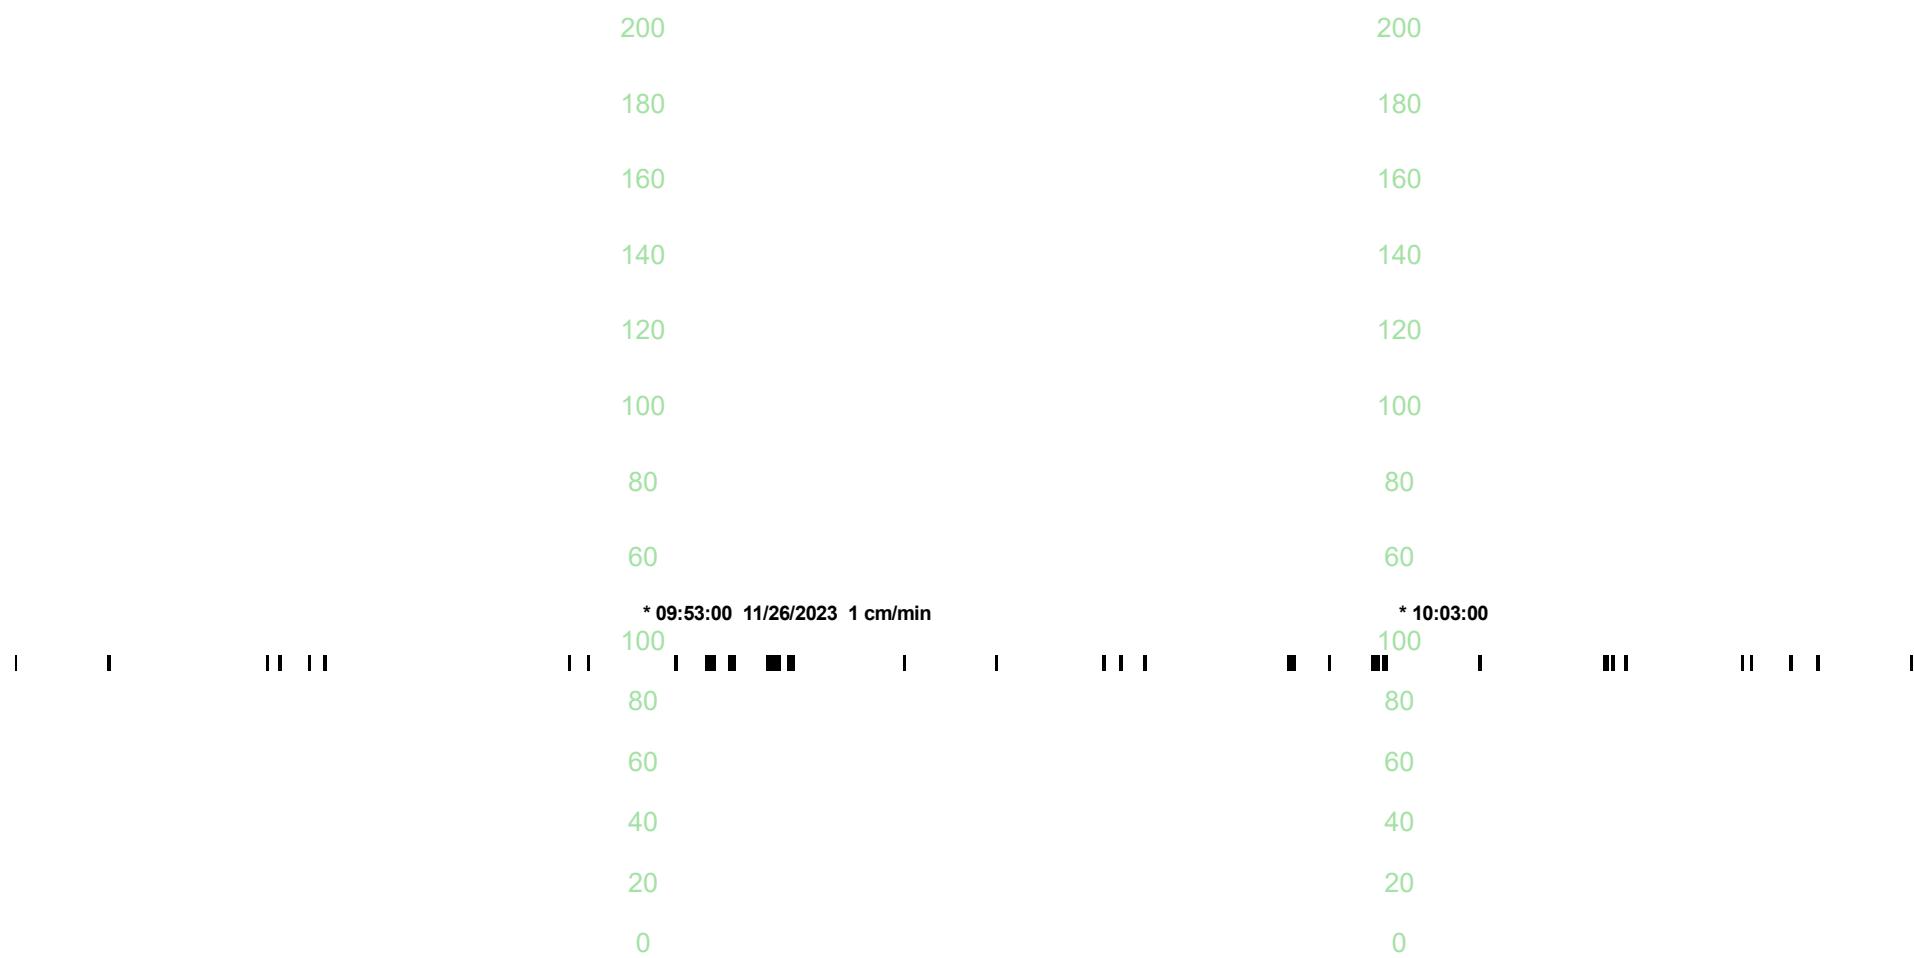


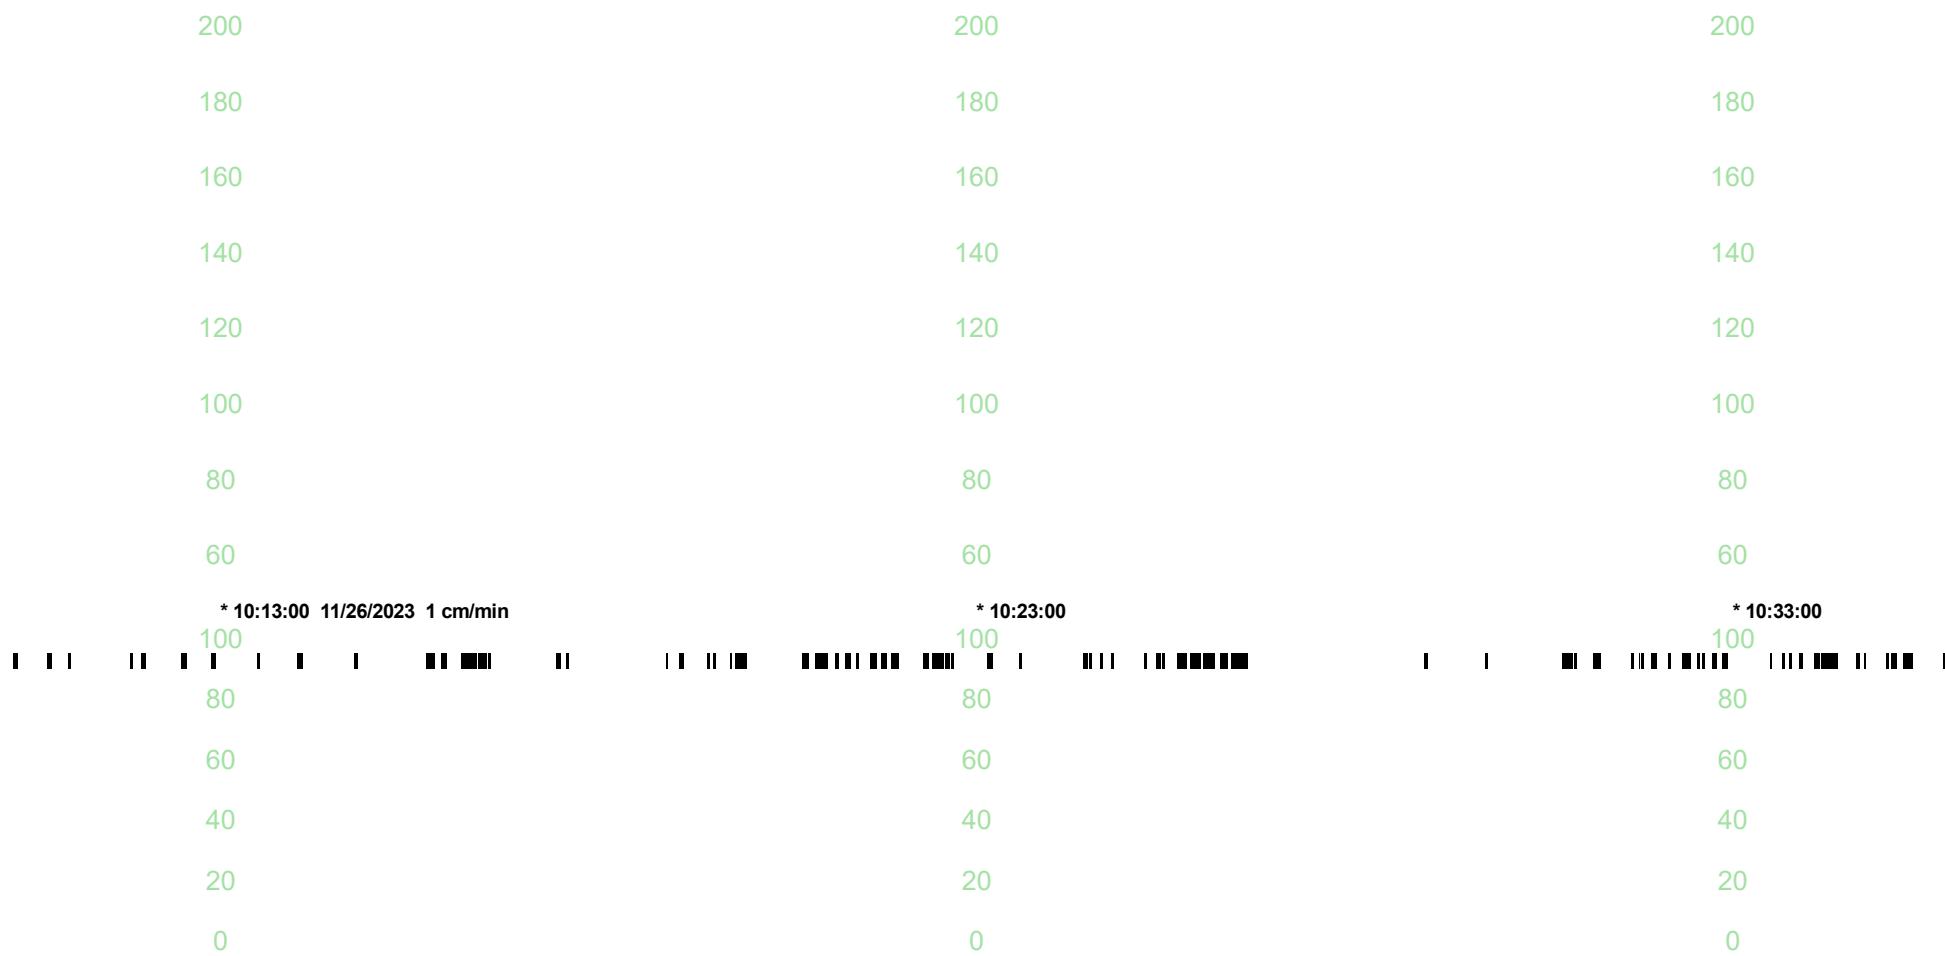


Estado del monitor: Desactivado

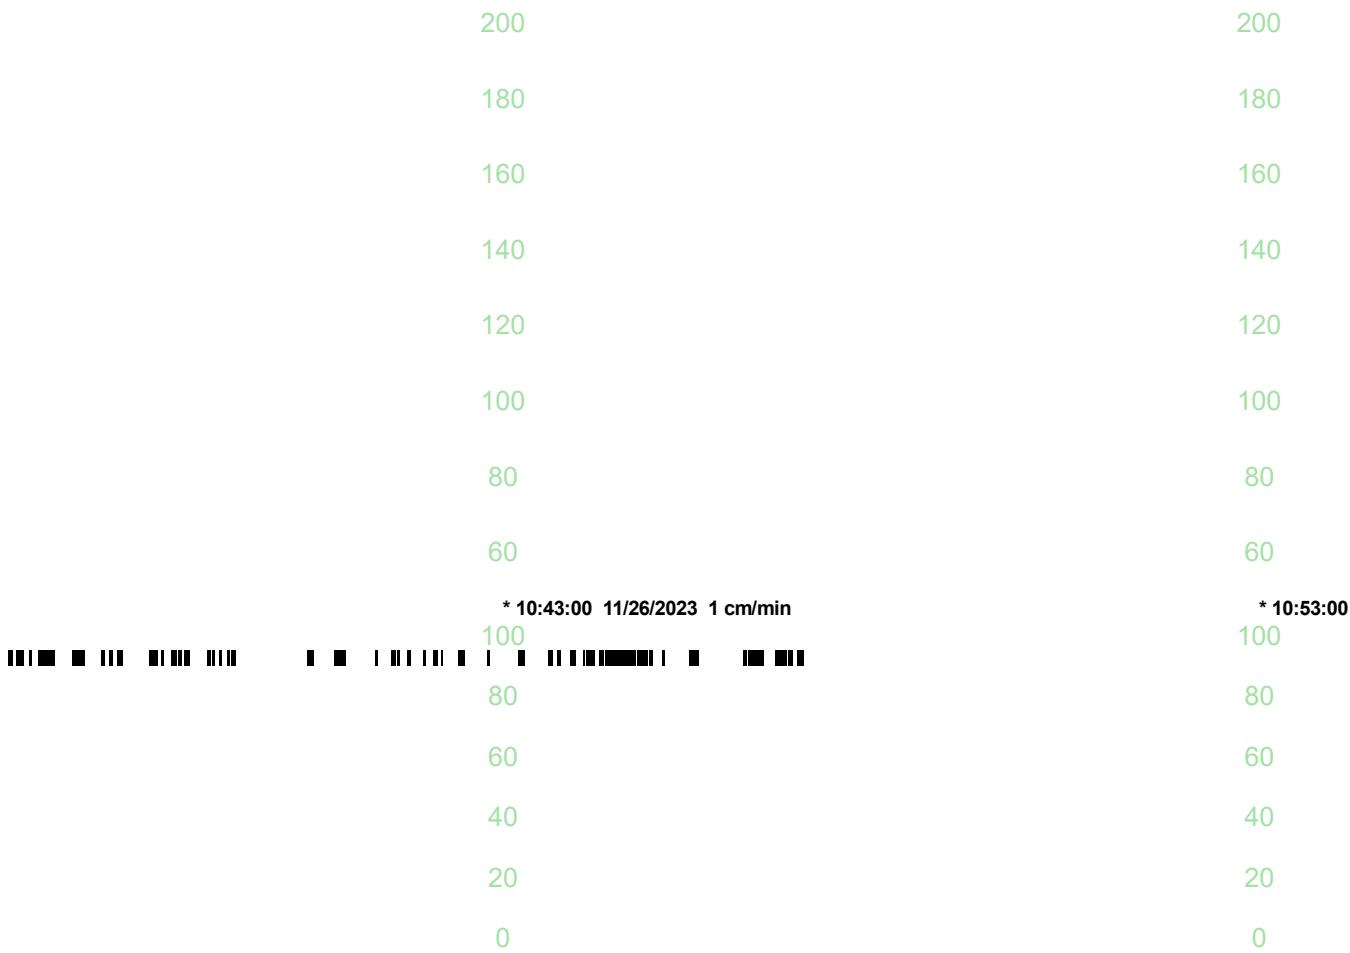

Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
ID del Monitor: M2703A
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
Estado del monitor: Desactivado

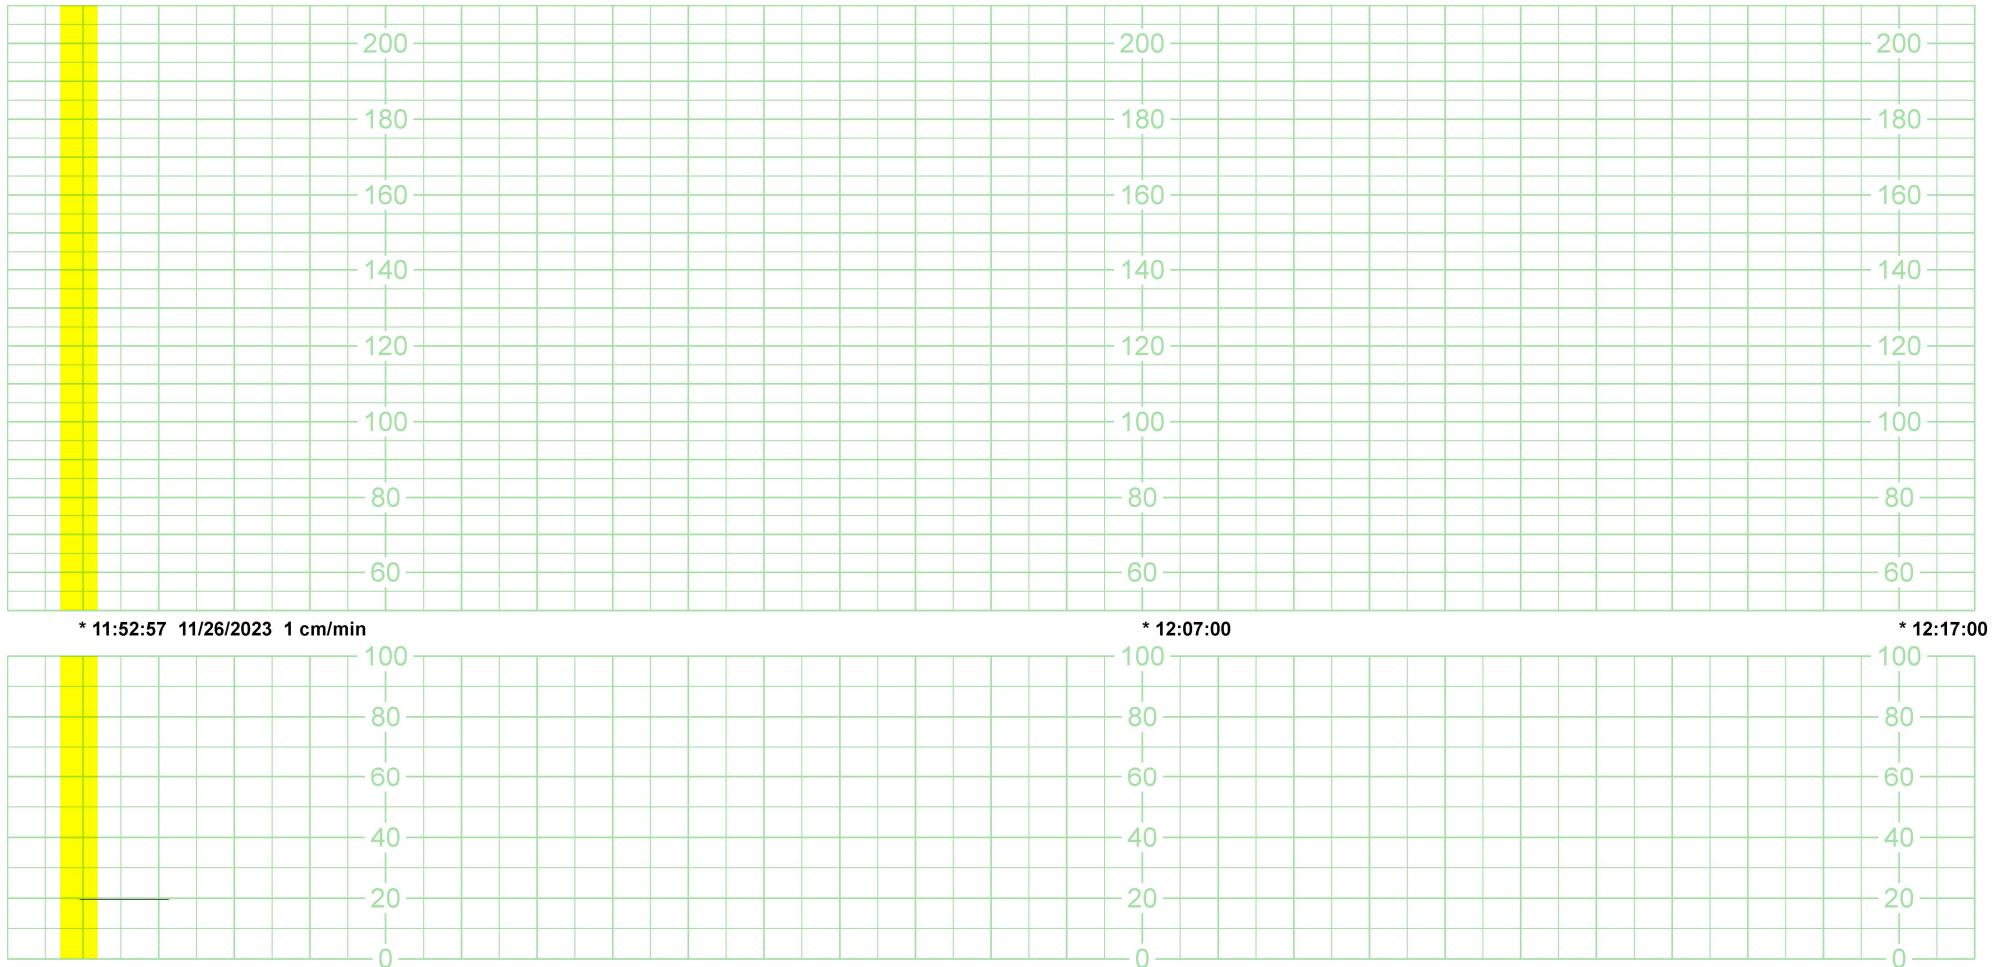

Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
Estado del registrador: Activado

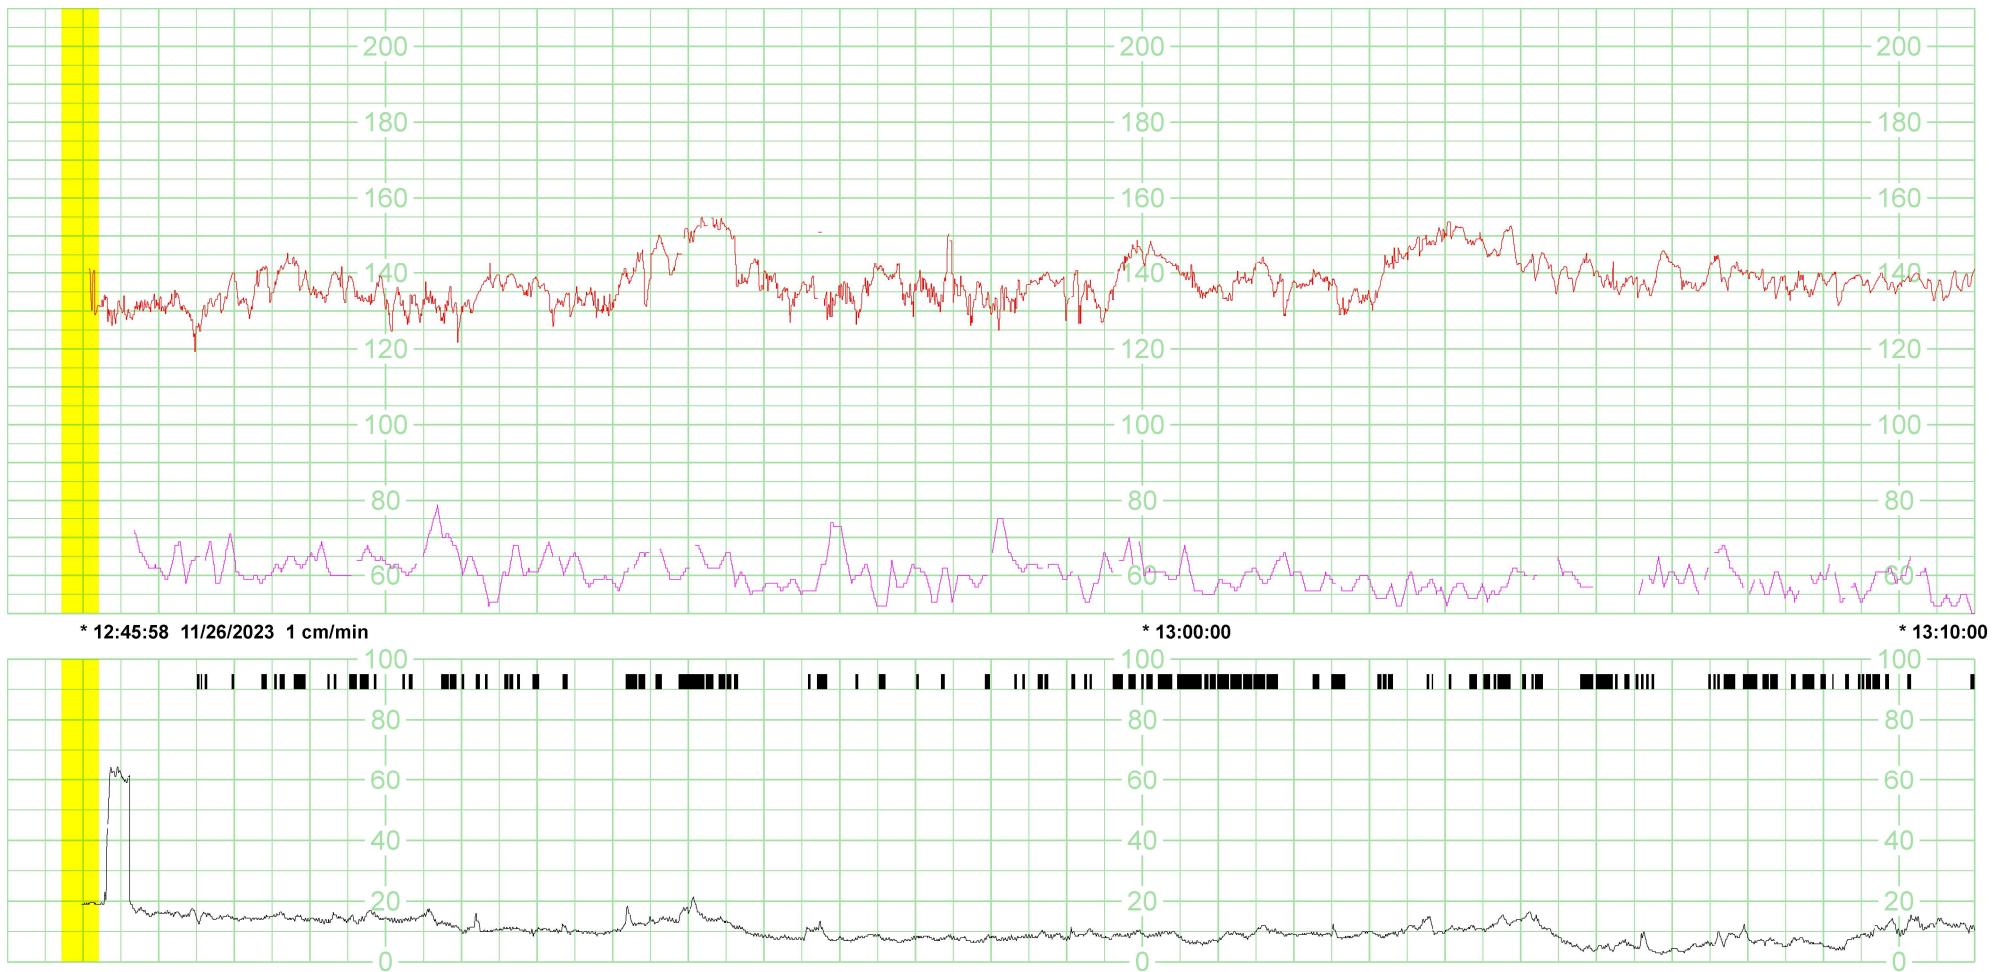



Estado del monitor: Desactivado

Estado del monitor: Activado

ID del Monitor: M2703A

Estado del registrador: Desactivado

Modo FCFI: no transductor

Modo Toco: no transductor

Modo Toco: externo

Modo FCFI: US

Estado del FMP: Activado

AJUSTES DE ALARMAS PARA

PACIENTE

Estado del registrador: Activado

Estado del monitor: Desactivado


200
180
160
140
120
100
80
60
100
80
60
40
20
0

* 13:20:00 11/26/2023 1 cm/min


200
180
160
140
120
100
80
60
100
80
60
40
20
0

* 13:30:00


Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
*FCF1:PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

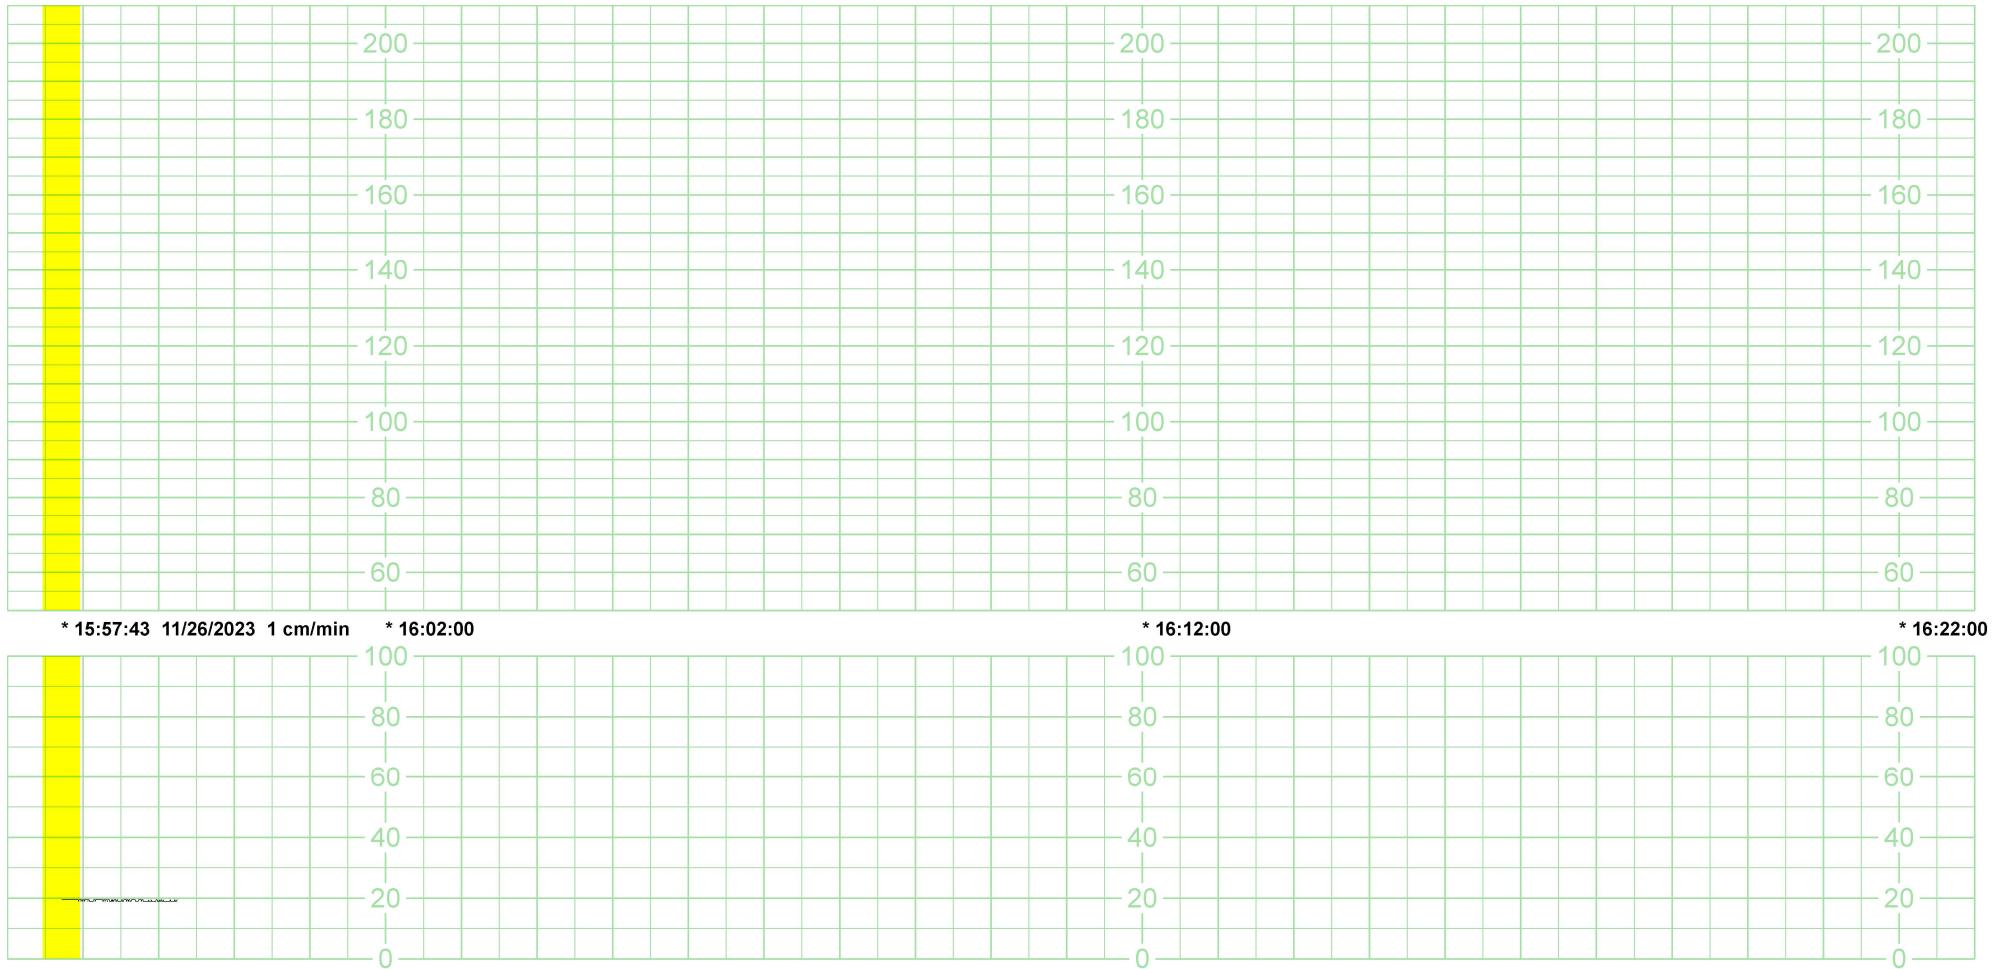


Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del IFMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
Estado del monitor: Desactivado

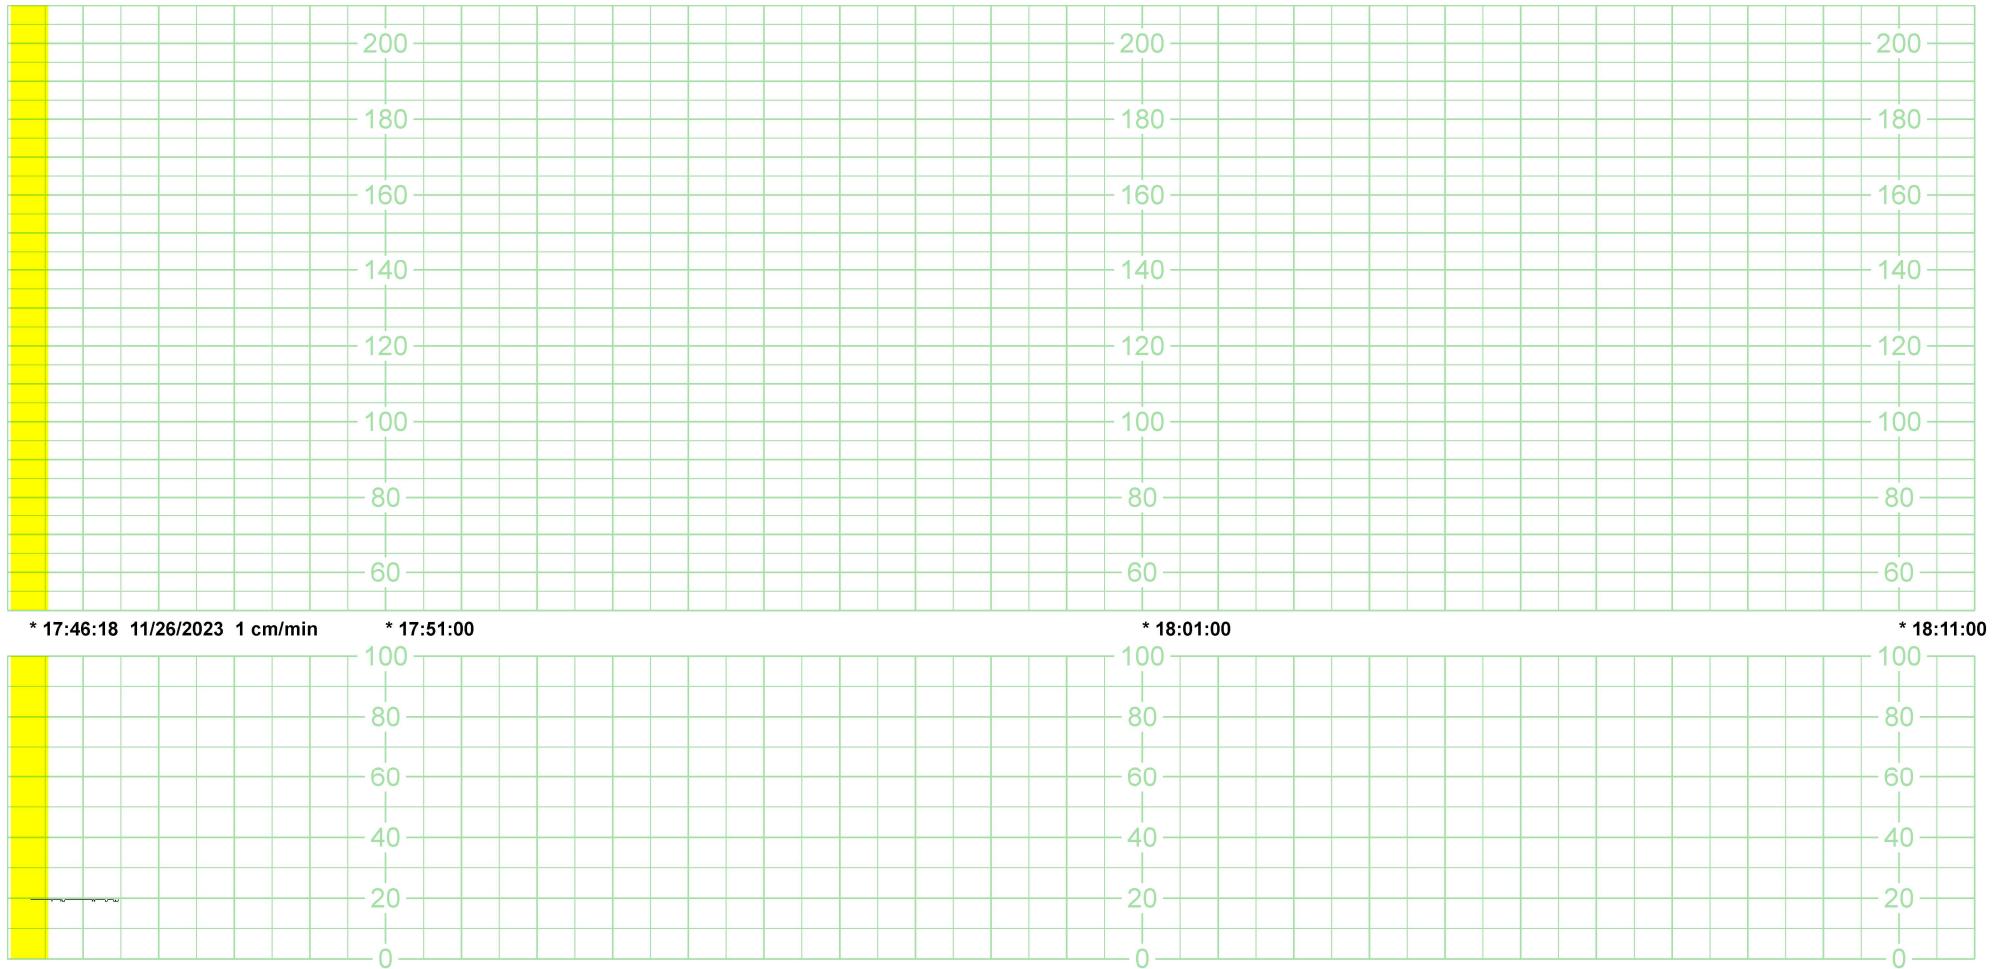


Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
ID del Monitor: M2703A
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

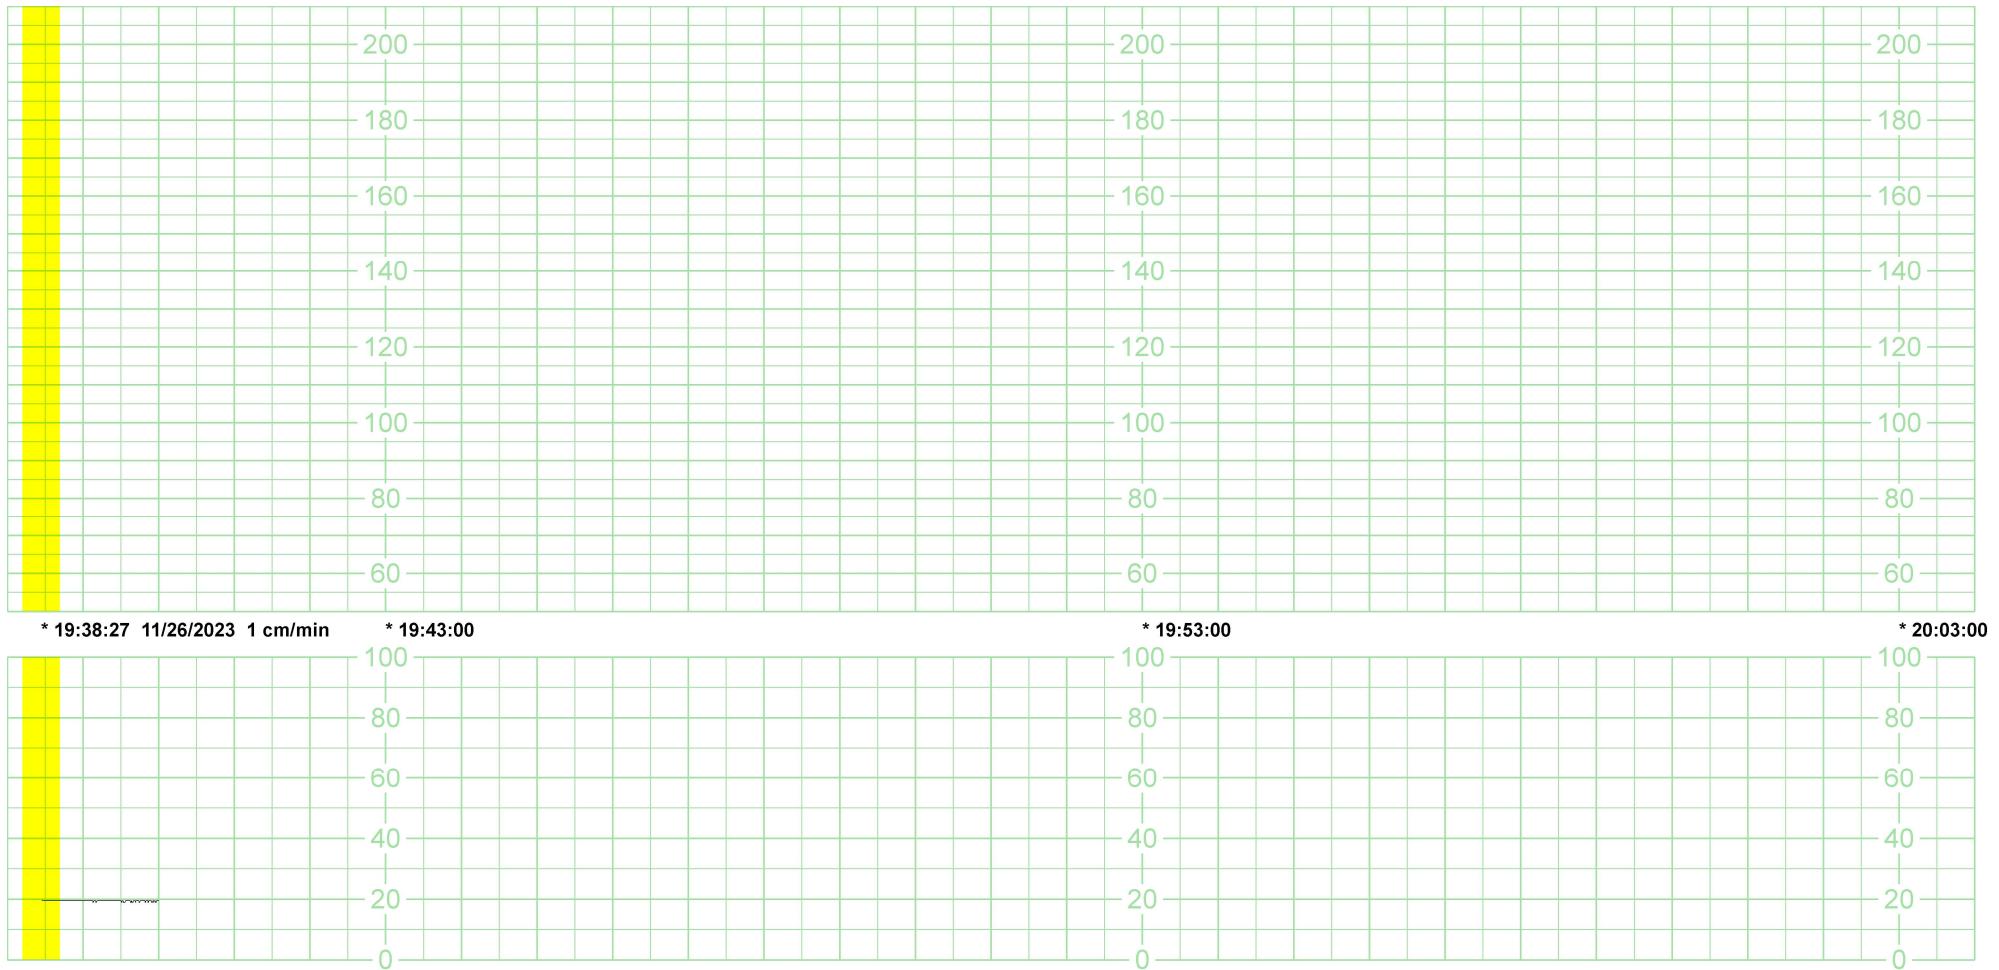


Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

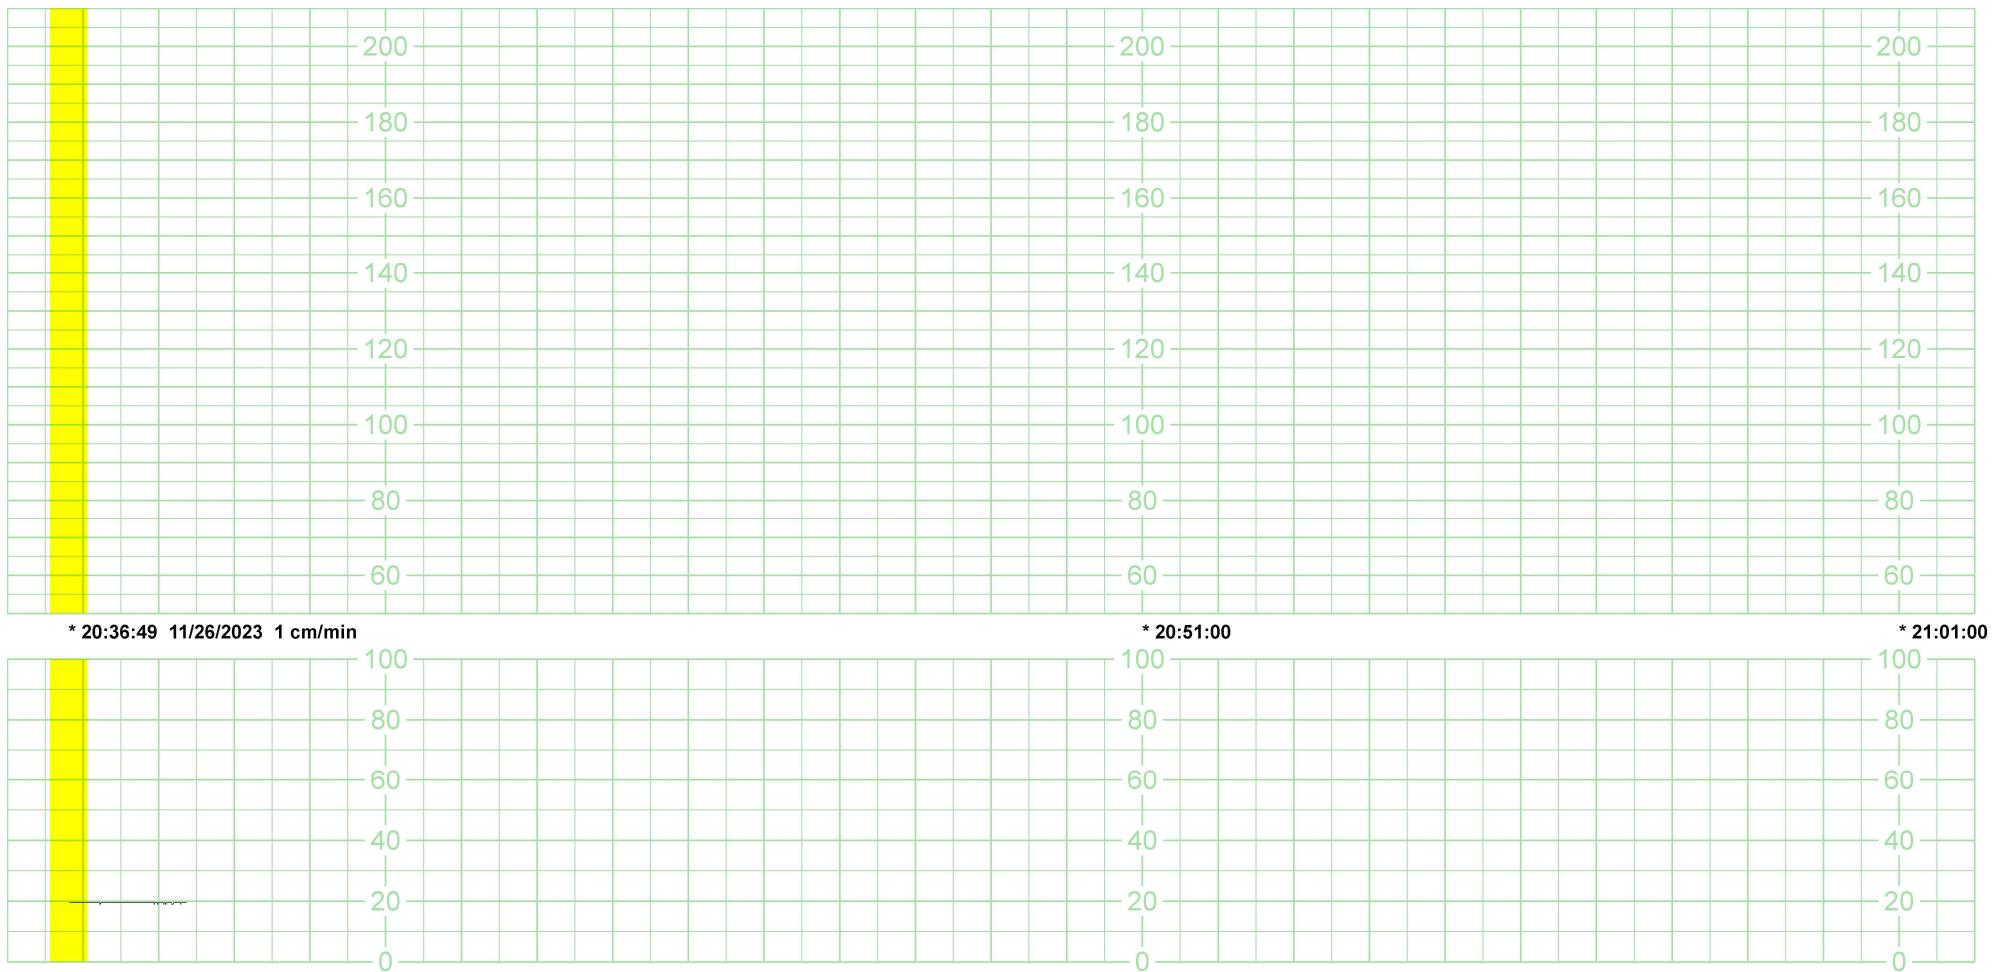

Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor

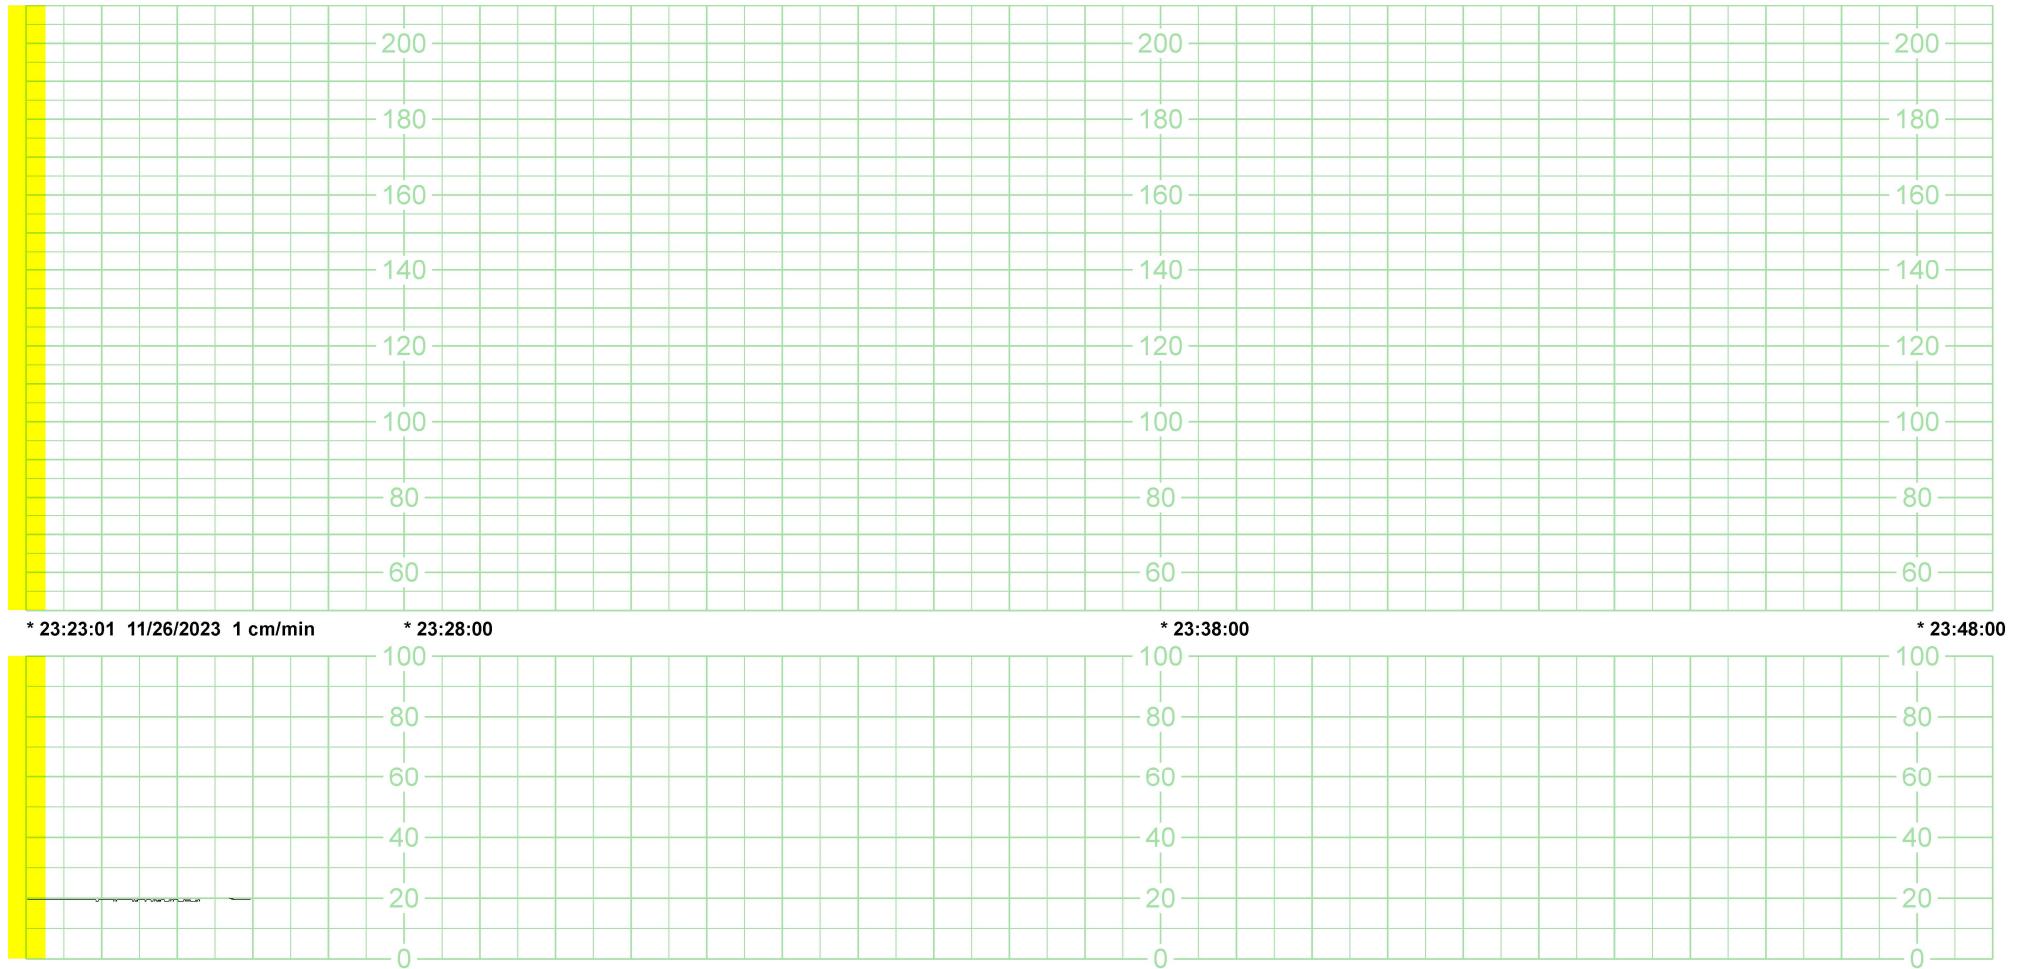


Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Modo Toco: externo
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor
Alarma con acuse de recibo

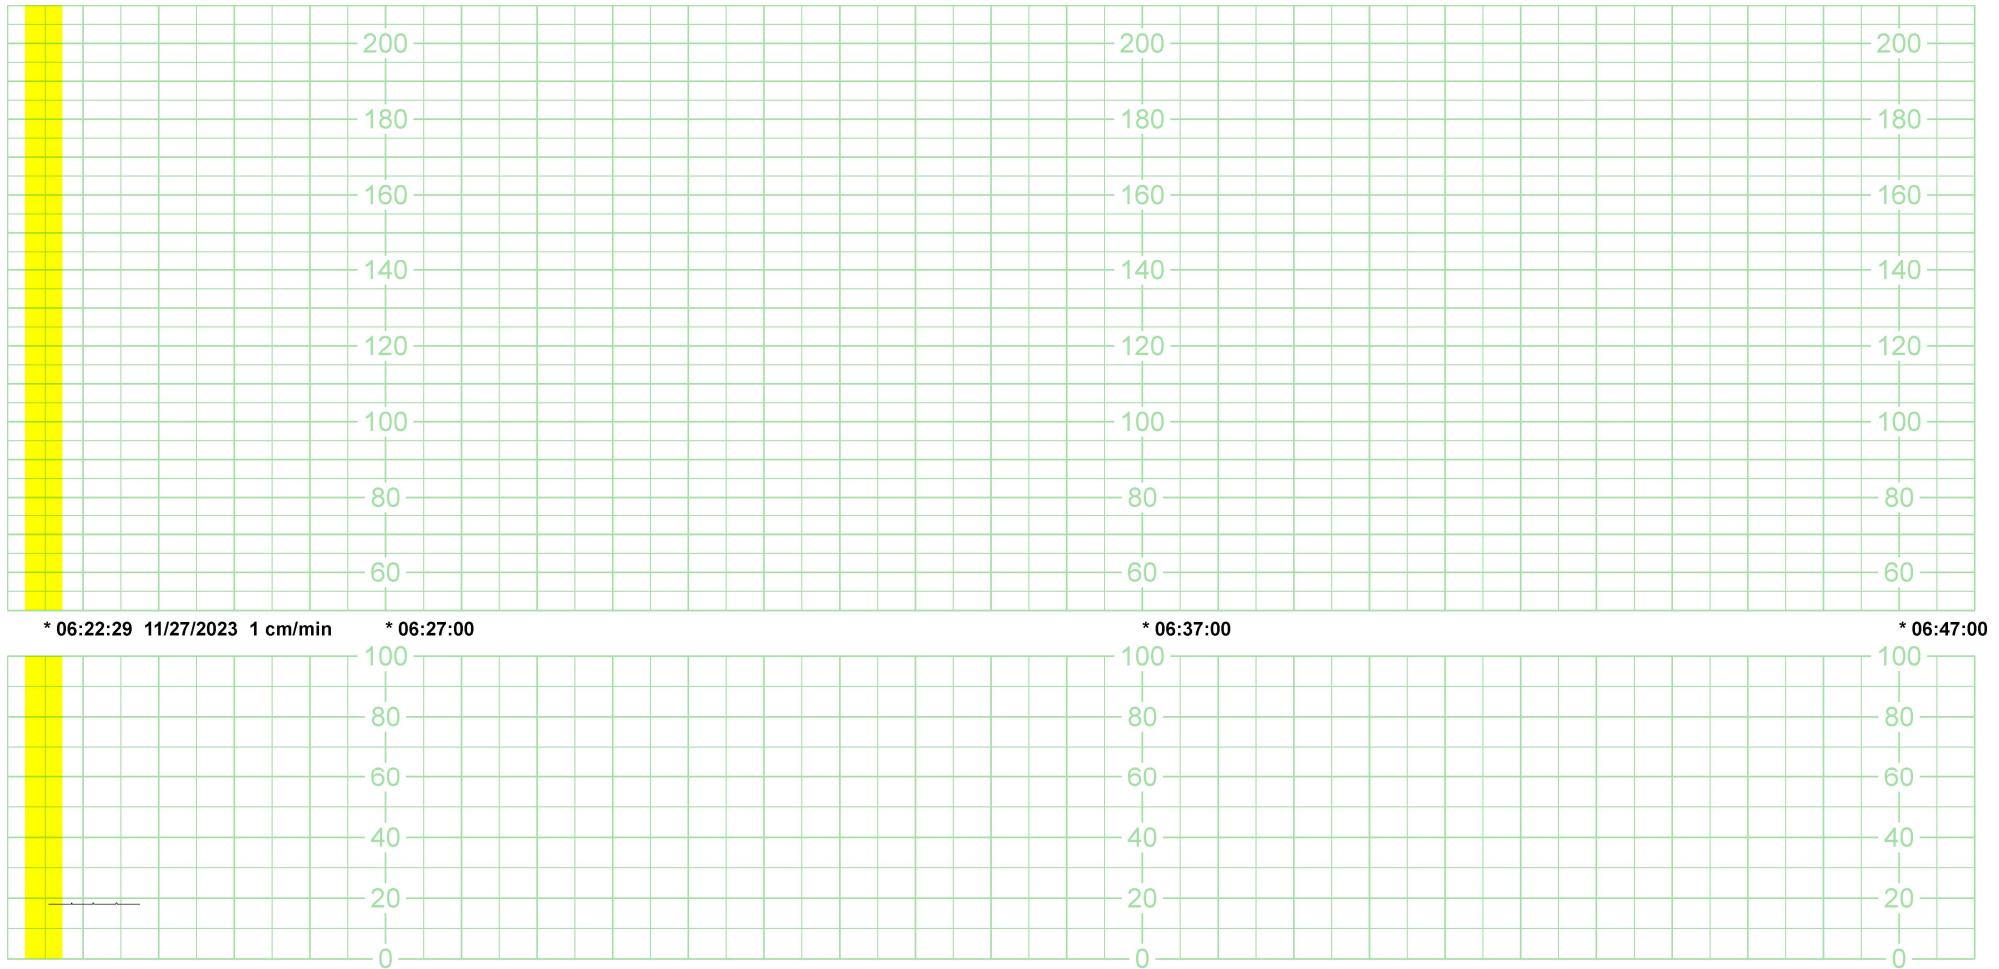



Estado del monitor: Activado
Modo FCFI: US
Modo Toco: externo
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: no transductor
Modo FCFI: no transductor
Estado del FMP: US
Modo FCFI: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado

Estado del monitor: En espera
Modo FCFI: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

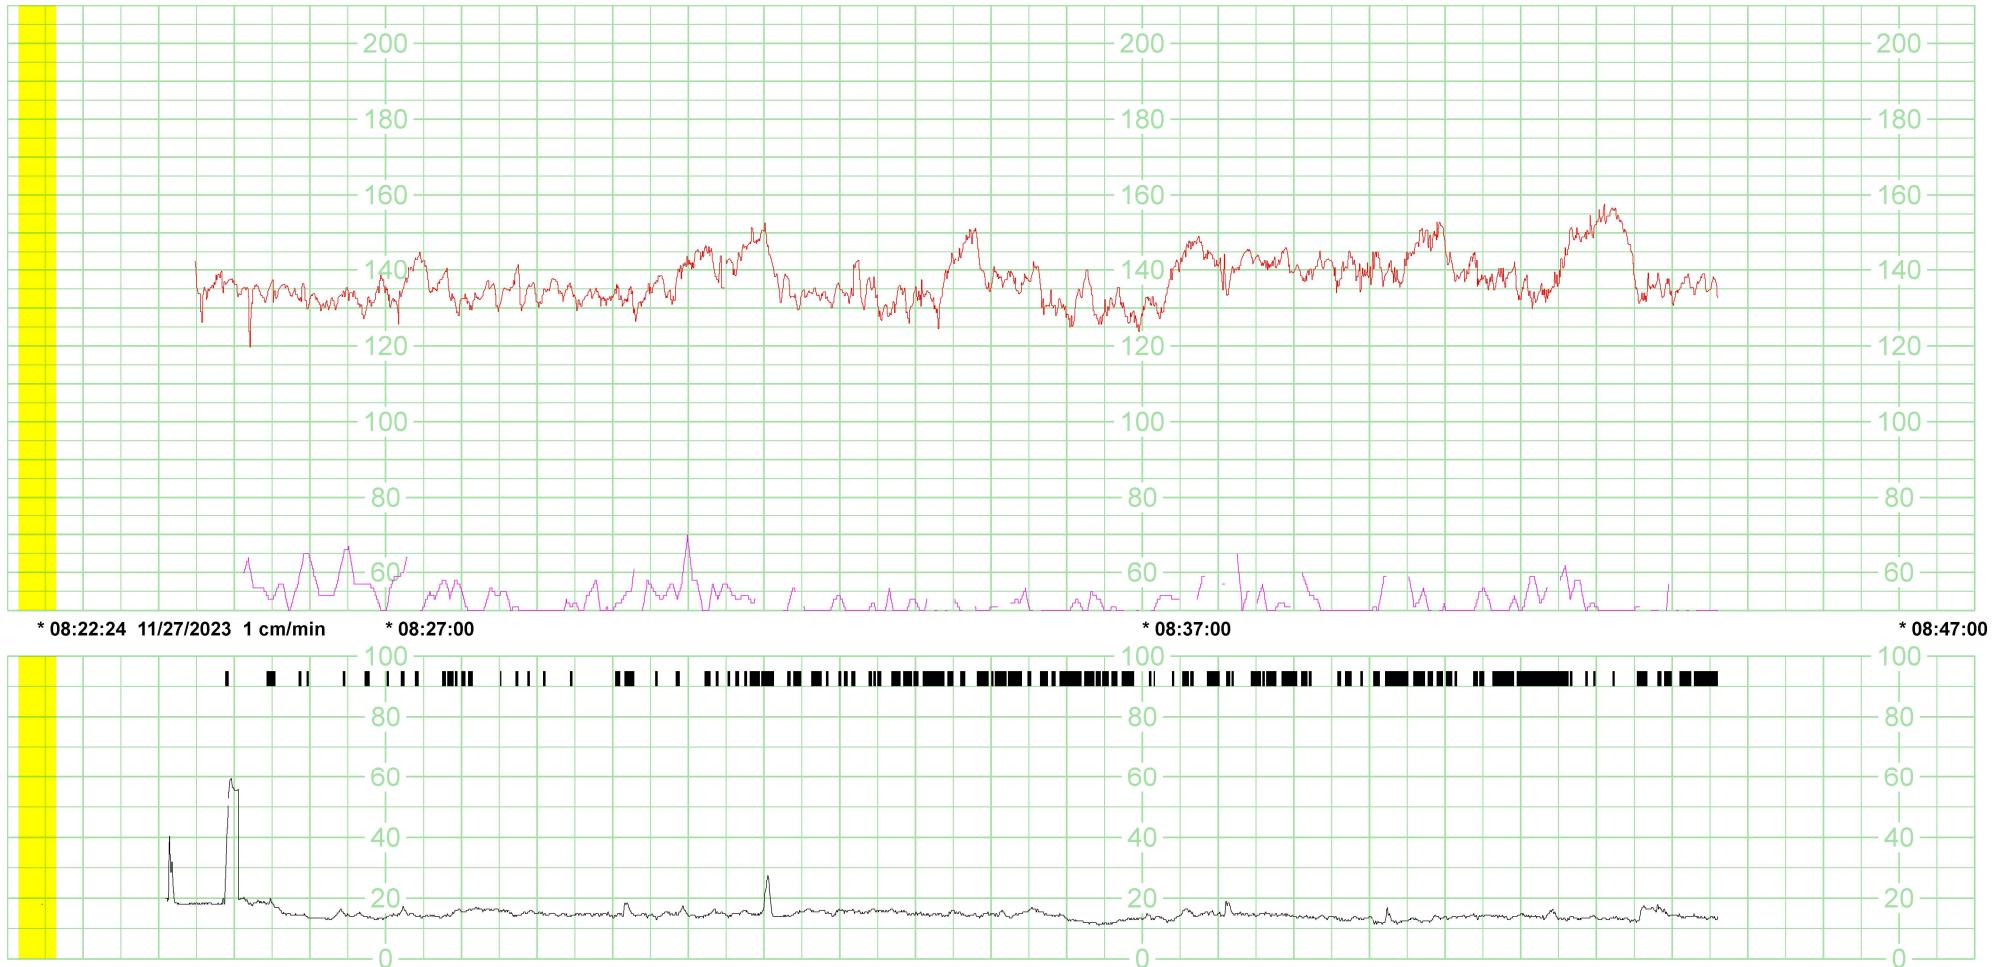

Estado del monitor: Activado
Modo FCFI: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado

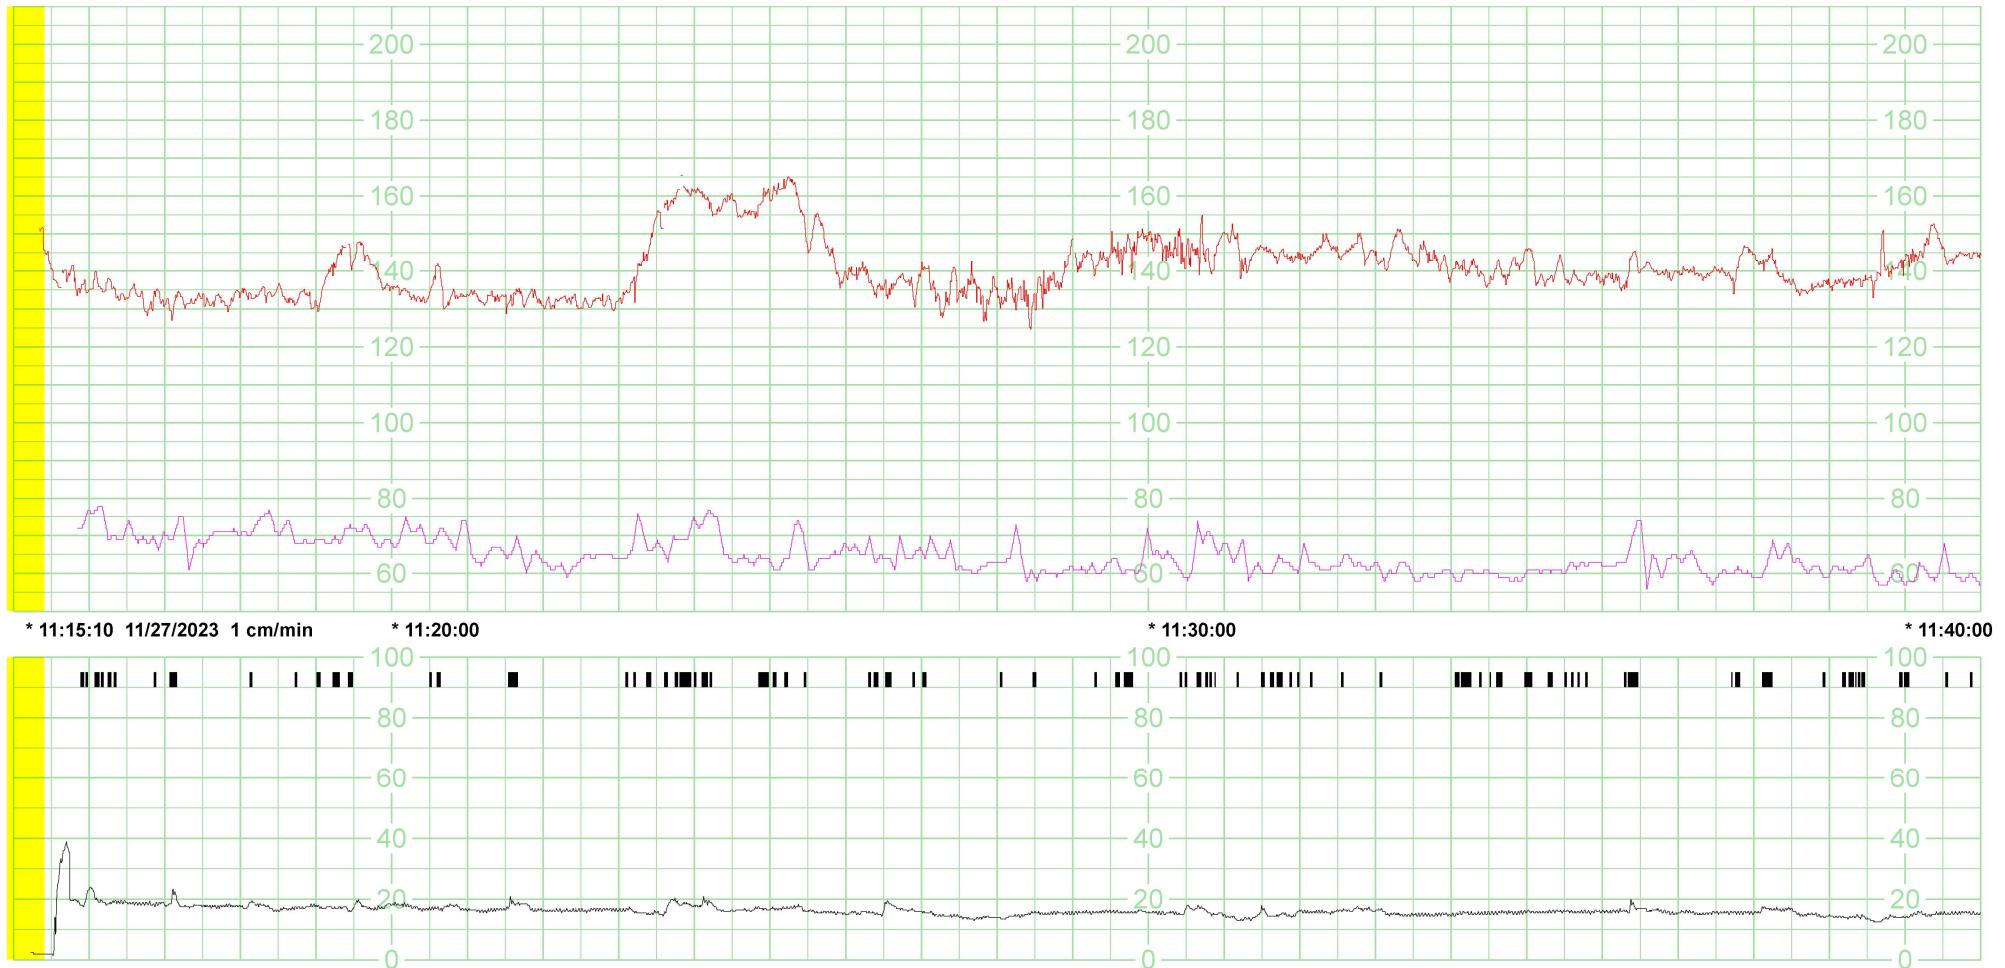


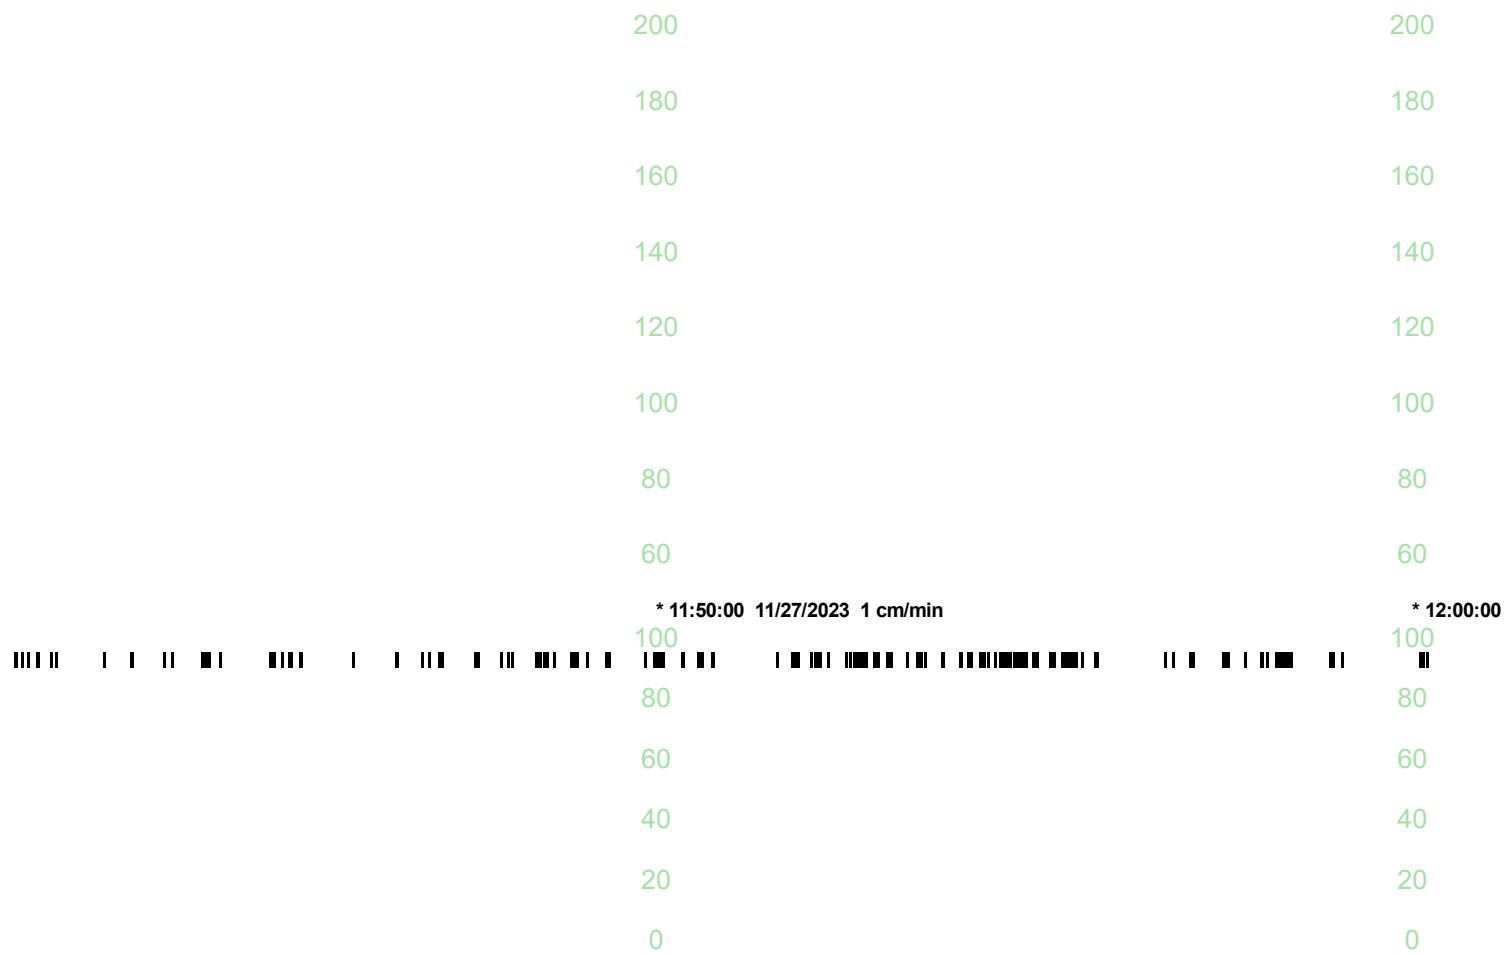


Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco : no transductor
Estado del registrador: Desactivado




Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

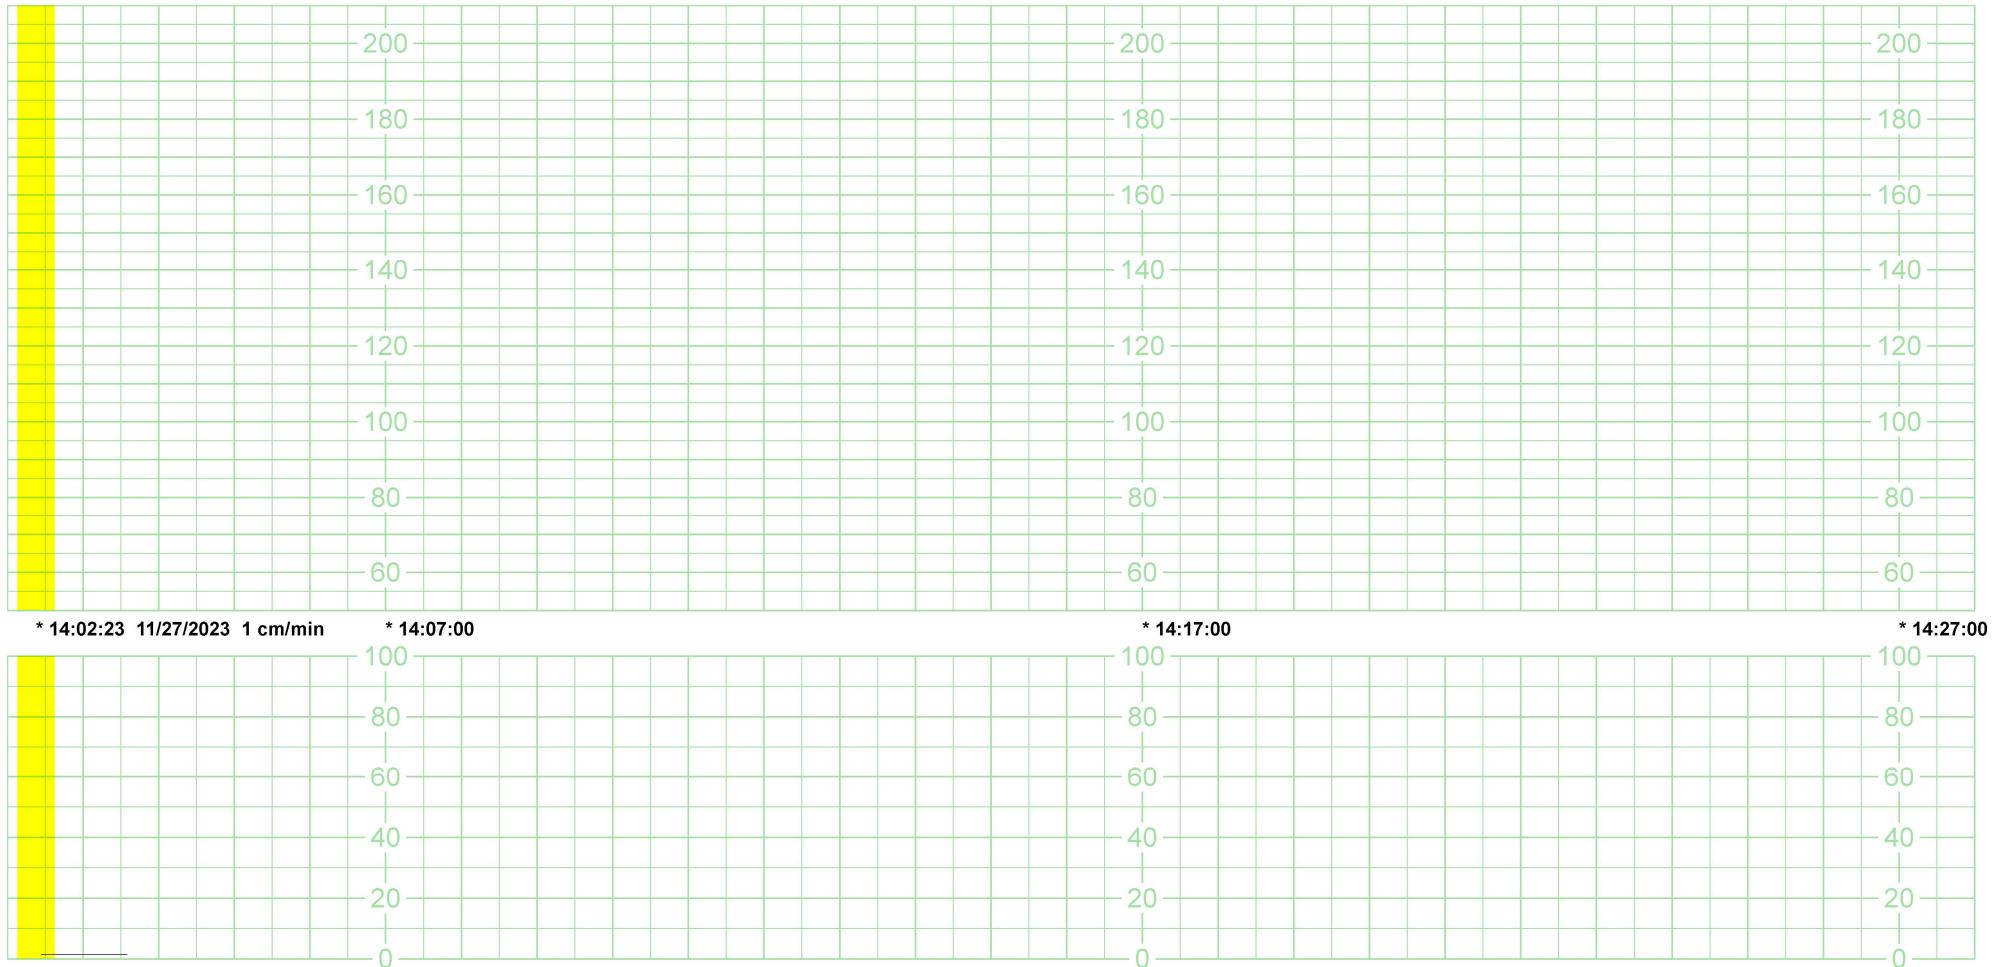


Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco : externo
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco : no transductor
Estado del registrador: Desactivado

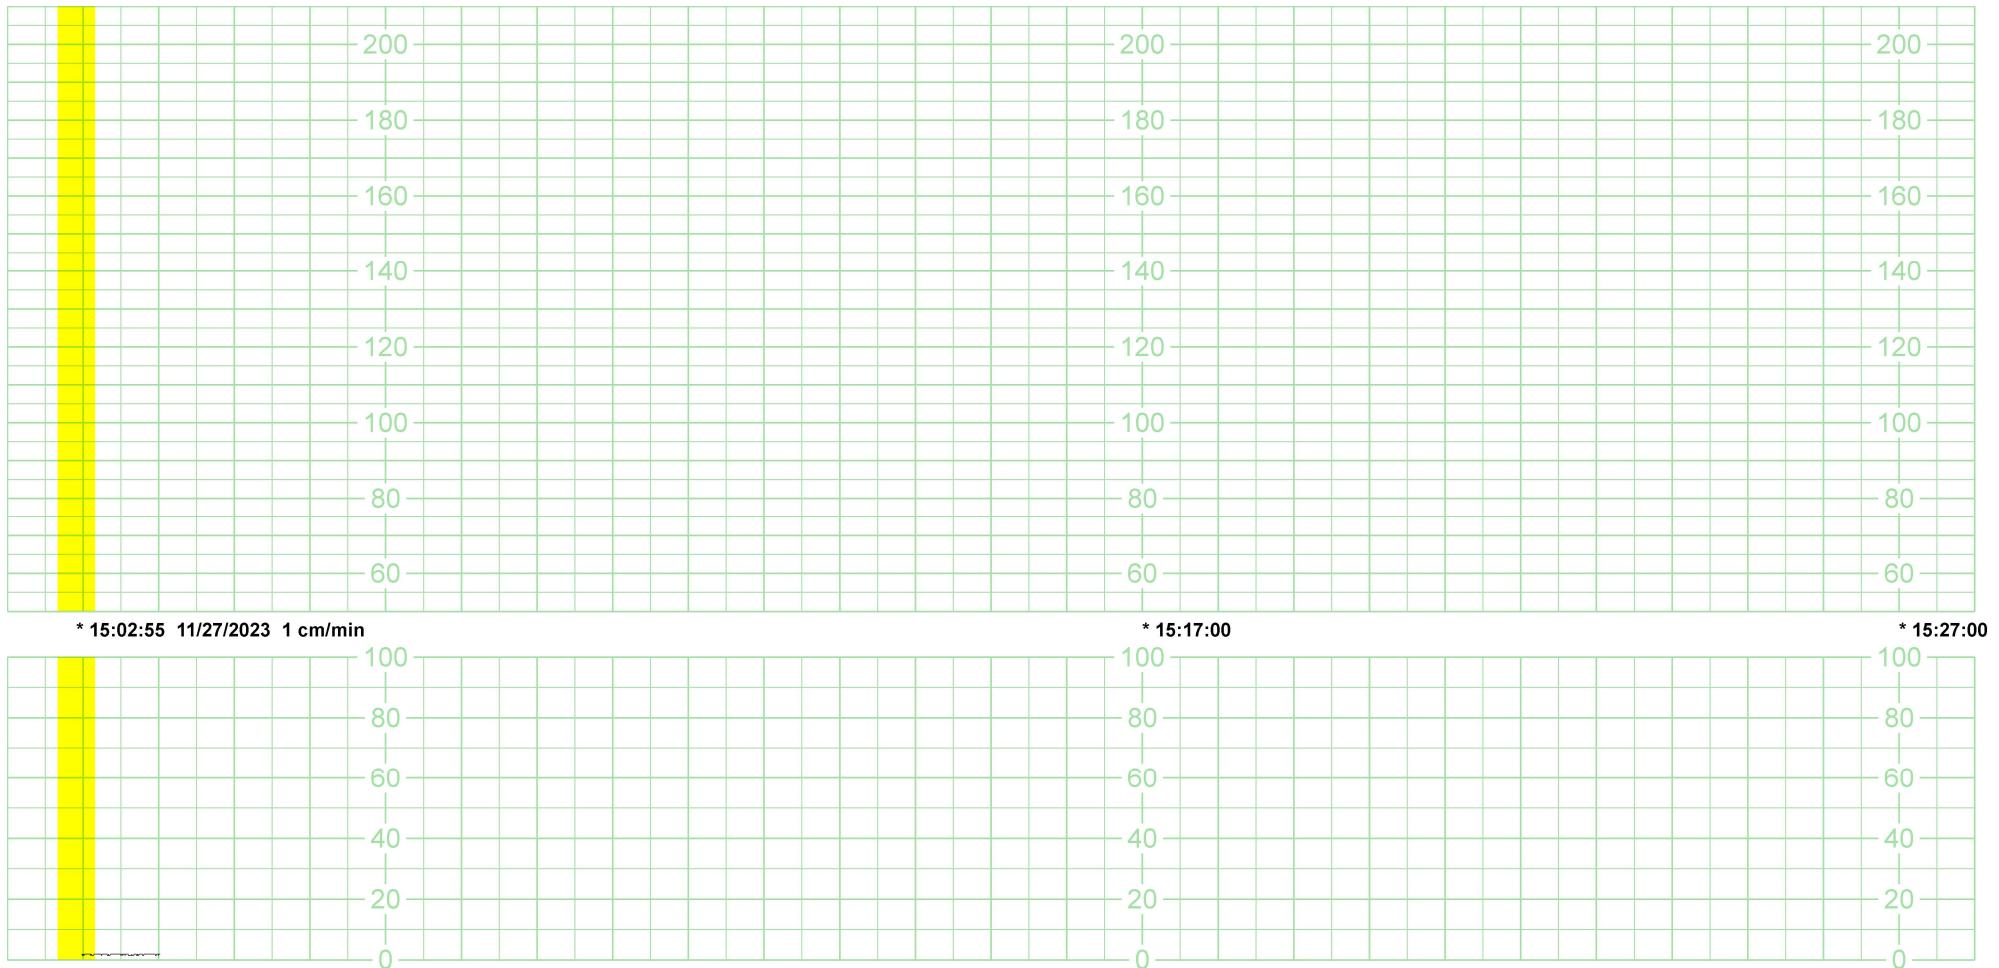


Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

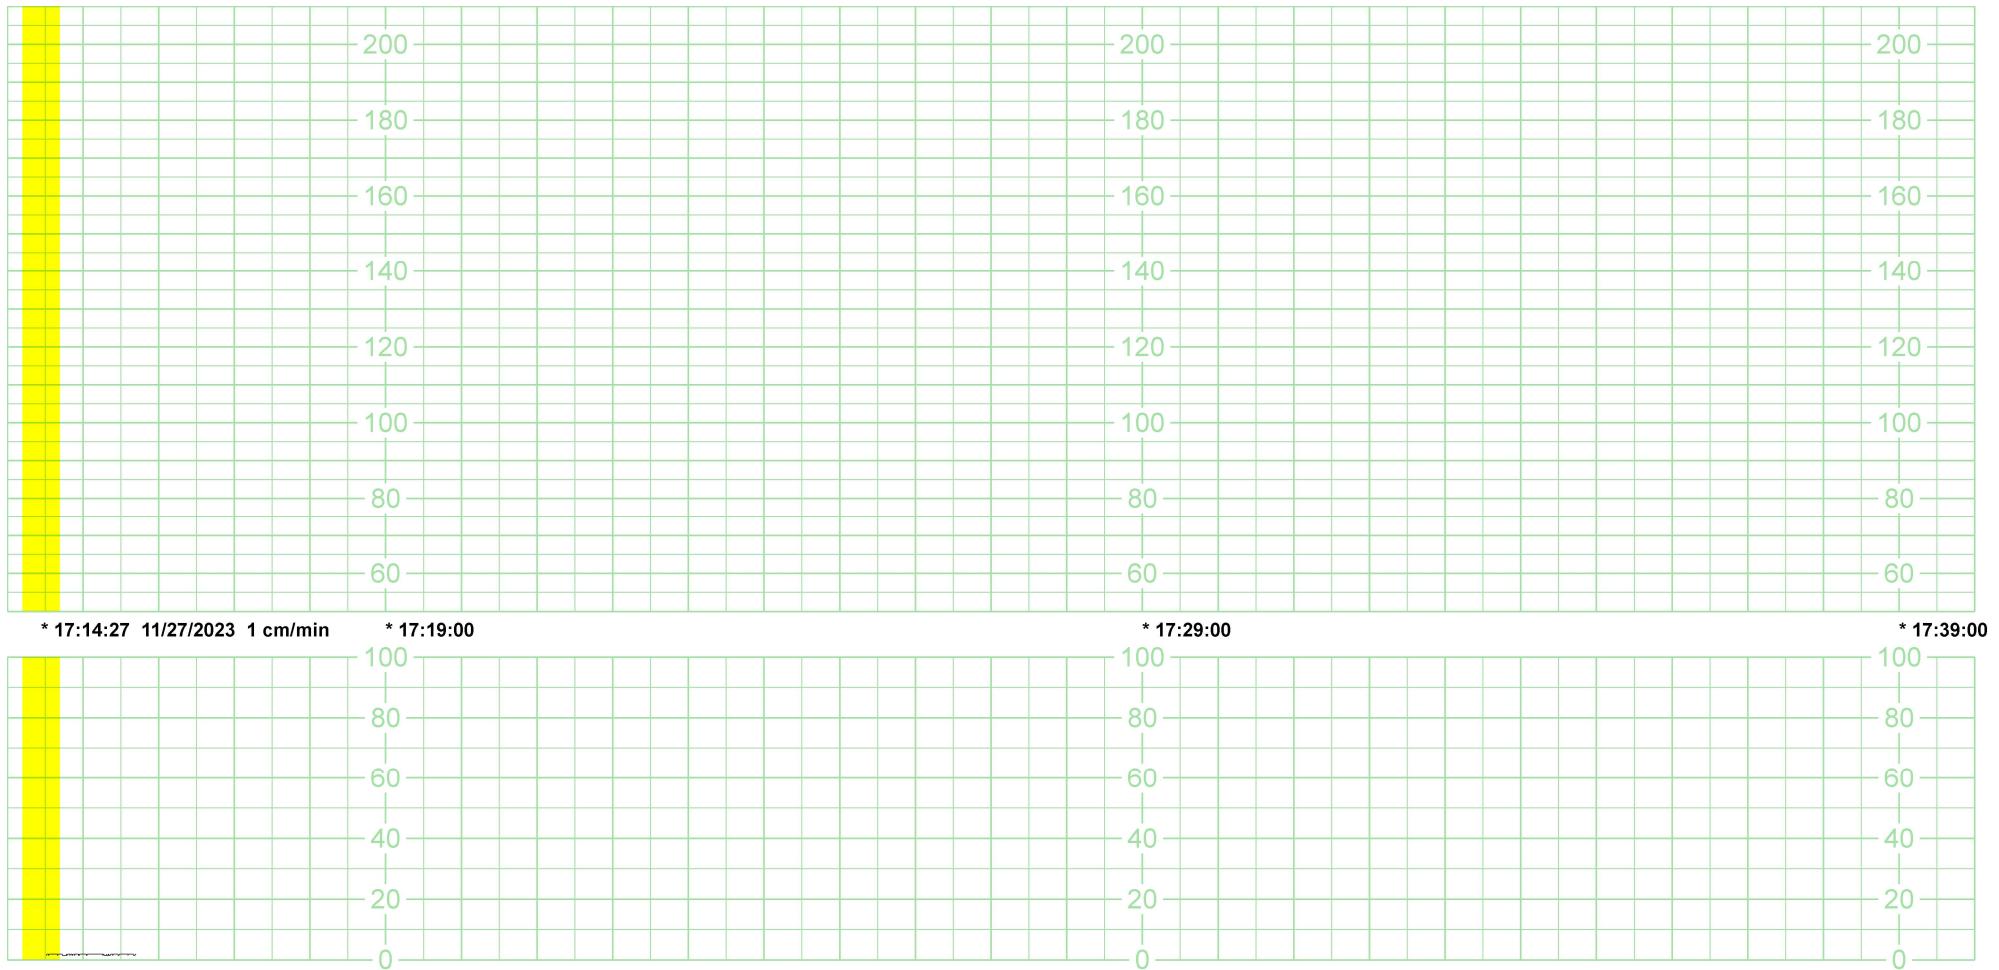


Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Modo Toco : externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco : no transductor
Estado del registrador: Desactivado

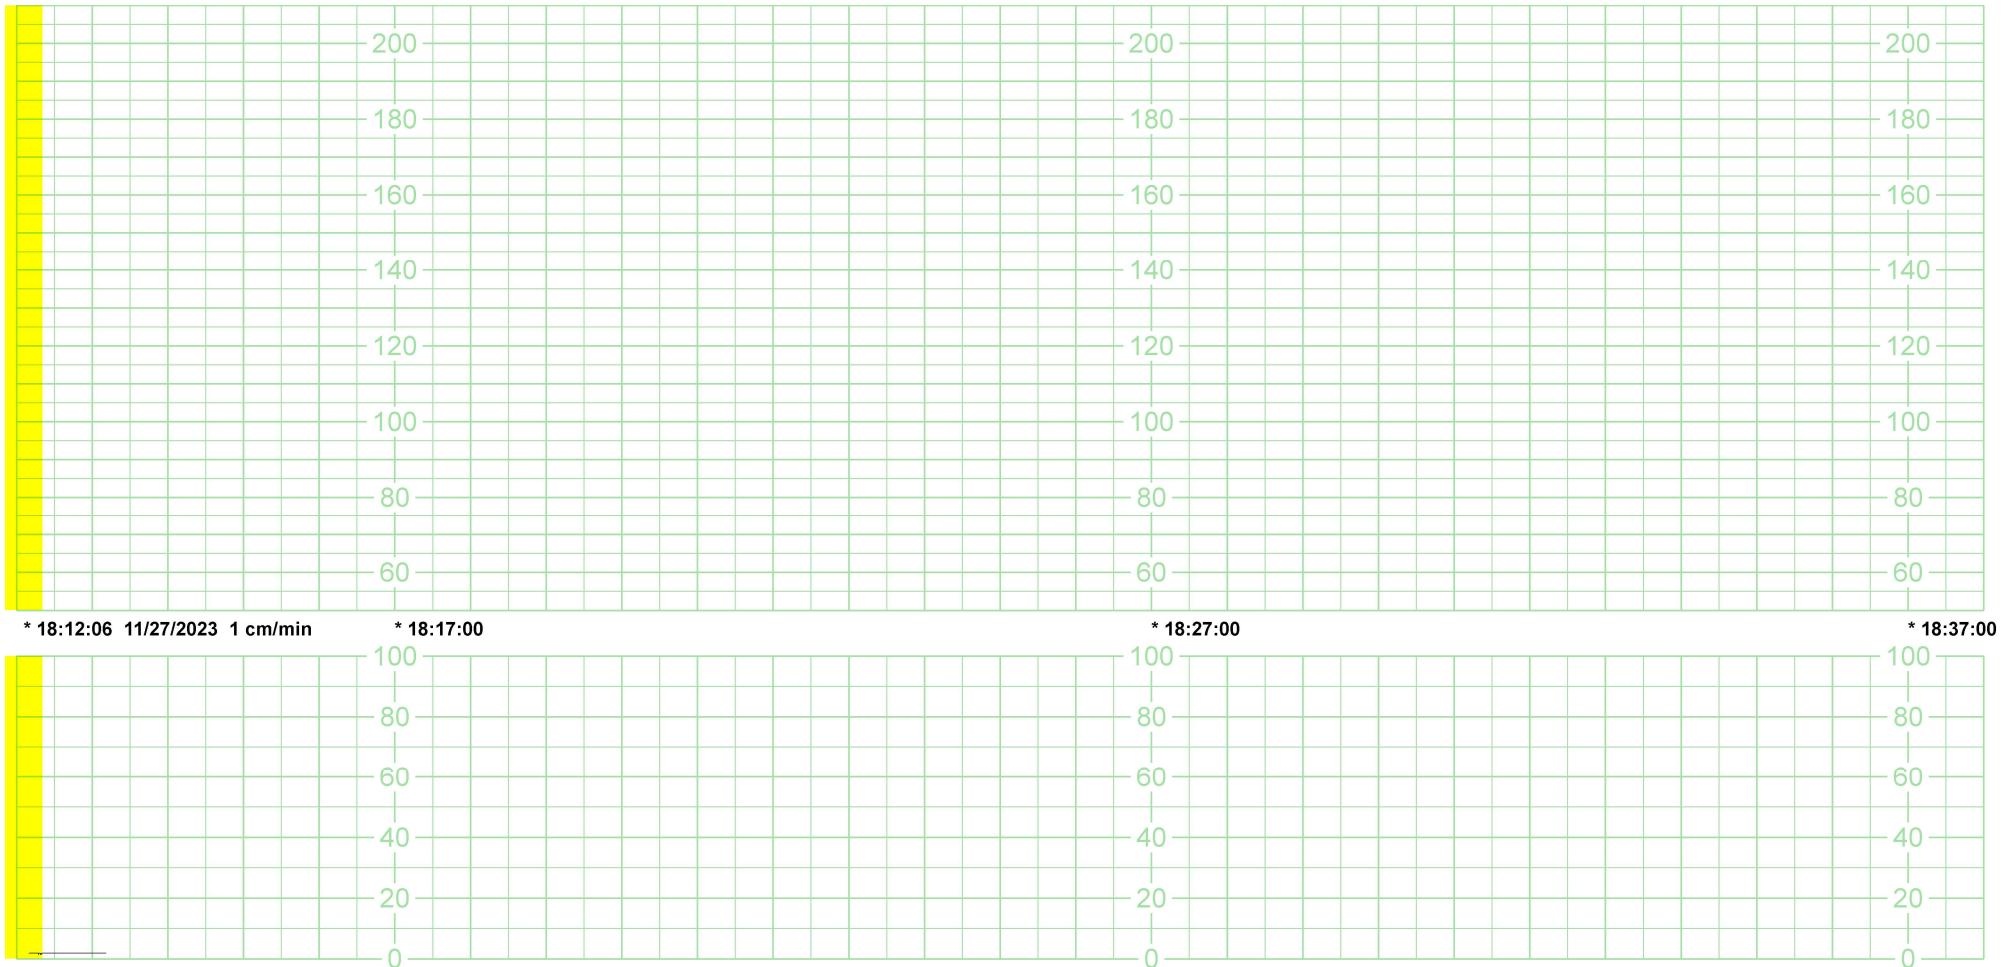

Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCF1: externo
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado

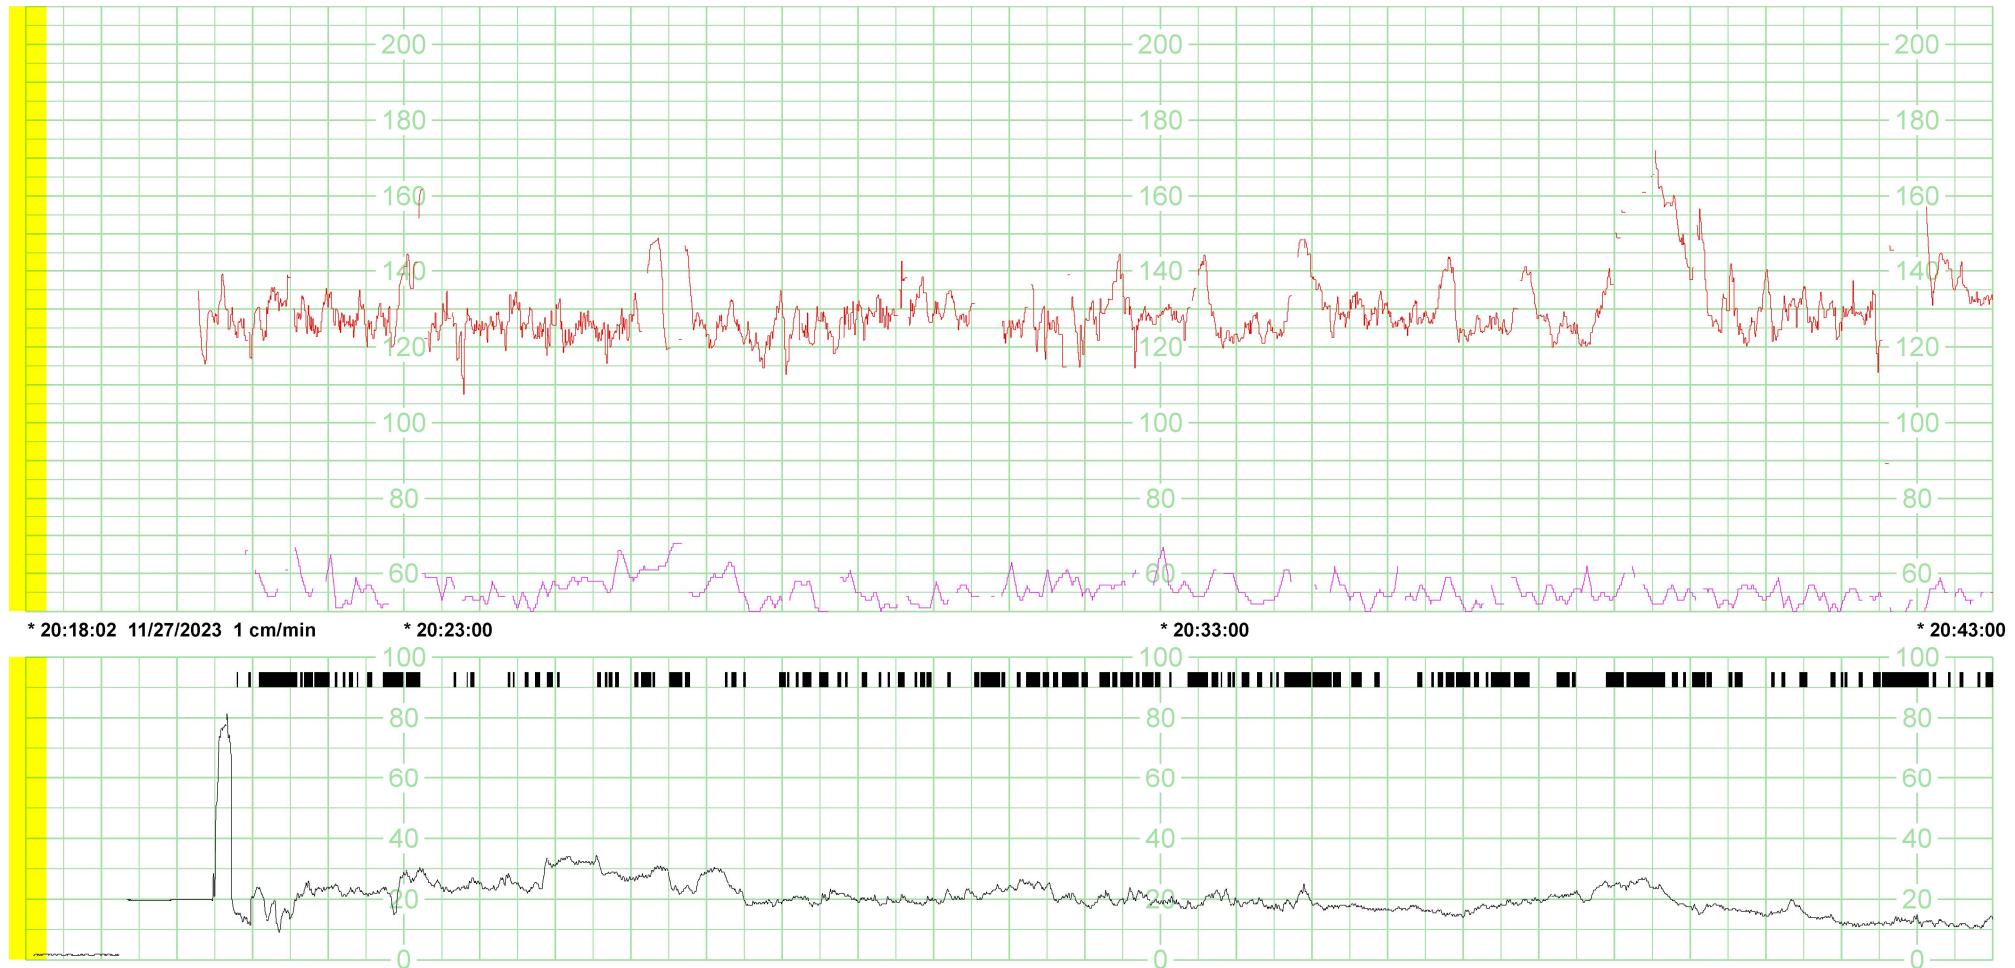


* FCF1: PERDIDA SEÑAL.
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

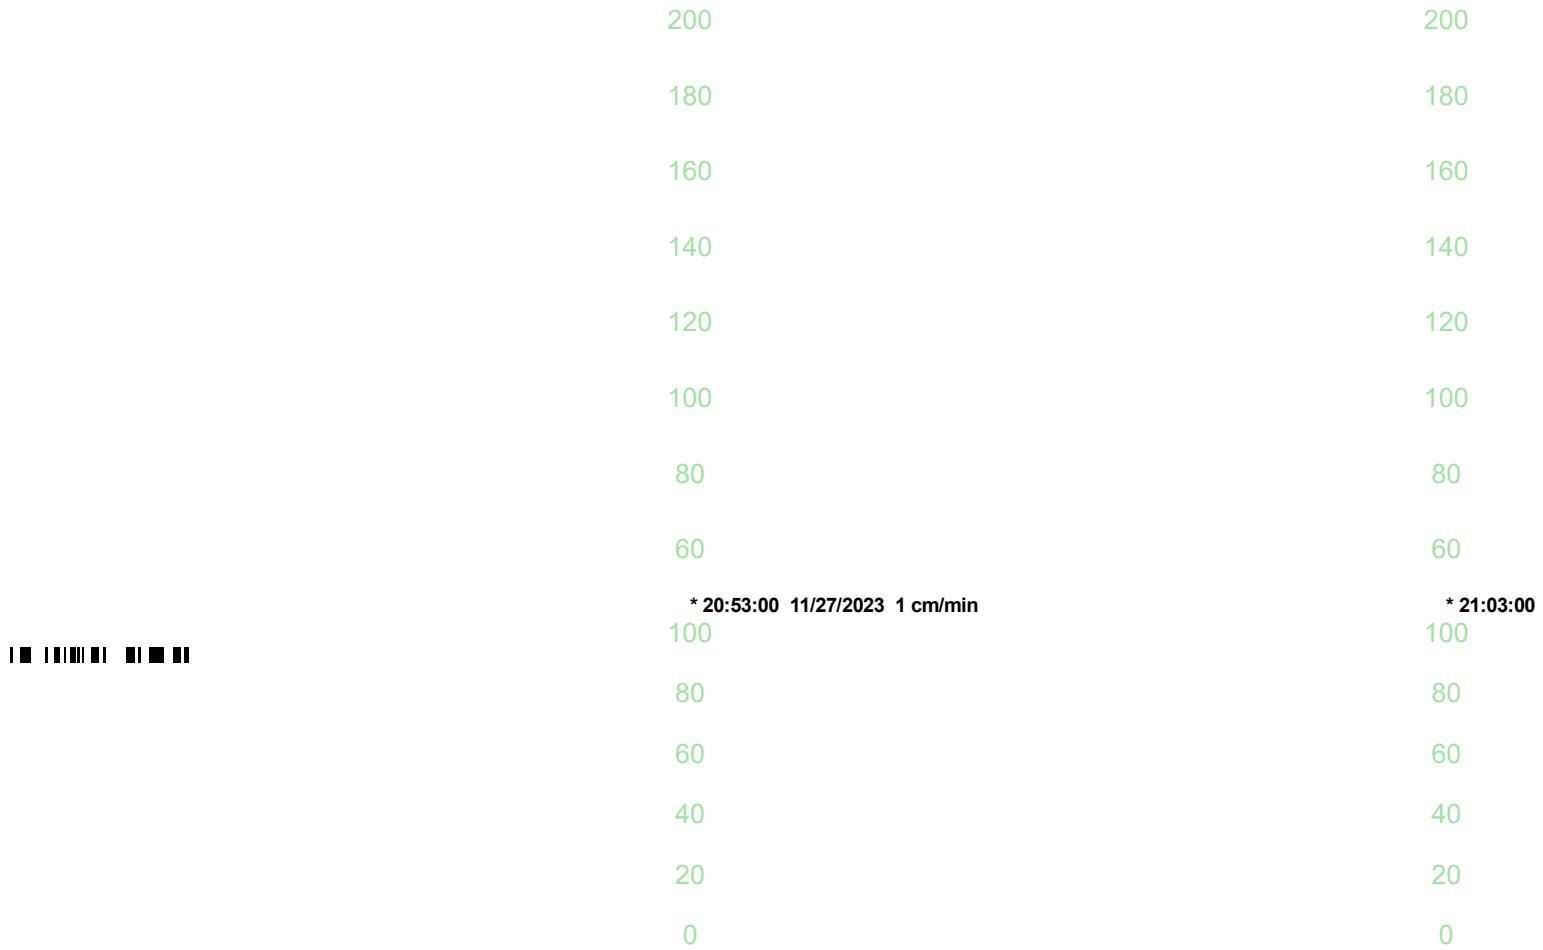


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL

Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Estado del monitor: Desactivado
Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del monitor: Desactivado
Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Alarma con acuse de recibo

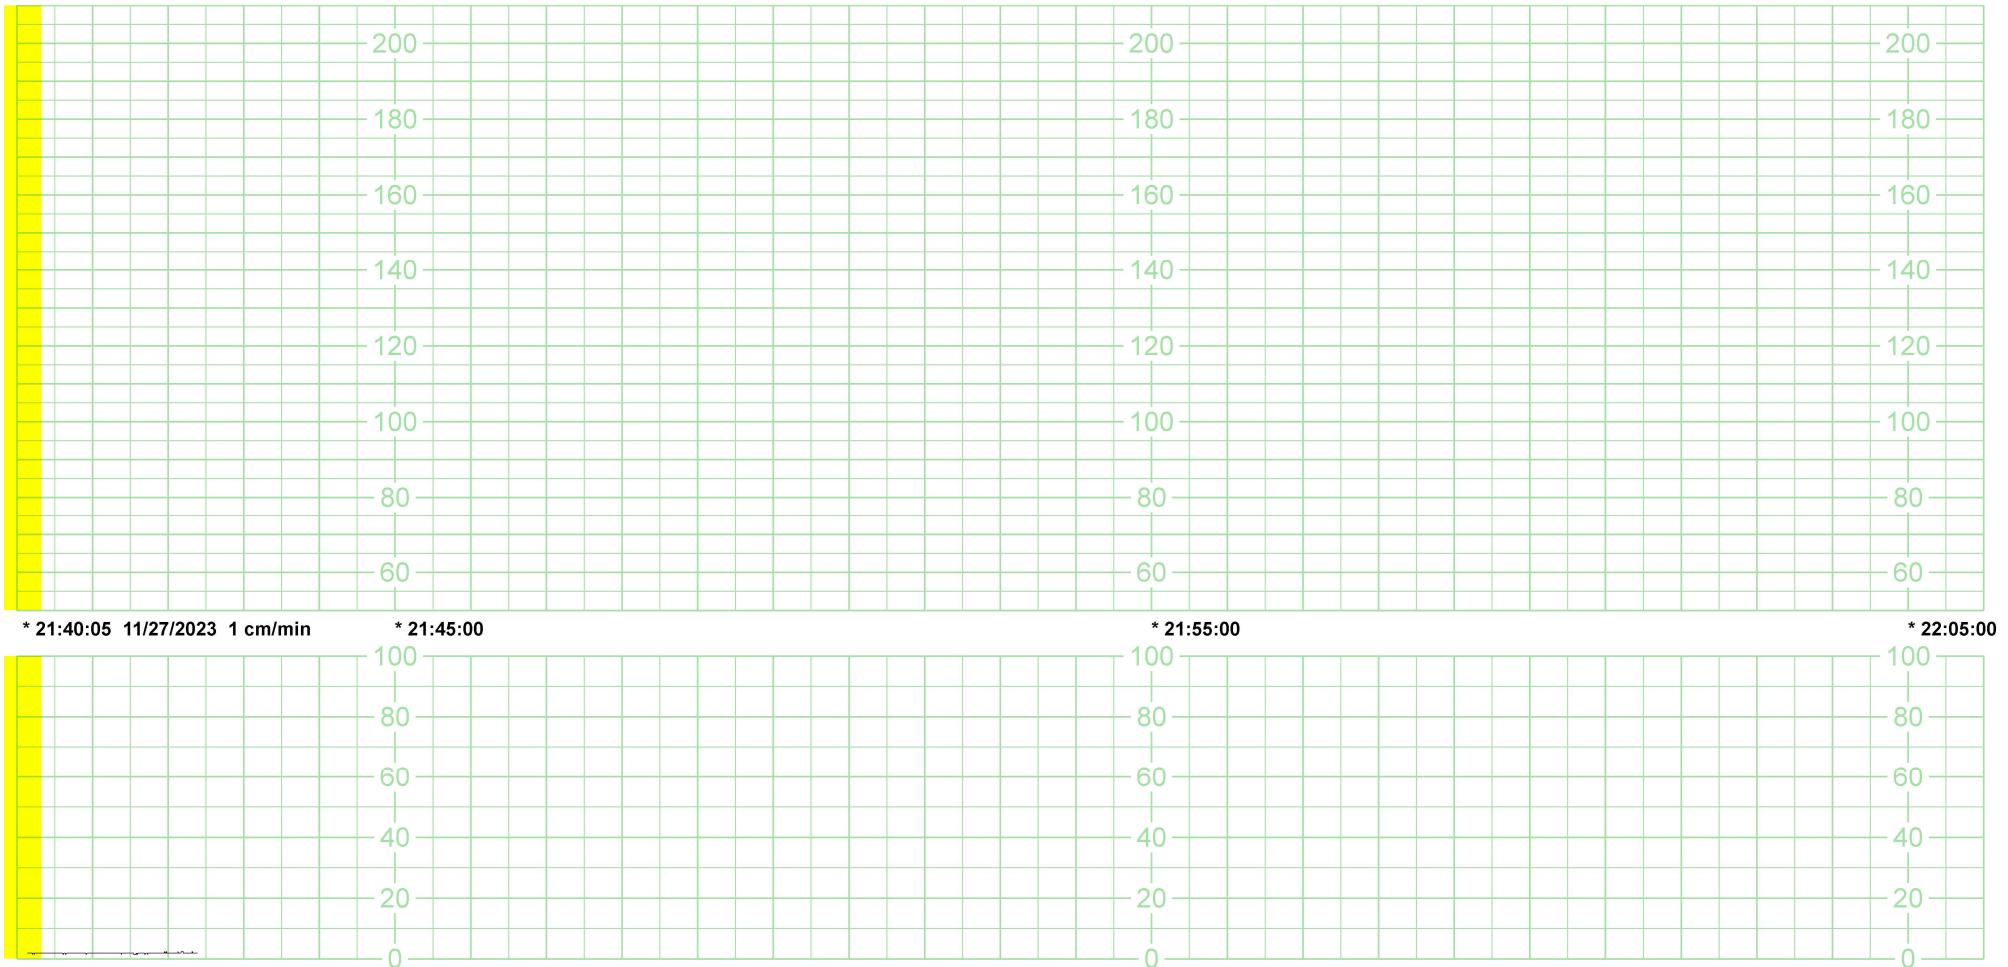


Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: exterior
* FCF1: PERDIDA SEÑAL

Alarma con acuse de recibo

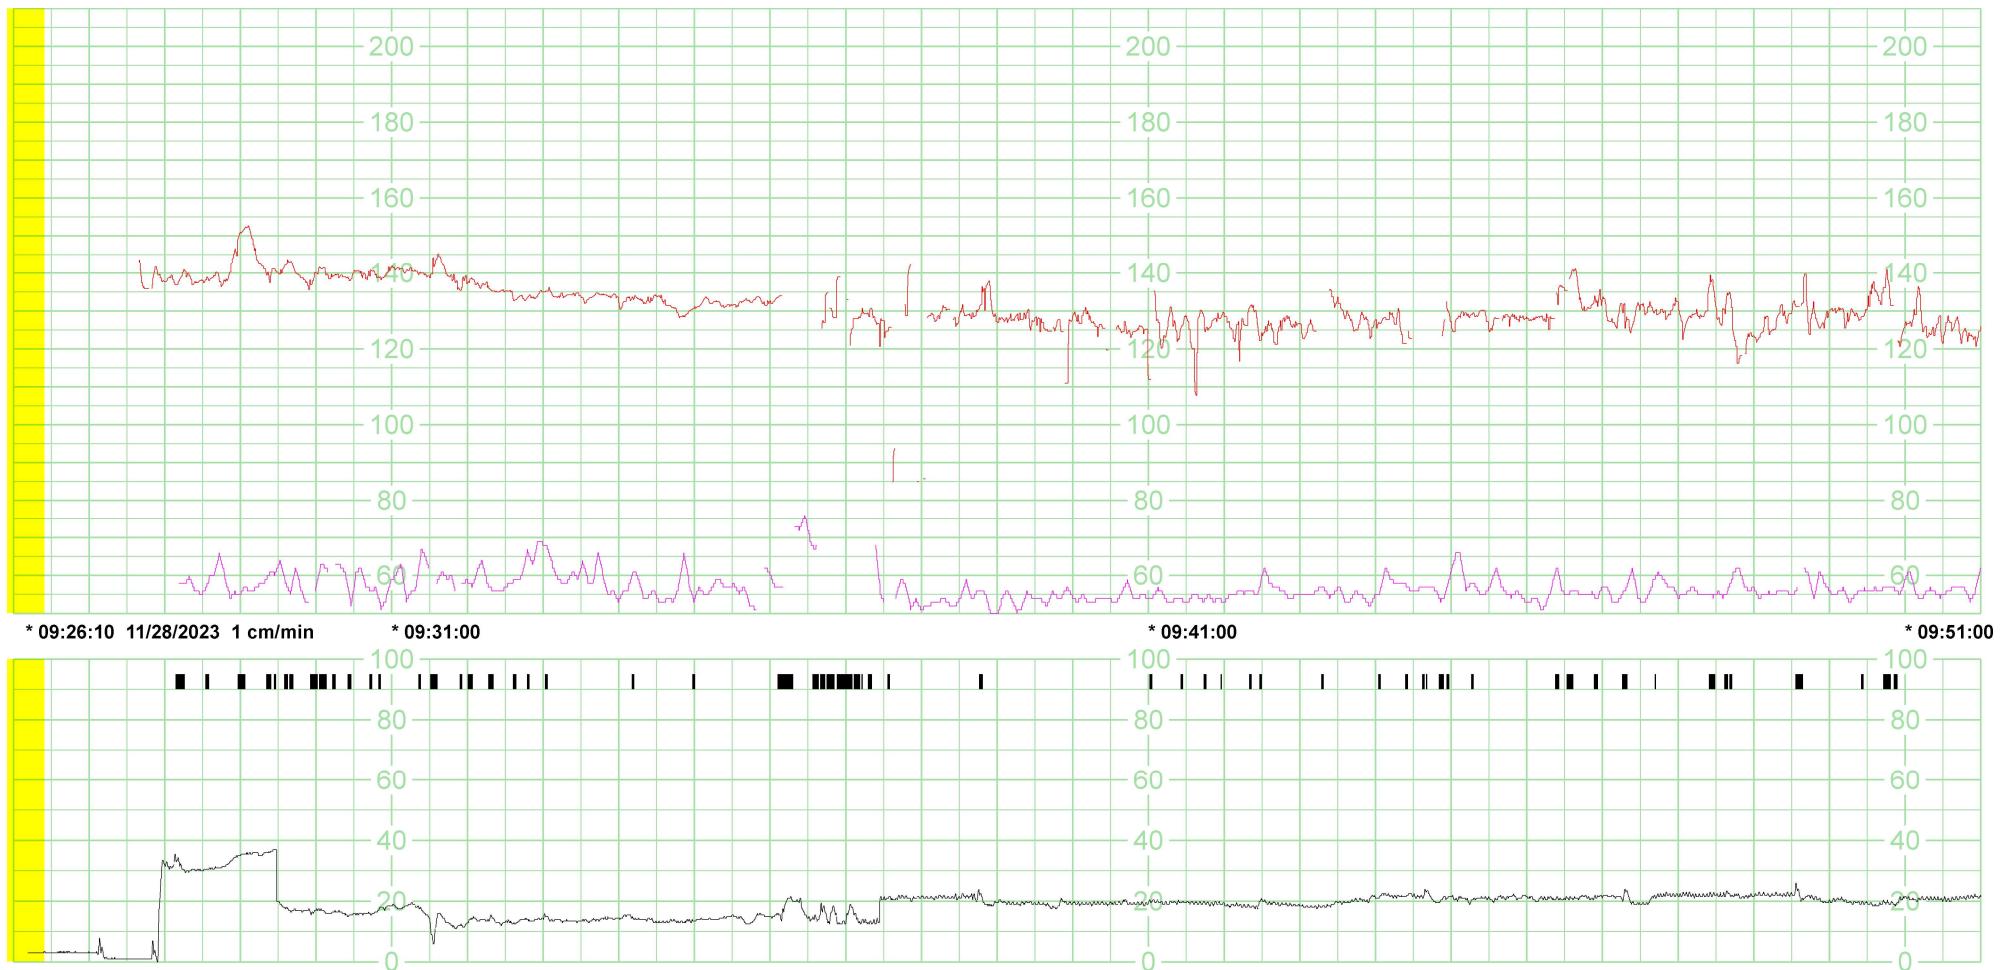


I II III IV V VI VII VIII

Estado del monitor: Desactivado

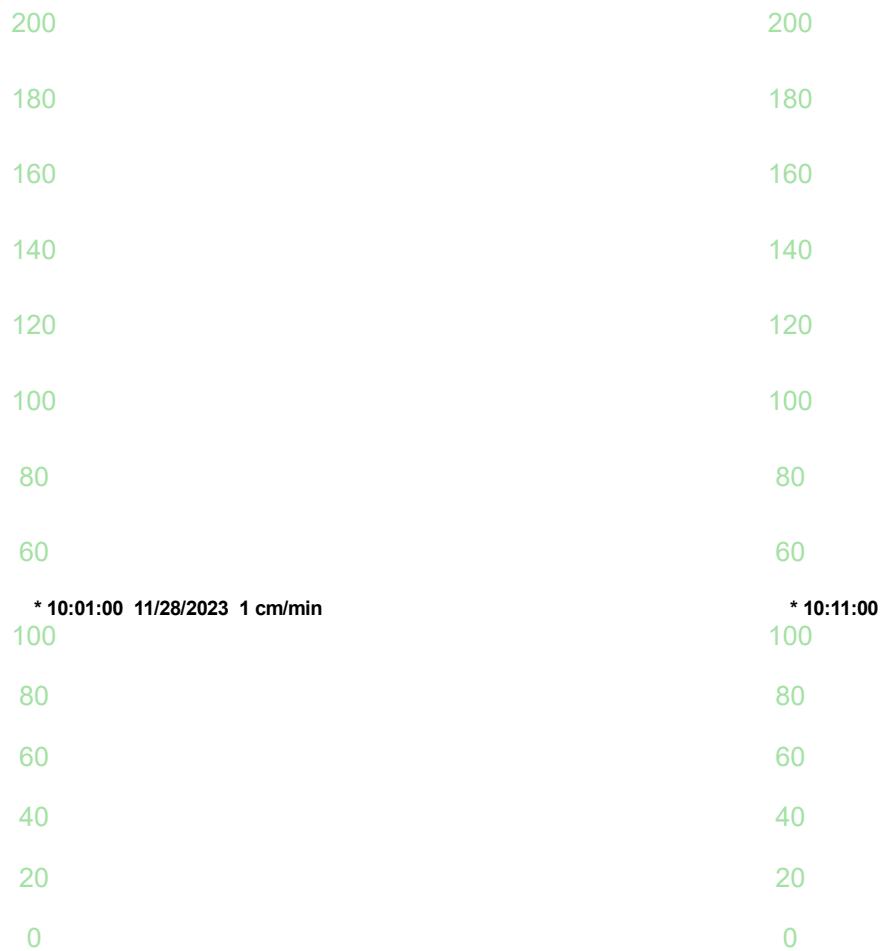


Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del monitor: Desactivado
Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: US
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor

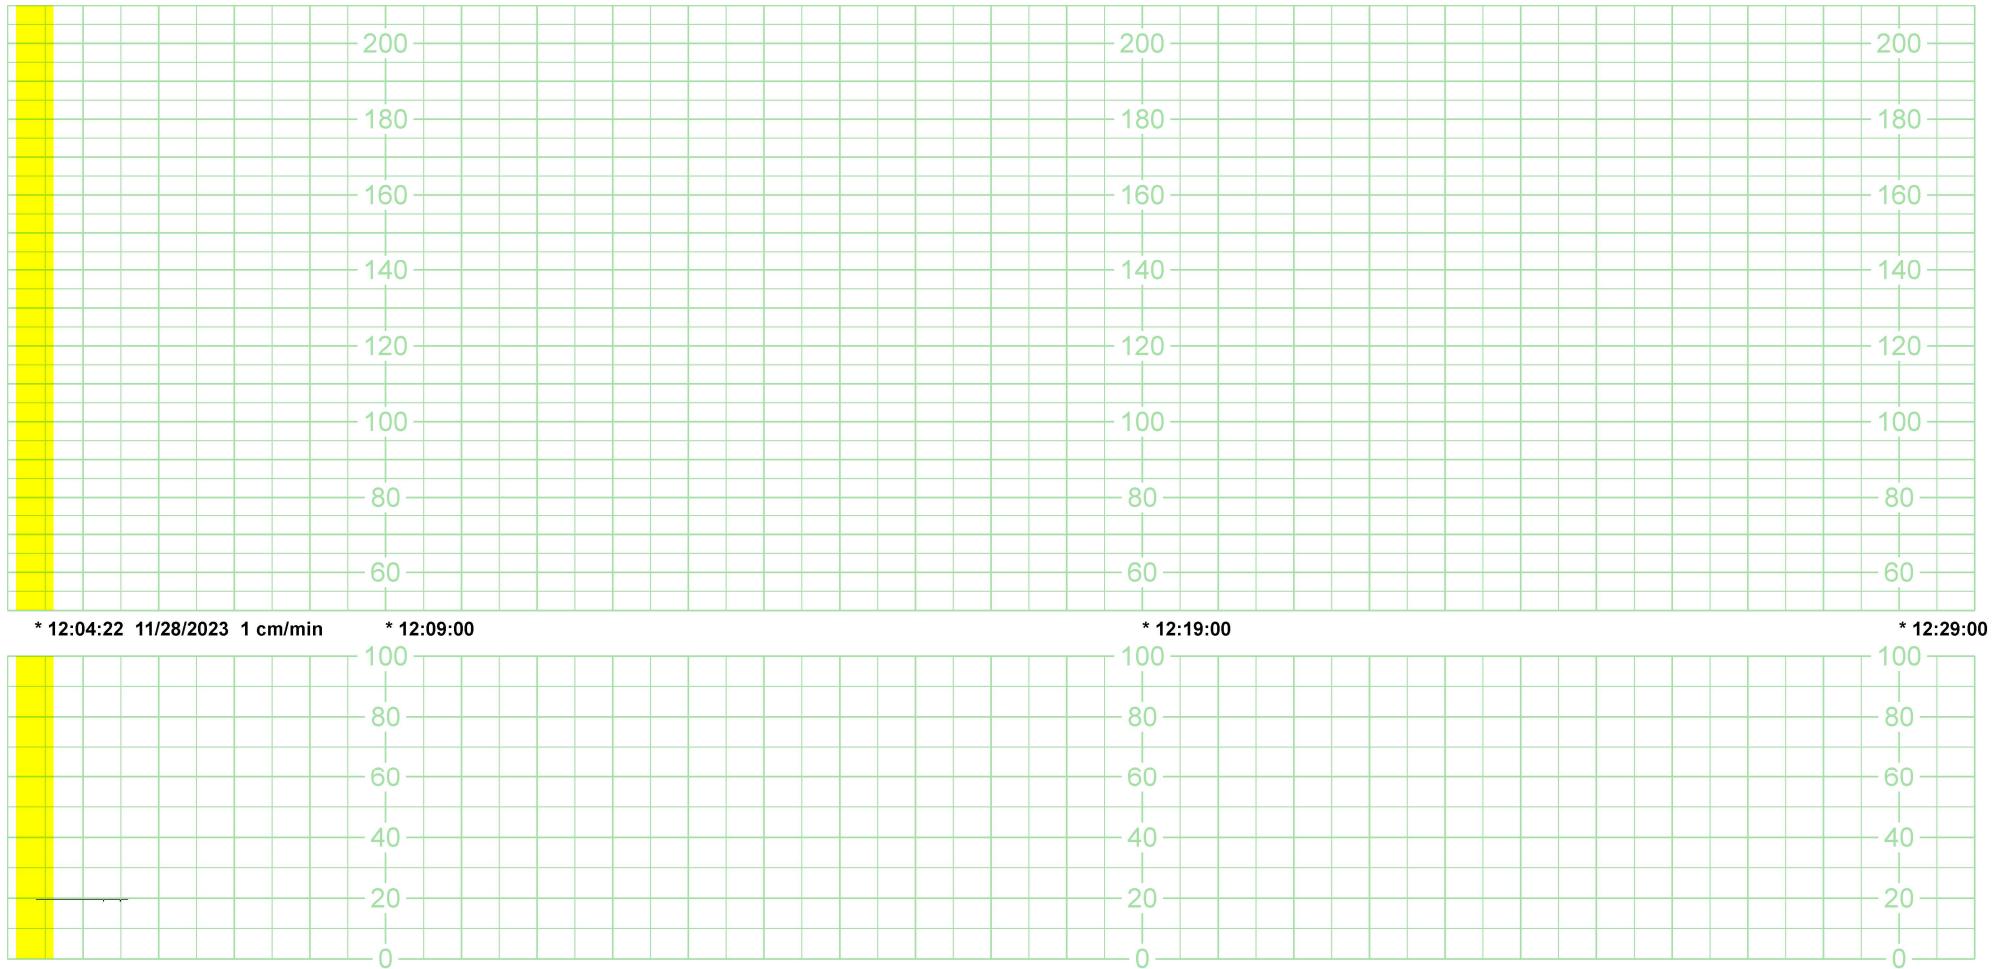


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco : externo
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: Desactivado

Alarma con acuse de recibo

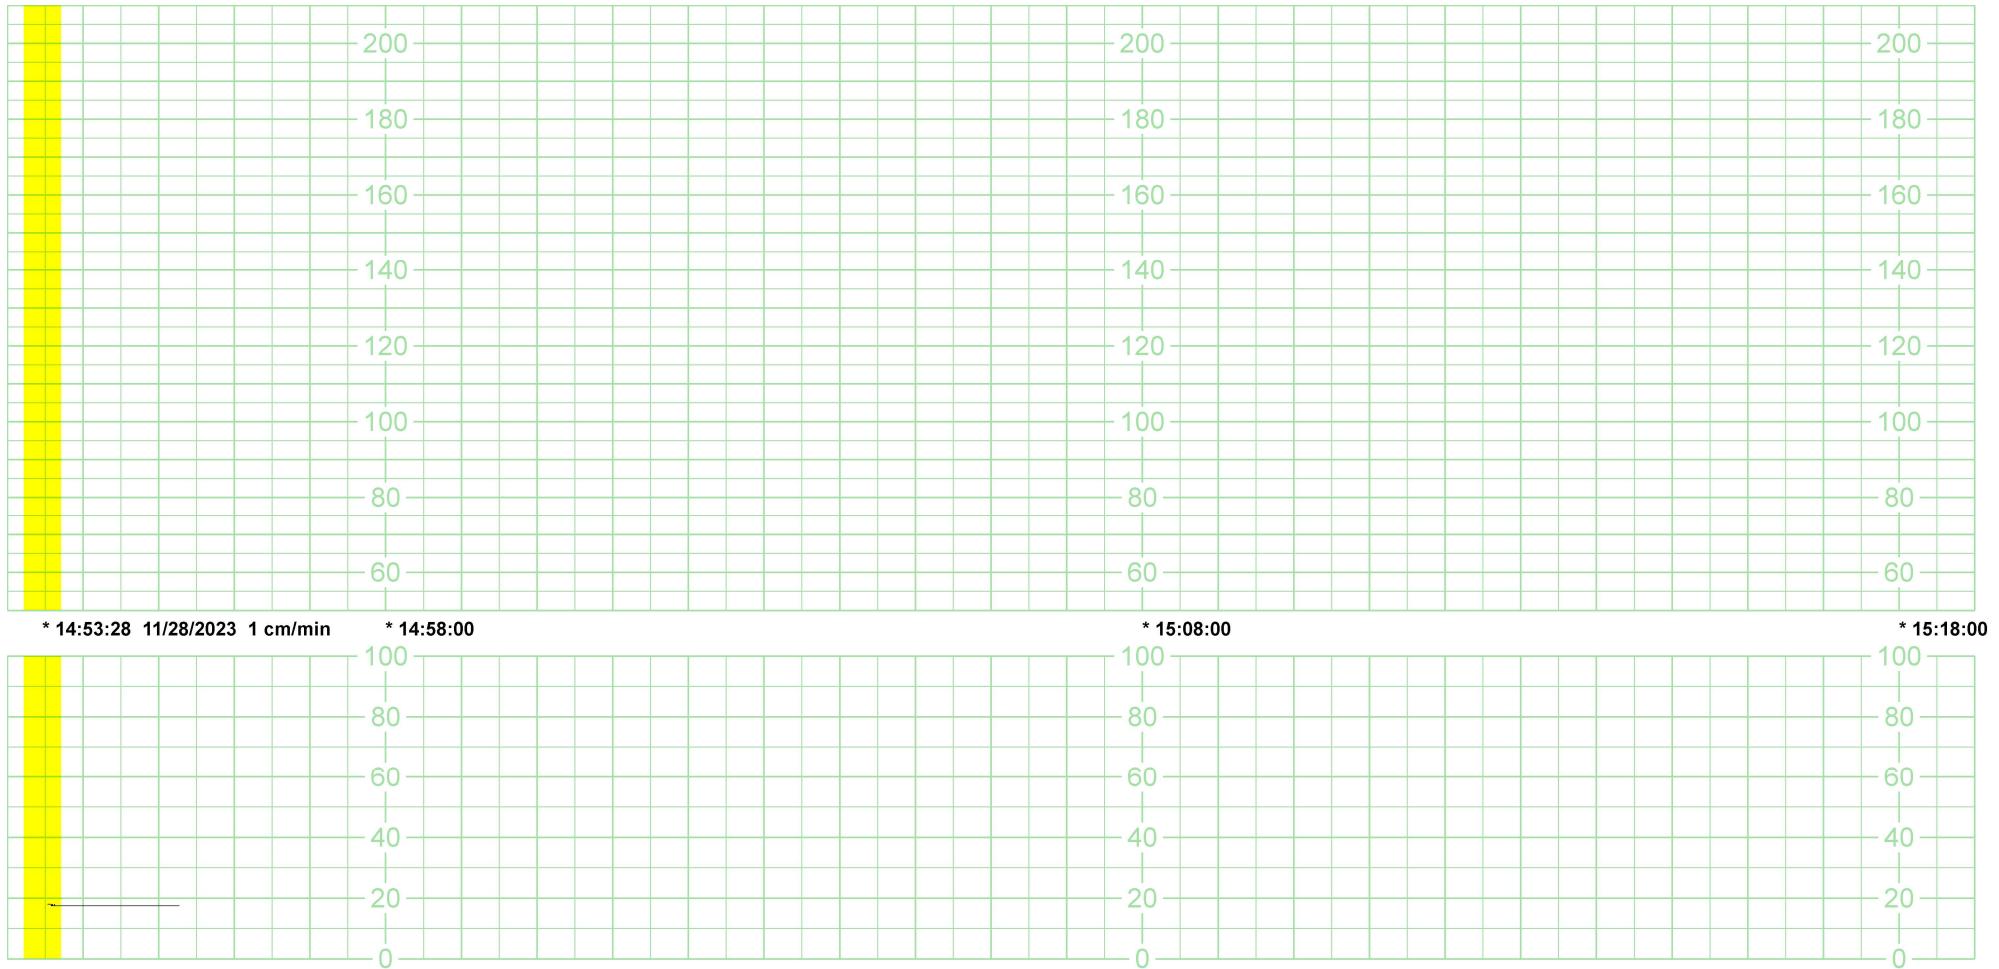



Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
ID del Monitor: M2703A
Modo FCF1: no transductor
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: no transductor
Modo Toco: no transductor
Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

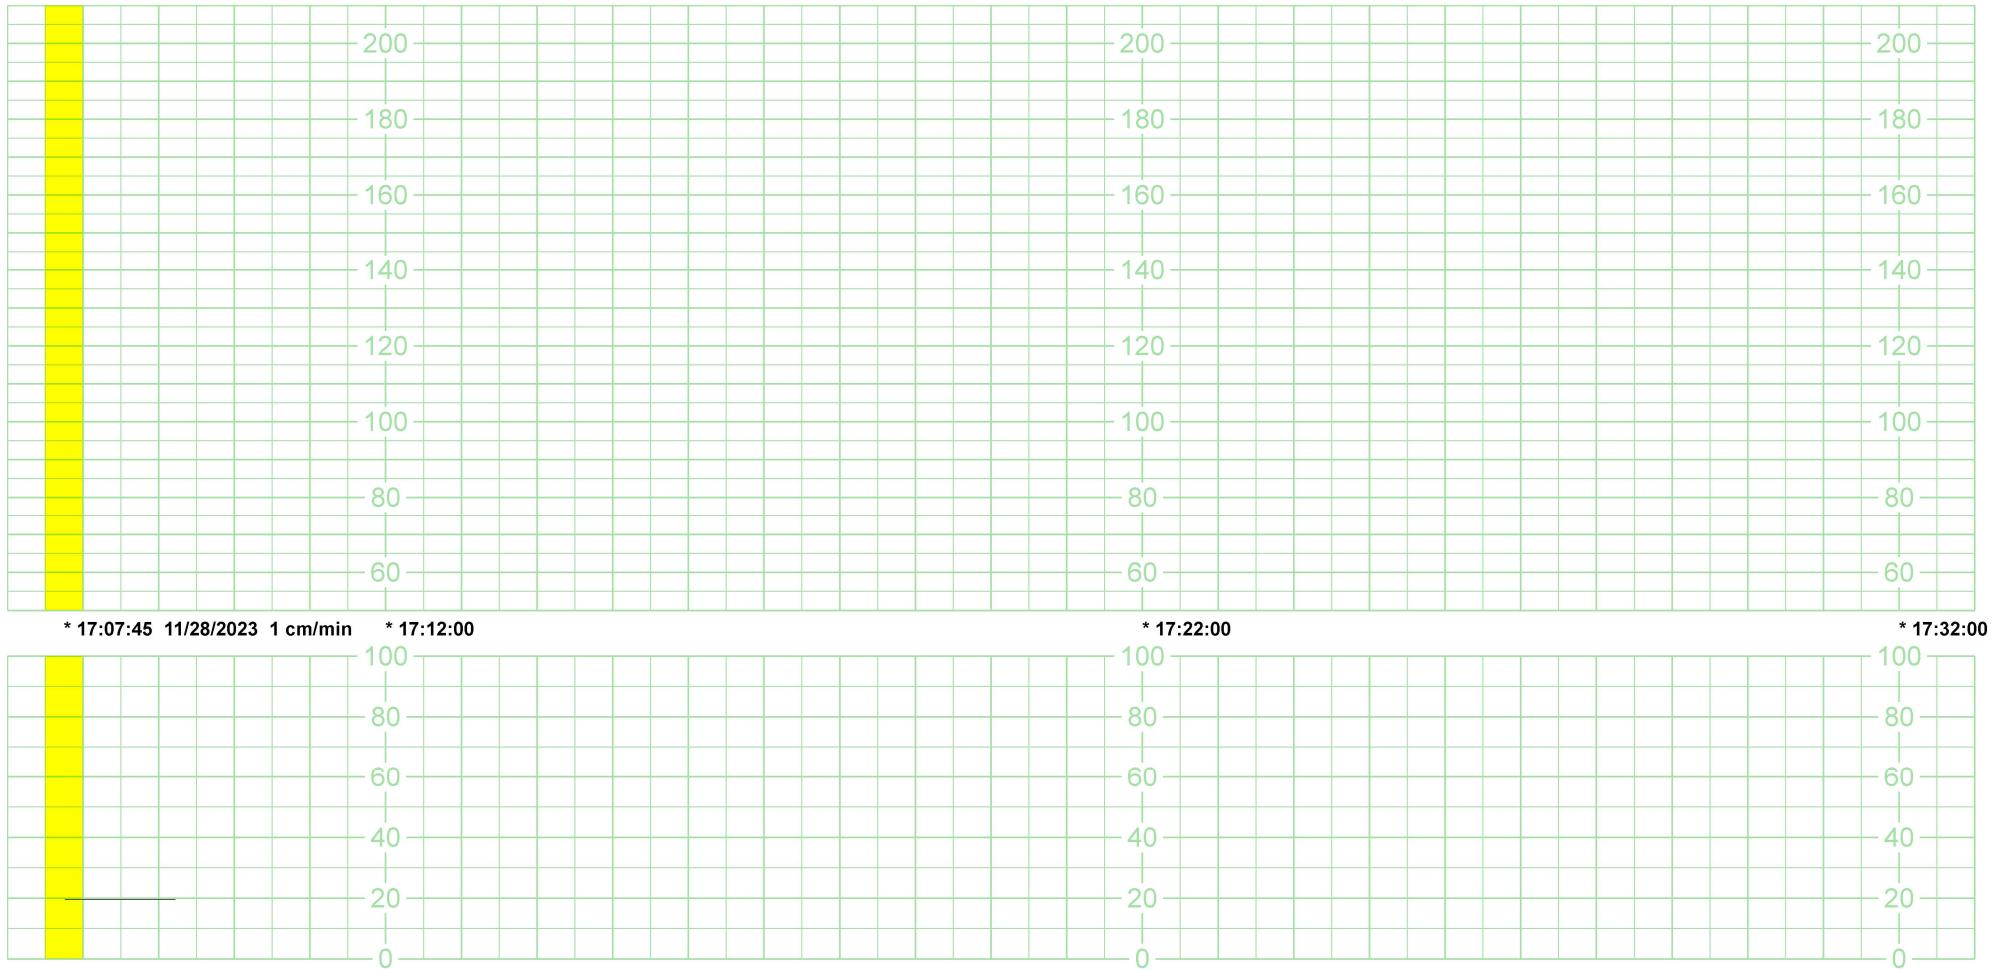


Modo FCM: Pulso Toco
Modo Toco: externo
Modo FCF: US
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
* FCF1: PERDIDA SEÑAL.
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor


Alarma con acuse de recibo

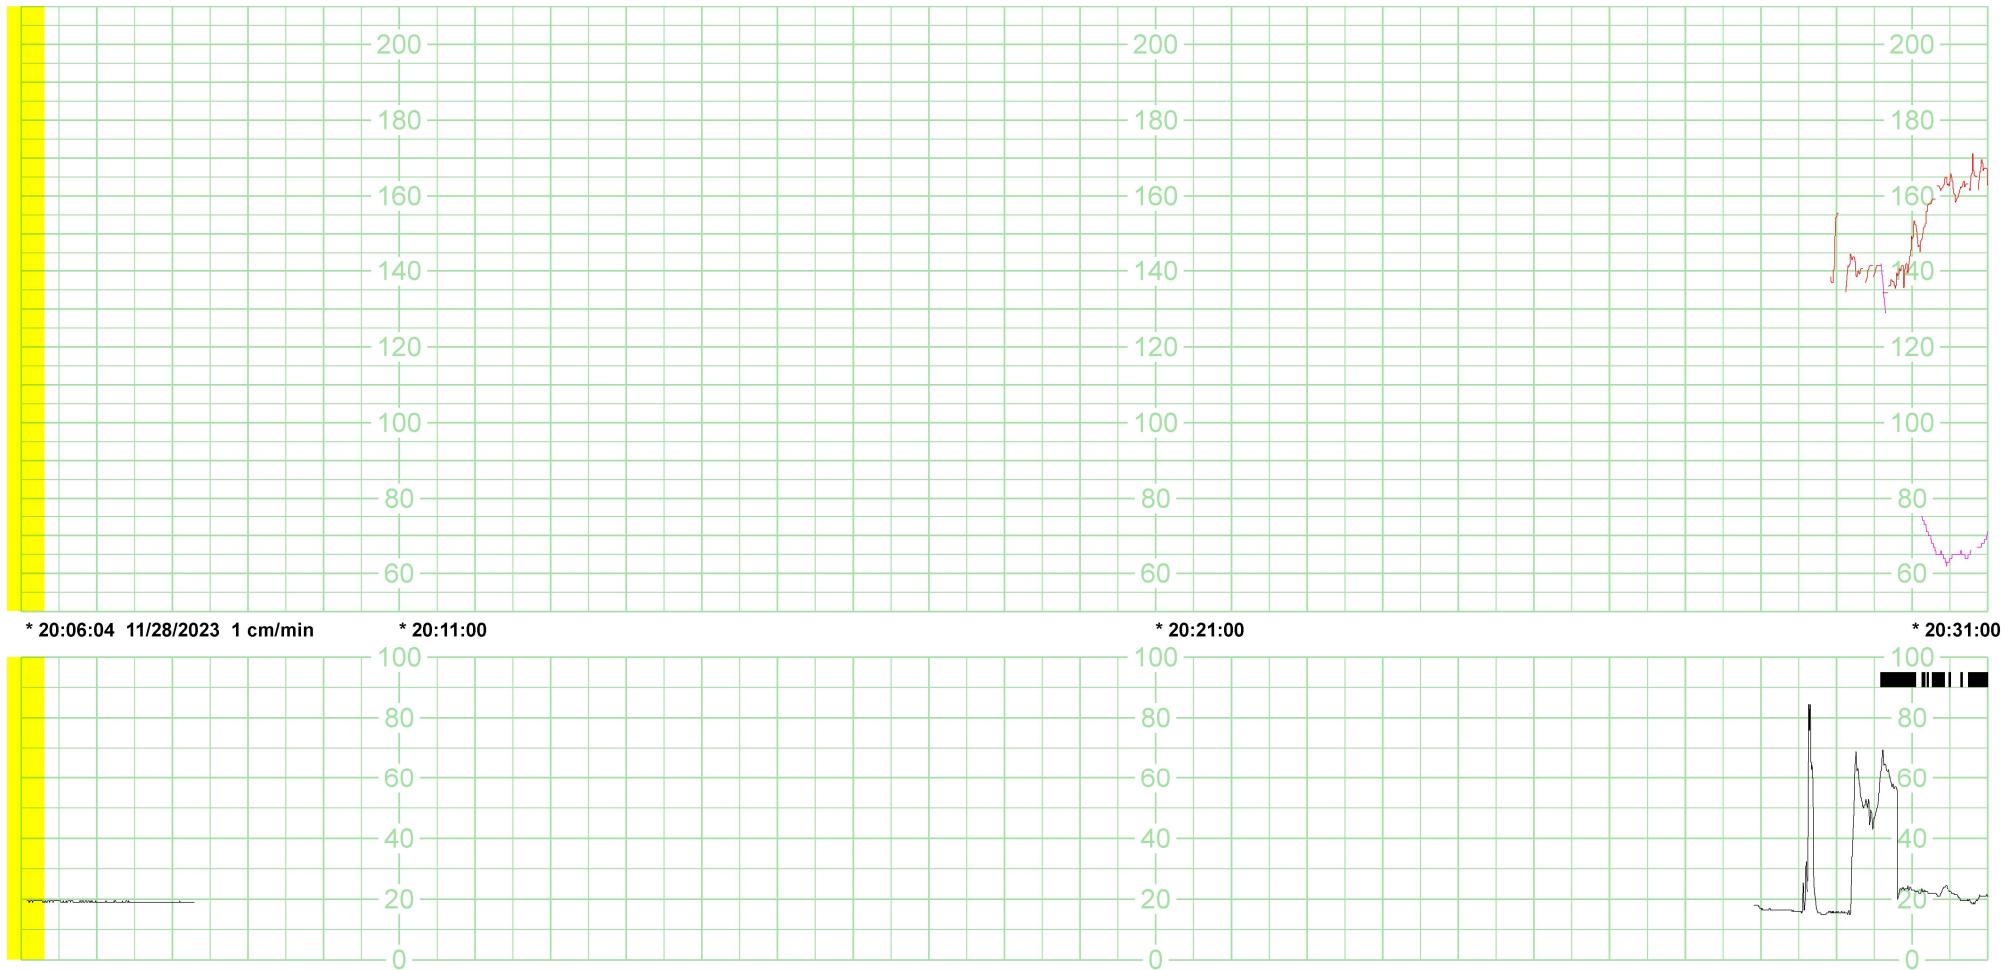

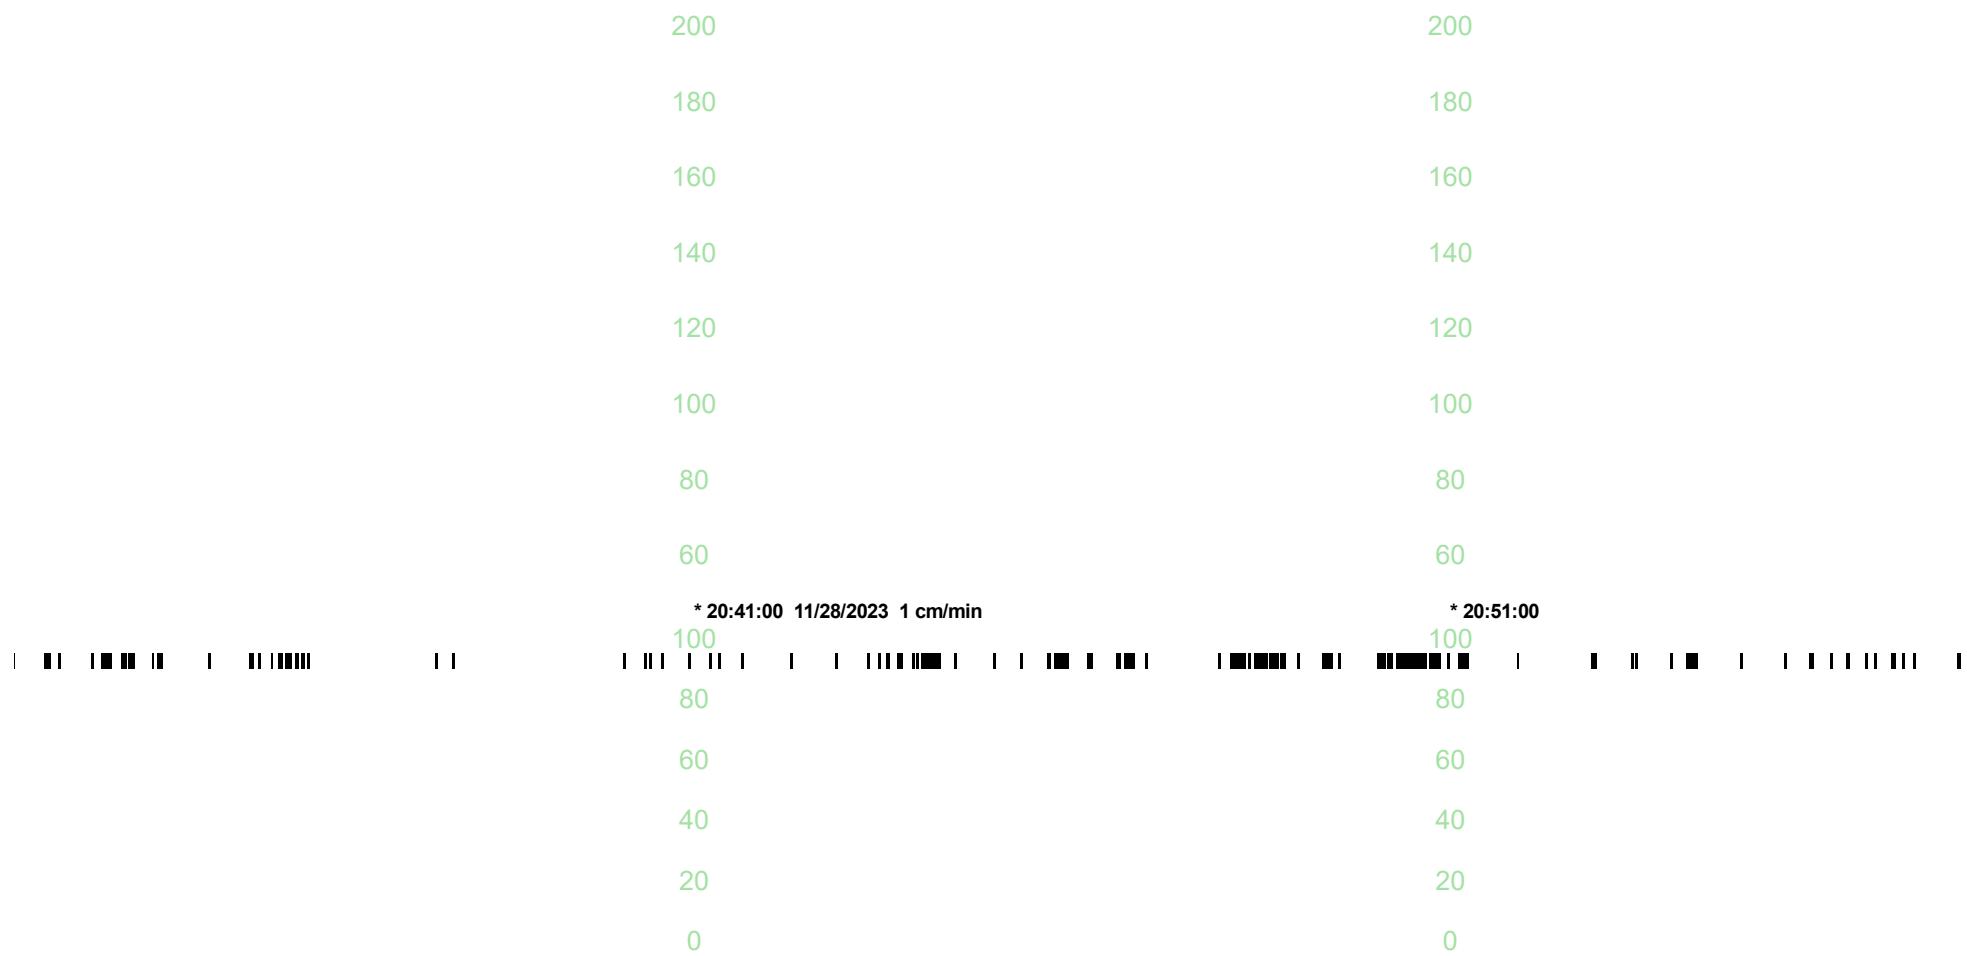

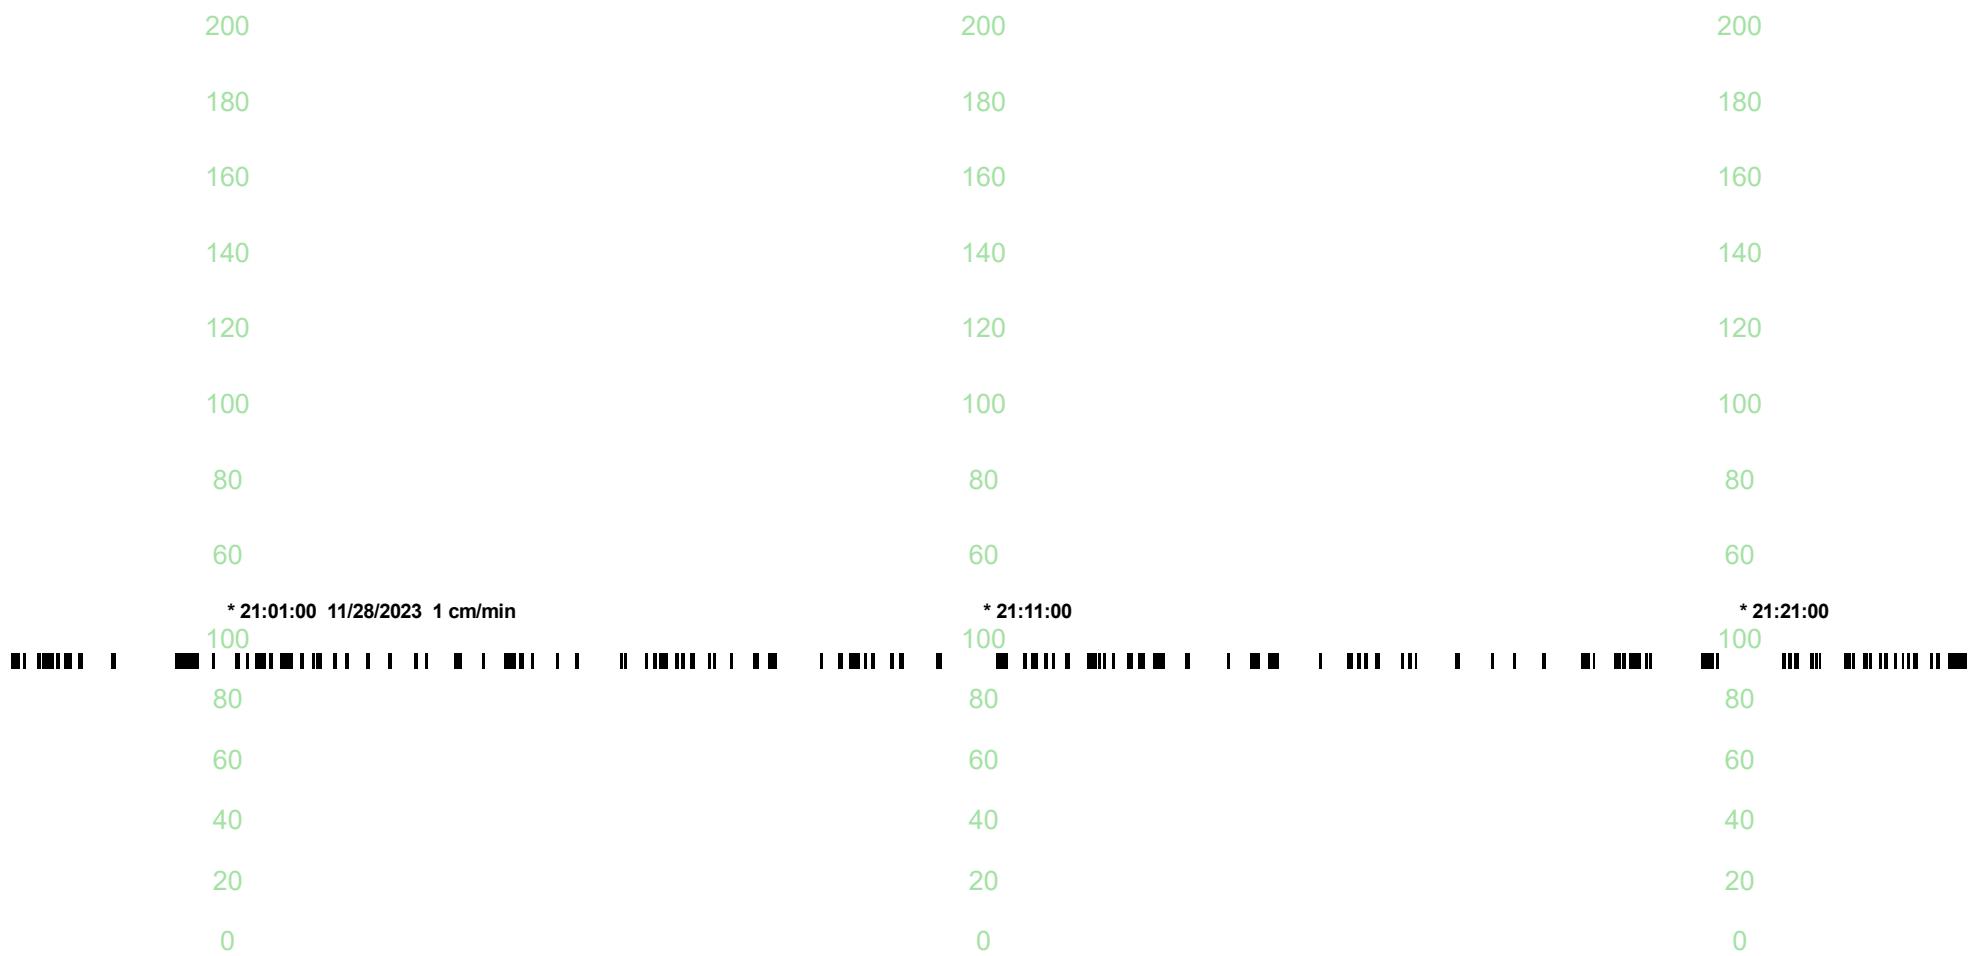

- Estado del monitor: En espera
- Modo FCF1: no transductor
- Modo Toco: no transductor
- Estado del registrador: Desactivado
- Estado del monitor: Activado
- Modo FCF1: US
- Modo Toco: externo
- Estado del registrador: Activado
- Estado del FMP: Activado
- * FCF1: PERDIDA SEÑAL
- Estado del monitor: En espera
- Modo FCF1: no transductor
- Modo Toco: no transductor
- Estado del registrador: Desactivado

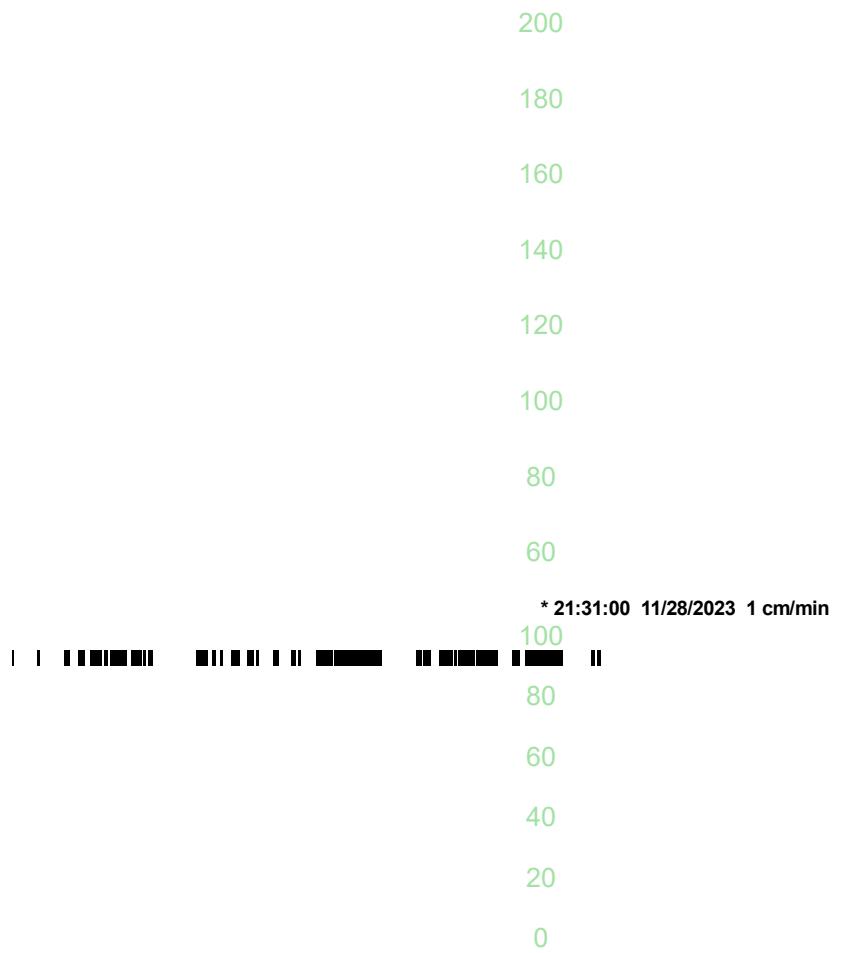


Alarma con acuse de recibo



Estado del monitor: Desactivado
Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A

Estado del monitor: Desactivado
Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A

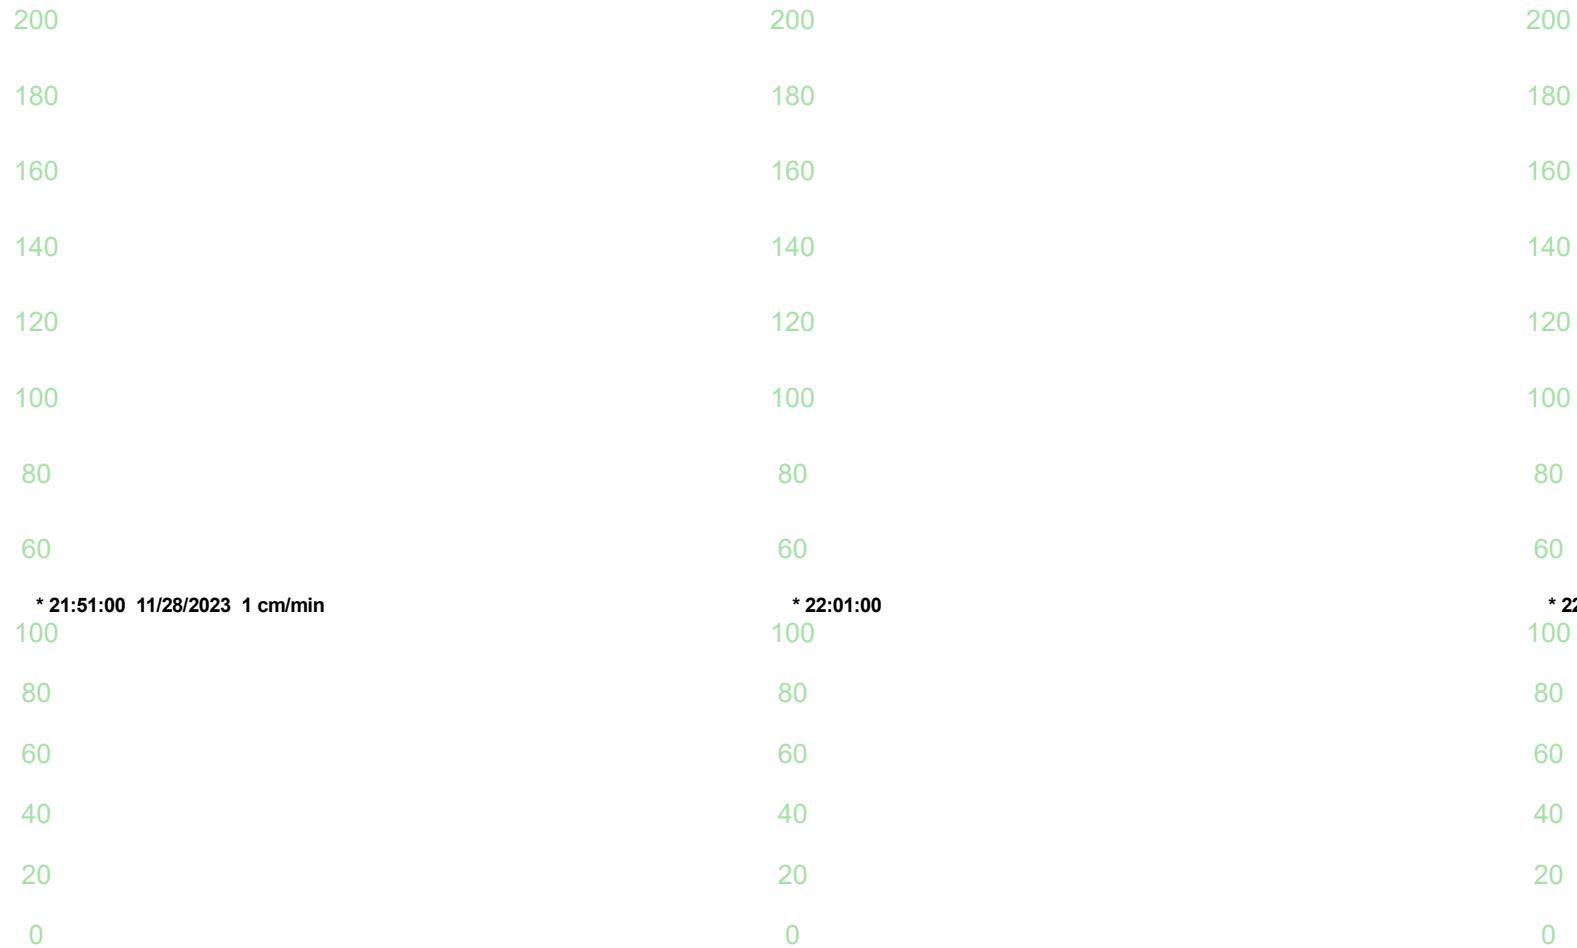

Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL

Alarma con acuse de recibo

** FCF1: PERDIDA SEÑAL

Alarma con acuse de recibo



** FCF1: PERDIDA SEÑAL

Alarma con acuse de recibo




** FCF1: PERDIDA SEÑAL


Alarma con acuse de recibo

** FCF1: PERDIDA SEÑAL


Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

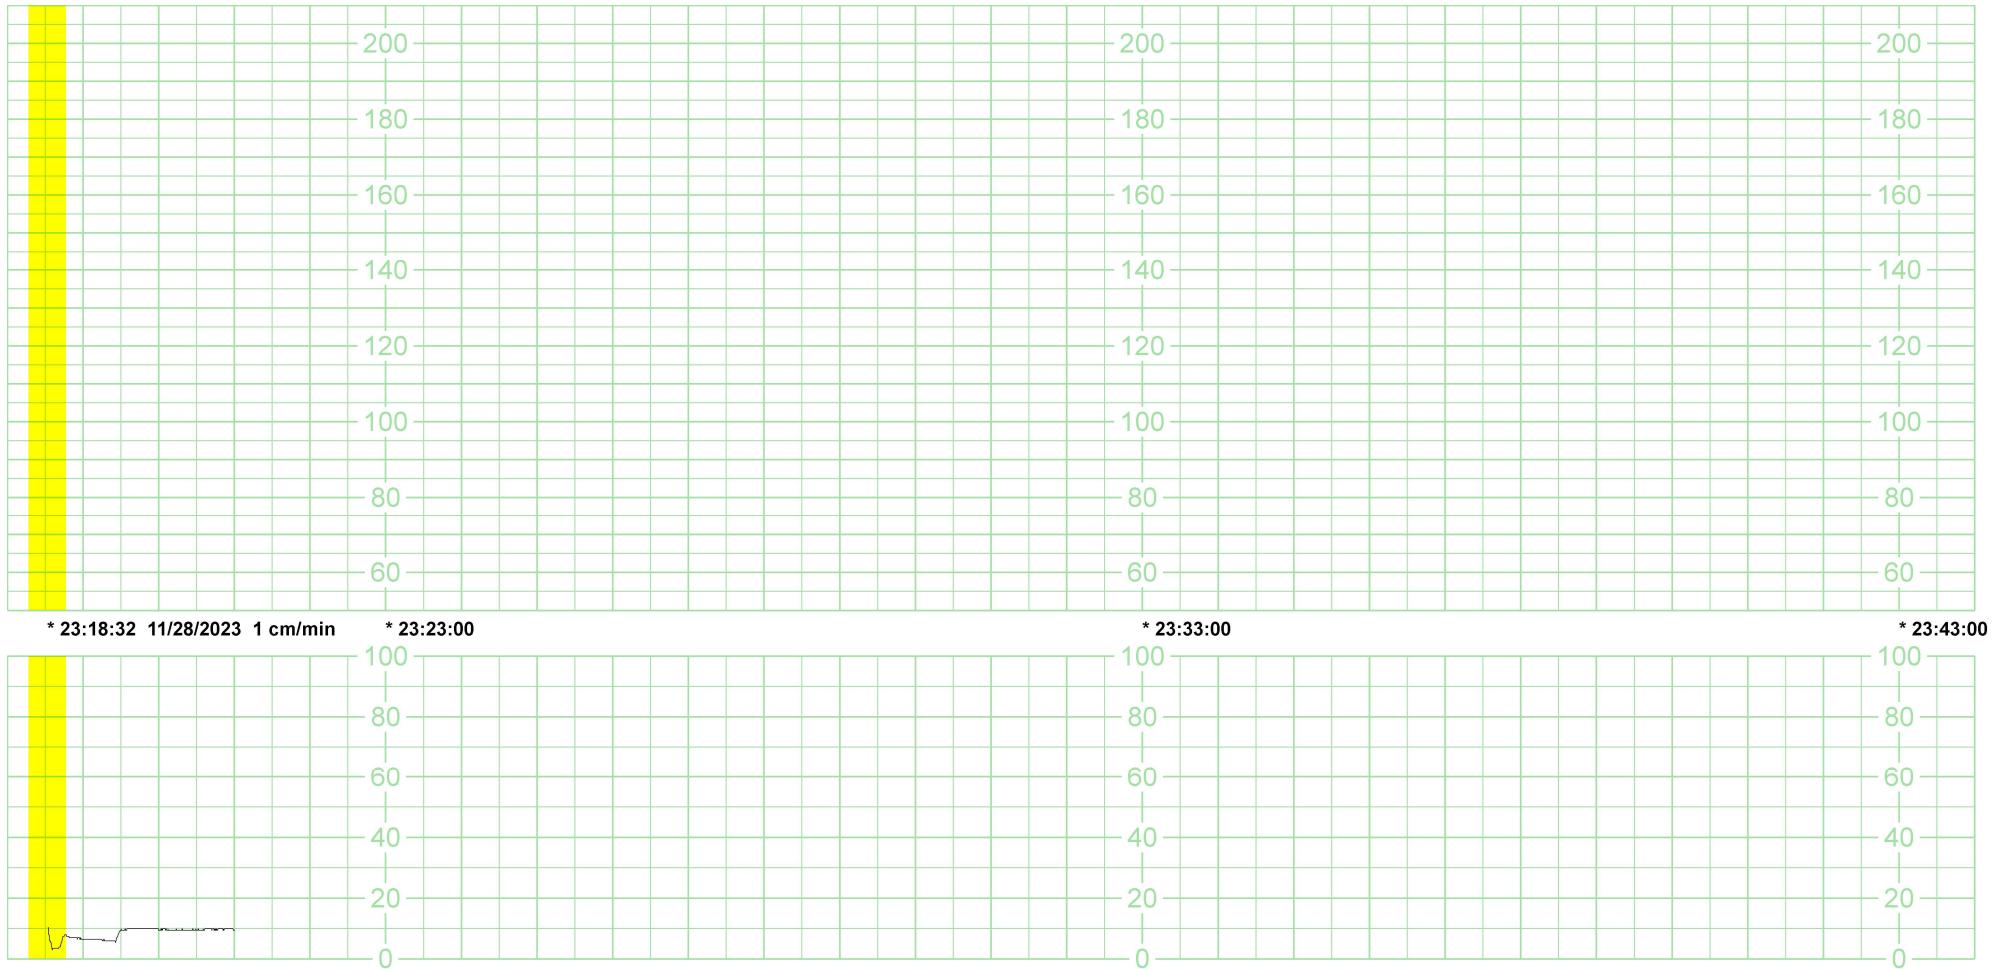


Estado del monitor: Activado
Modo FCFI: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCFI: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

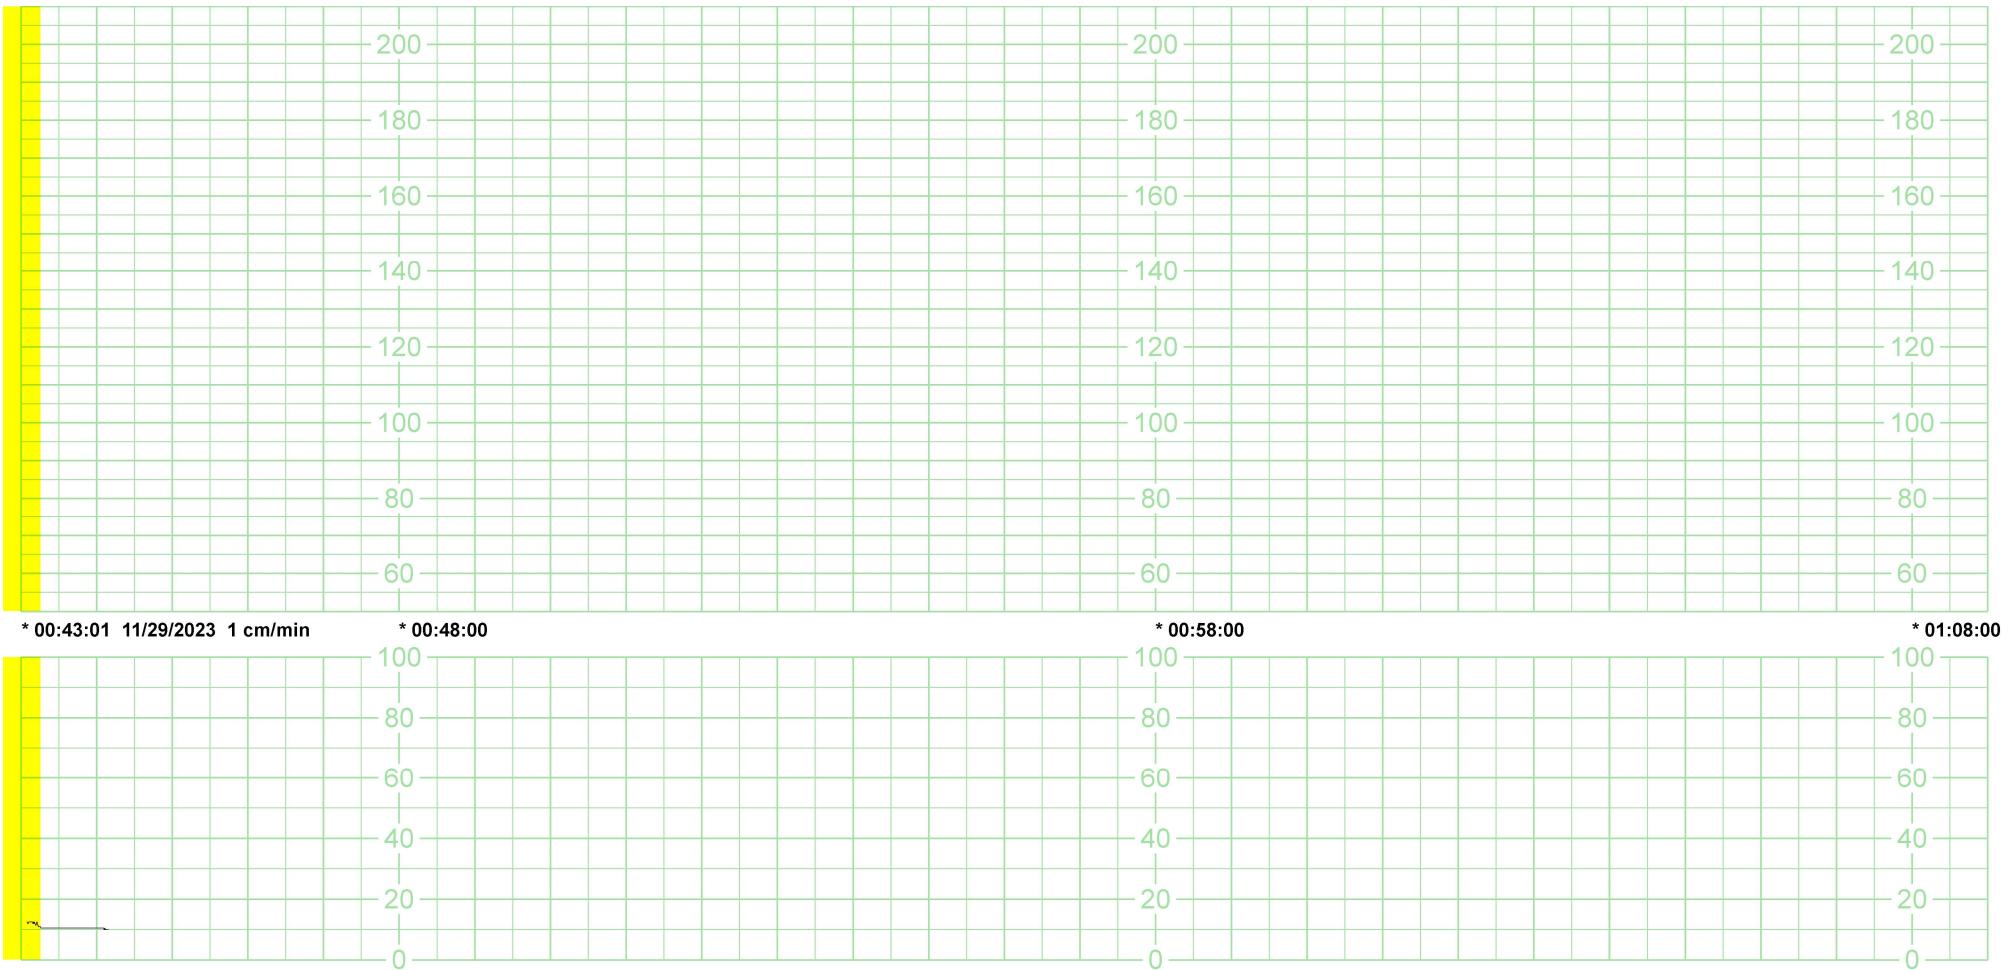

Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

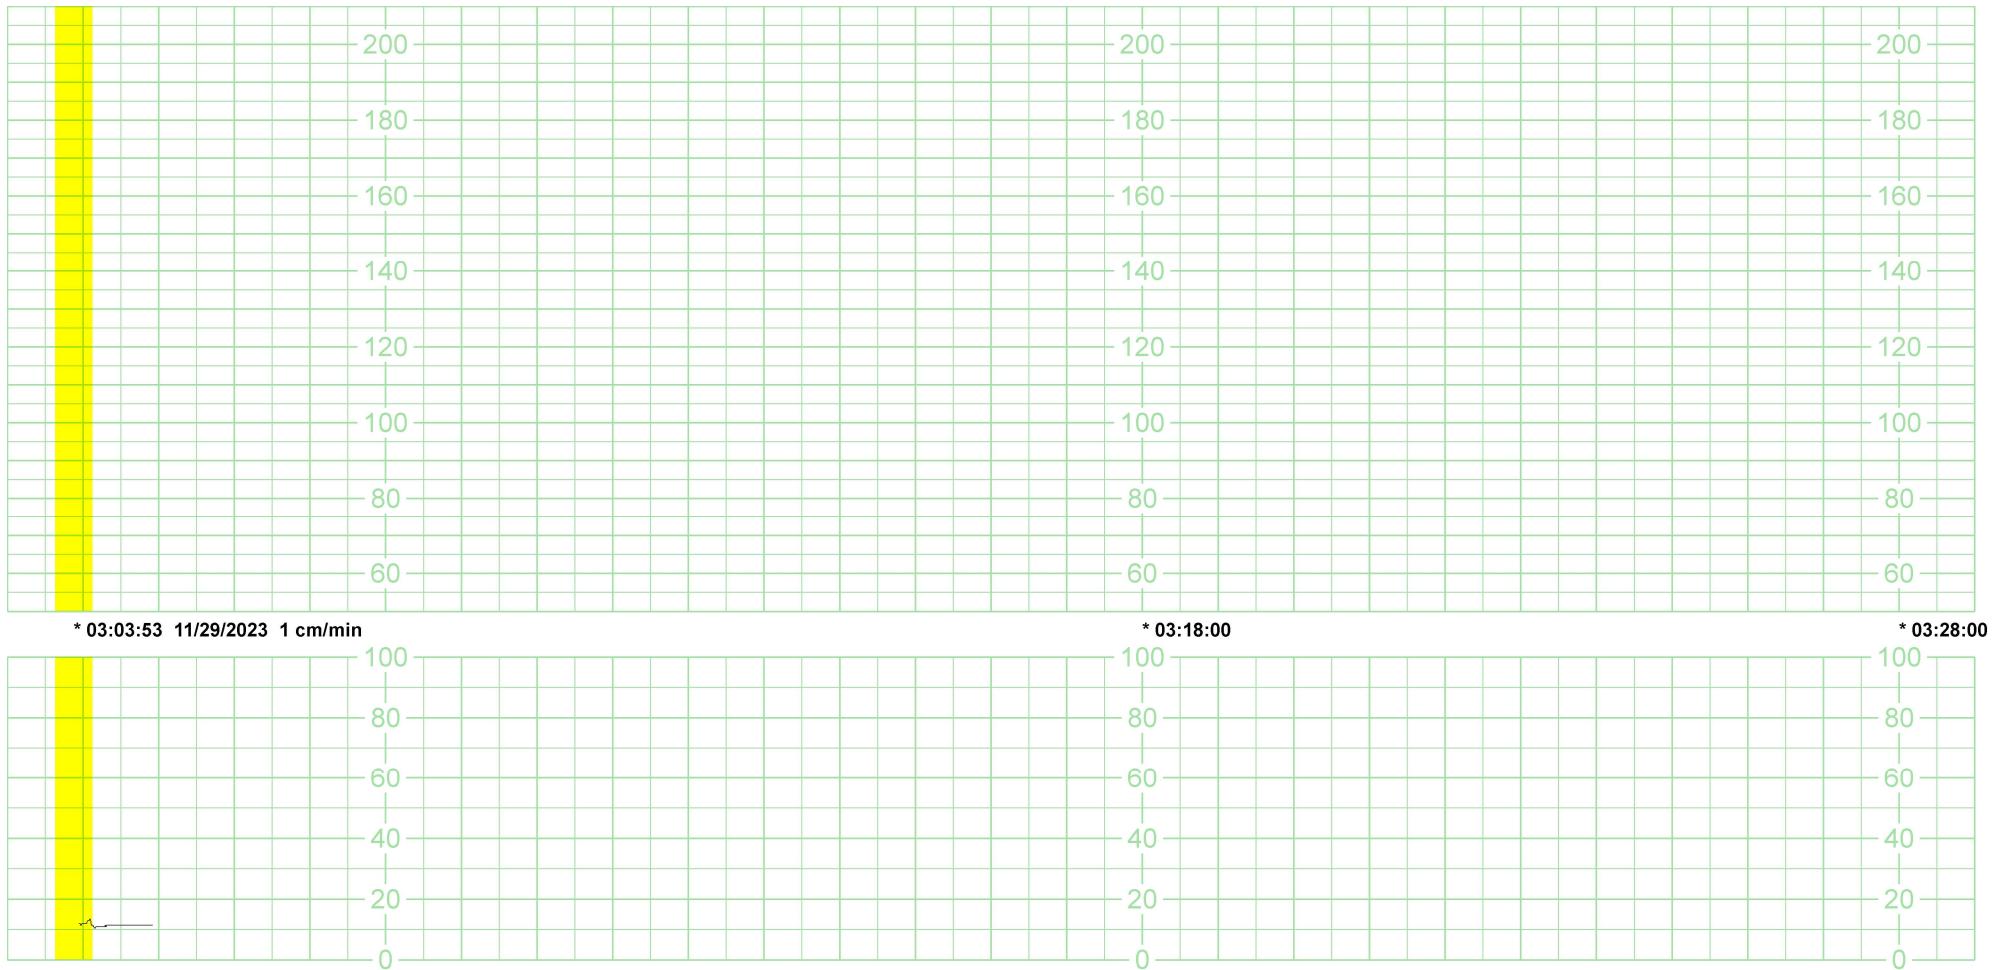

Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

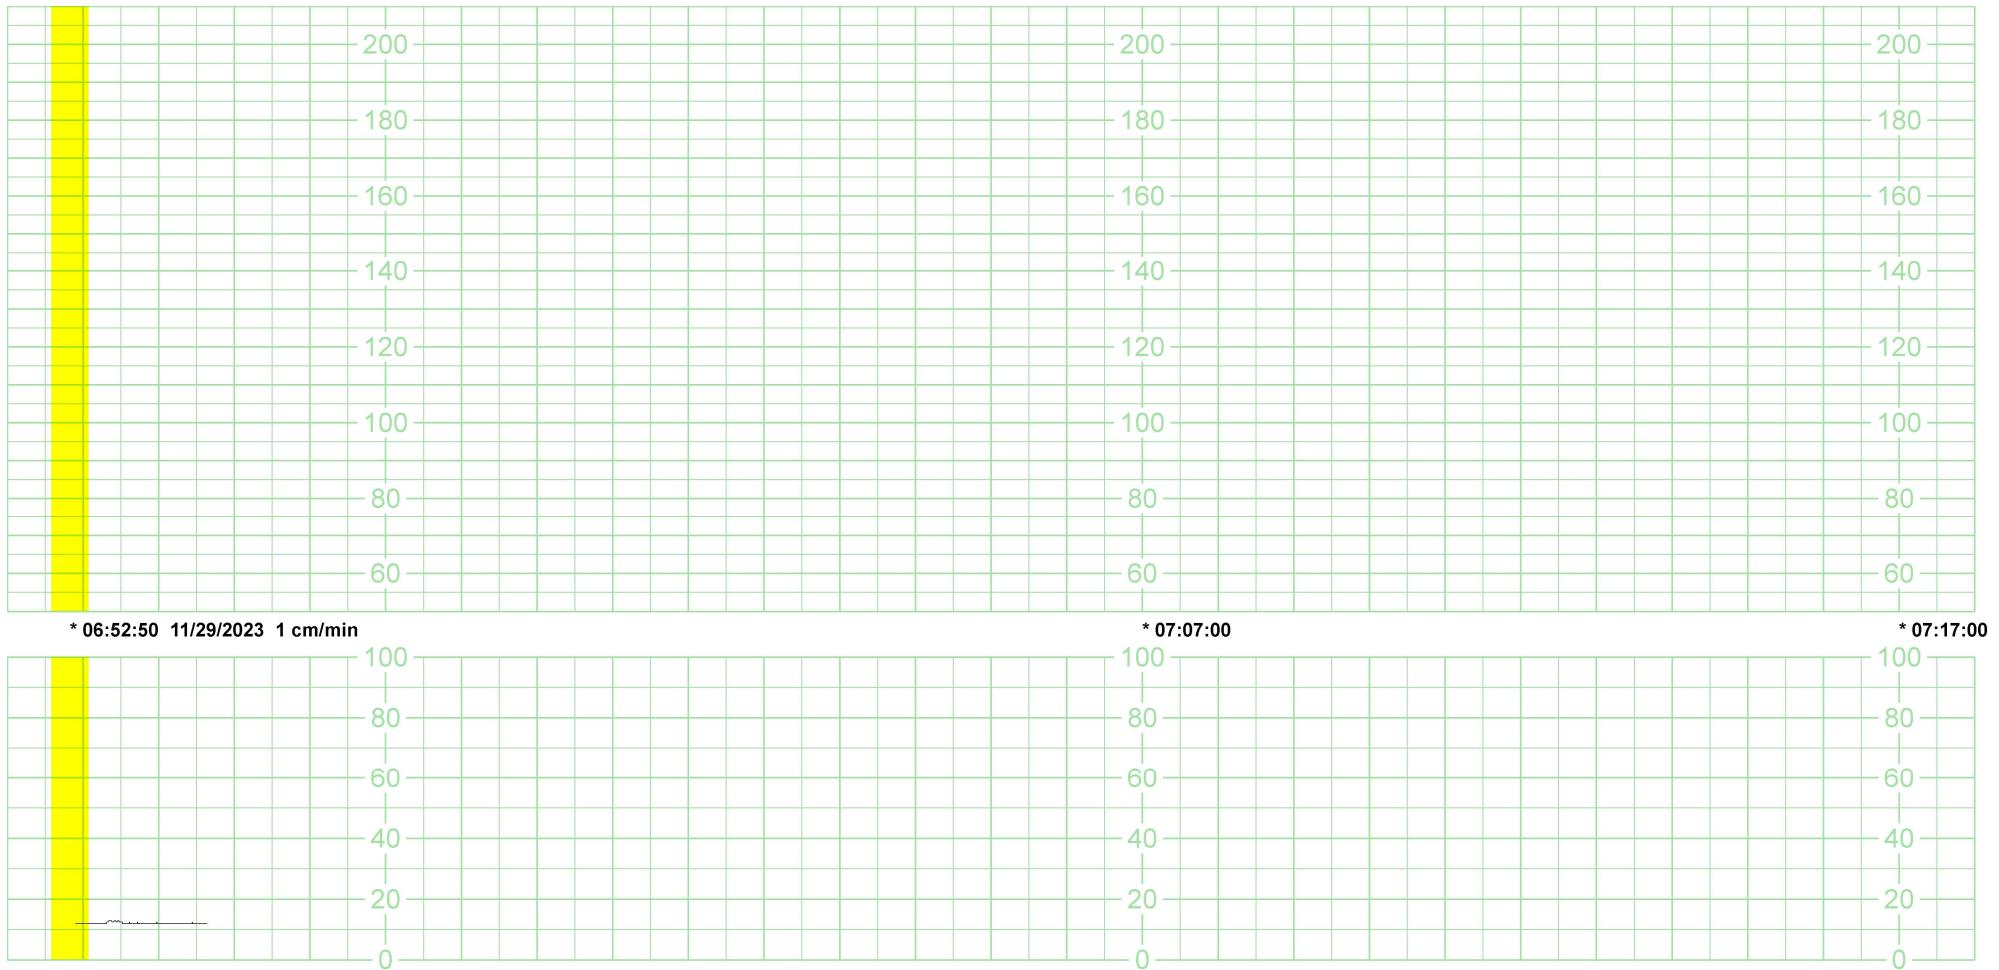


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor

Modo Toco: externo
Modo FCF: US
Estado del FMP: Activado


Estado del papel: Sin papel
* FIN DEL PAPEL
Estado del registrador: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

Estado del papel: Papel disponible

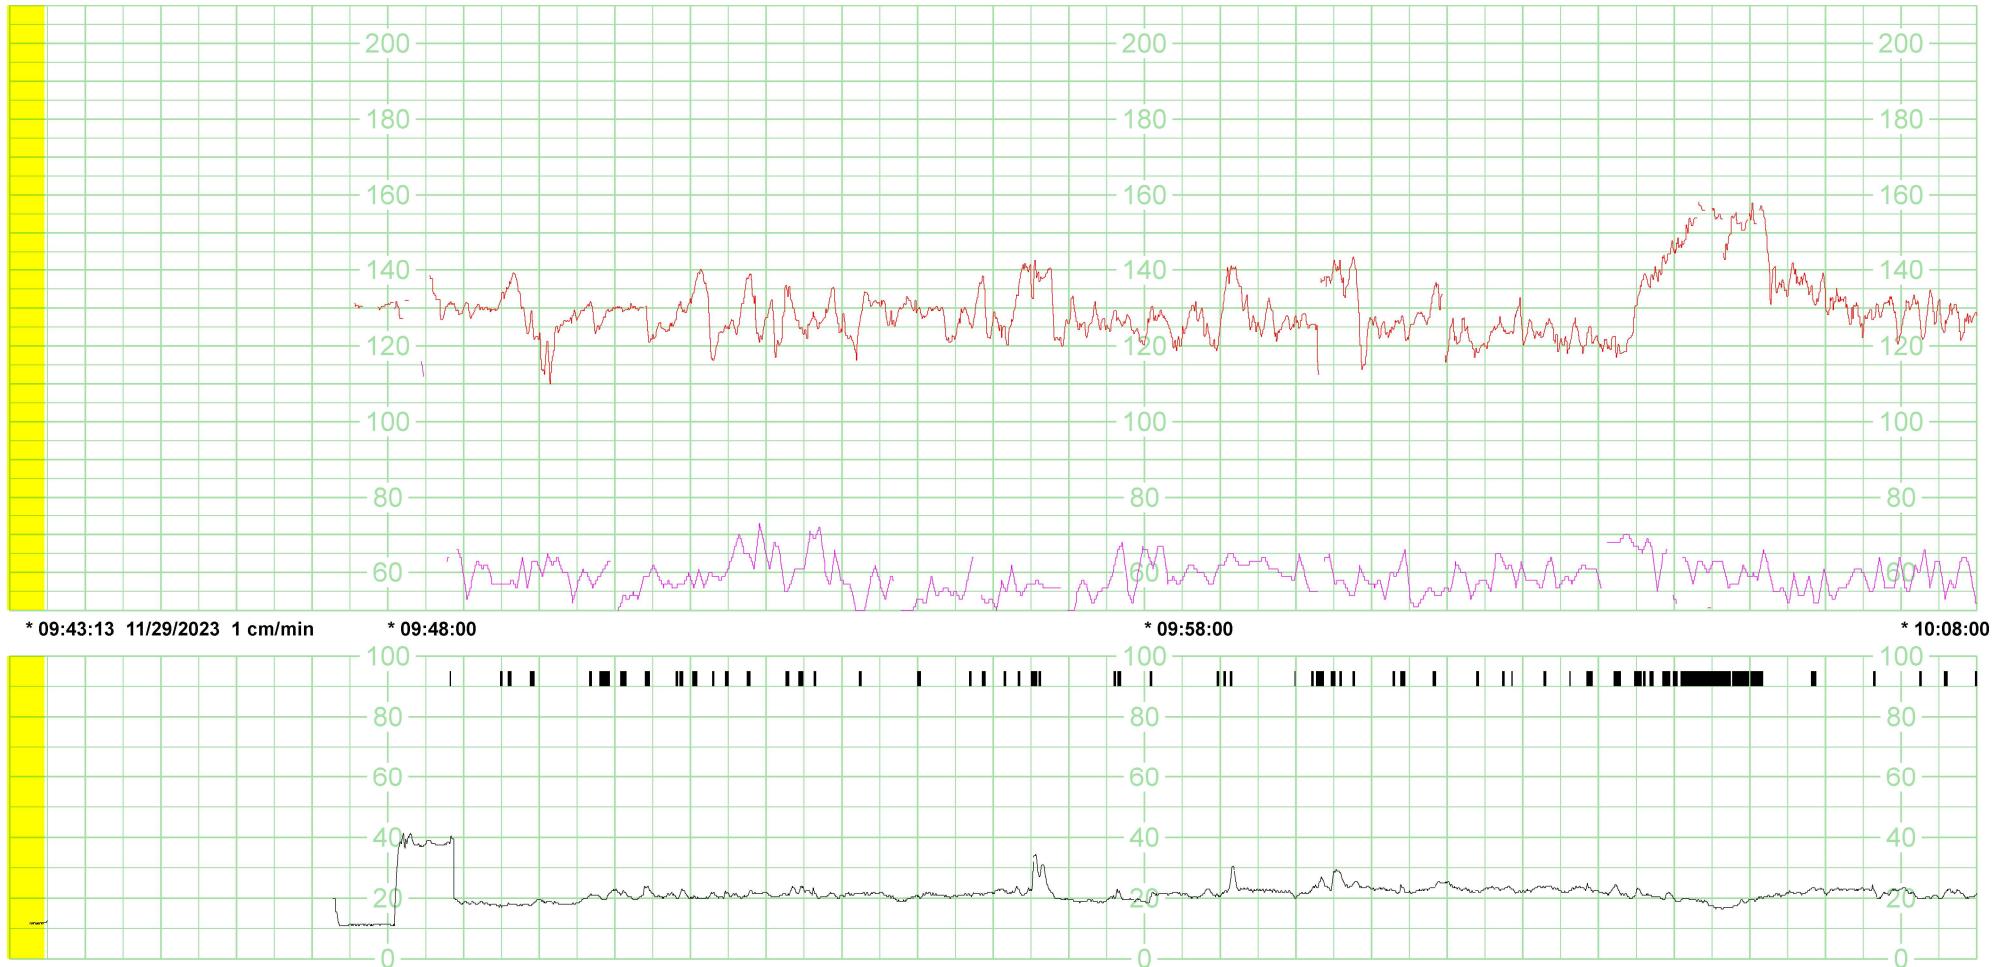

||||| ||||| ||||| ||||| |||||

* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo
Estado del monitor: Desactivado

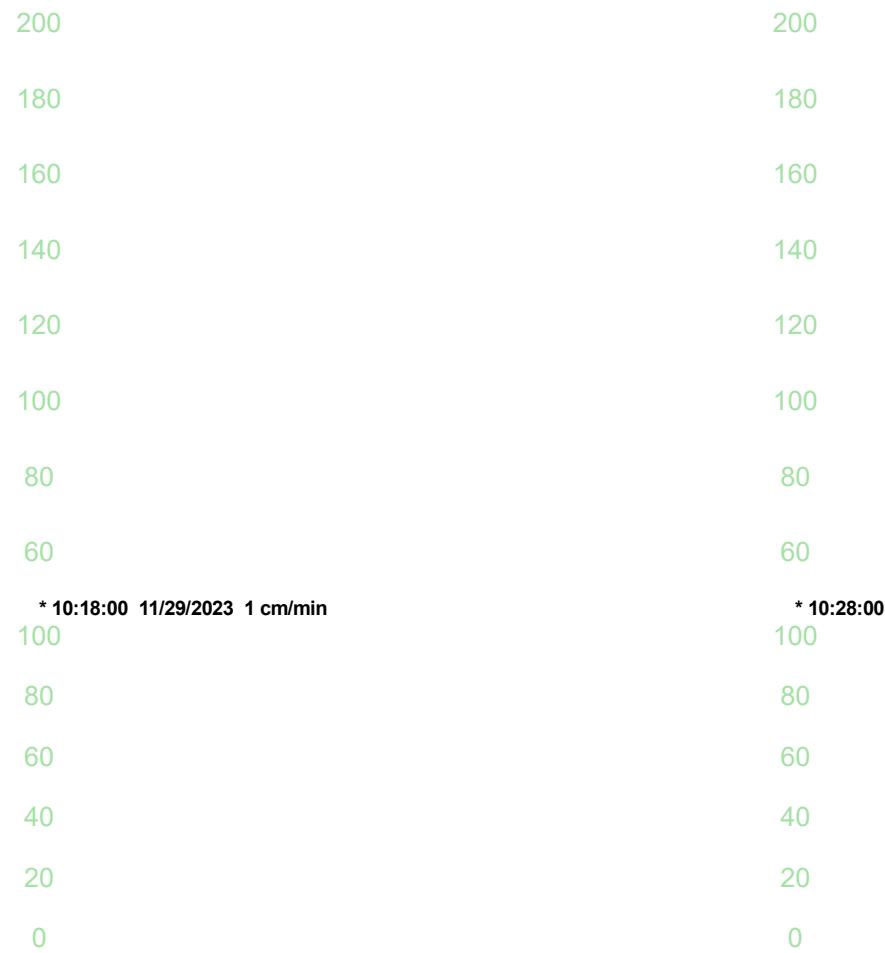

Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo

Modo FCM: Pulso Toco

Estado del registrador: Activado

