


Estado del monitor: Activado  
Modo FCF1: US  
Modo Toco : externo  
Estado del registrador: Activado  
Estado del FMP: Activado  
Modo FCM: Pulso Toco  
Modo FCF1: no transductor

Estado del monitor: En espera  
Modo Toco : no transductor  
Estado del registrador: Desactivado

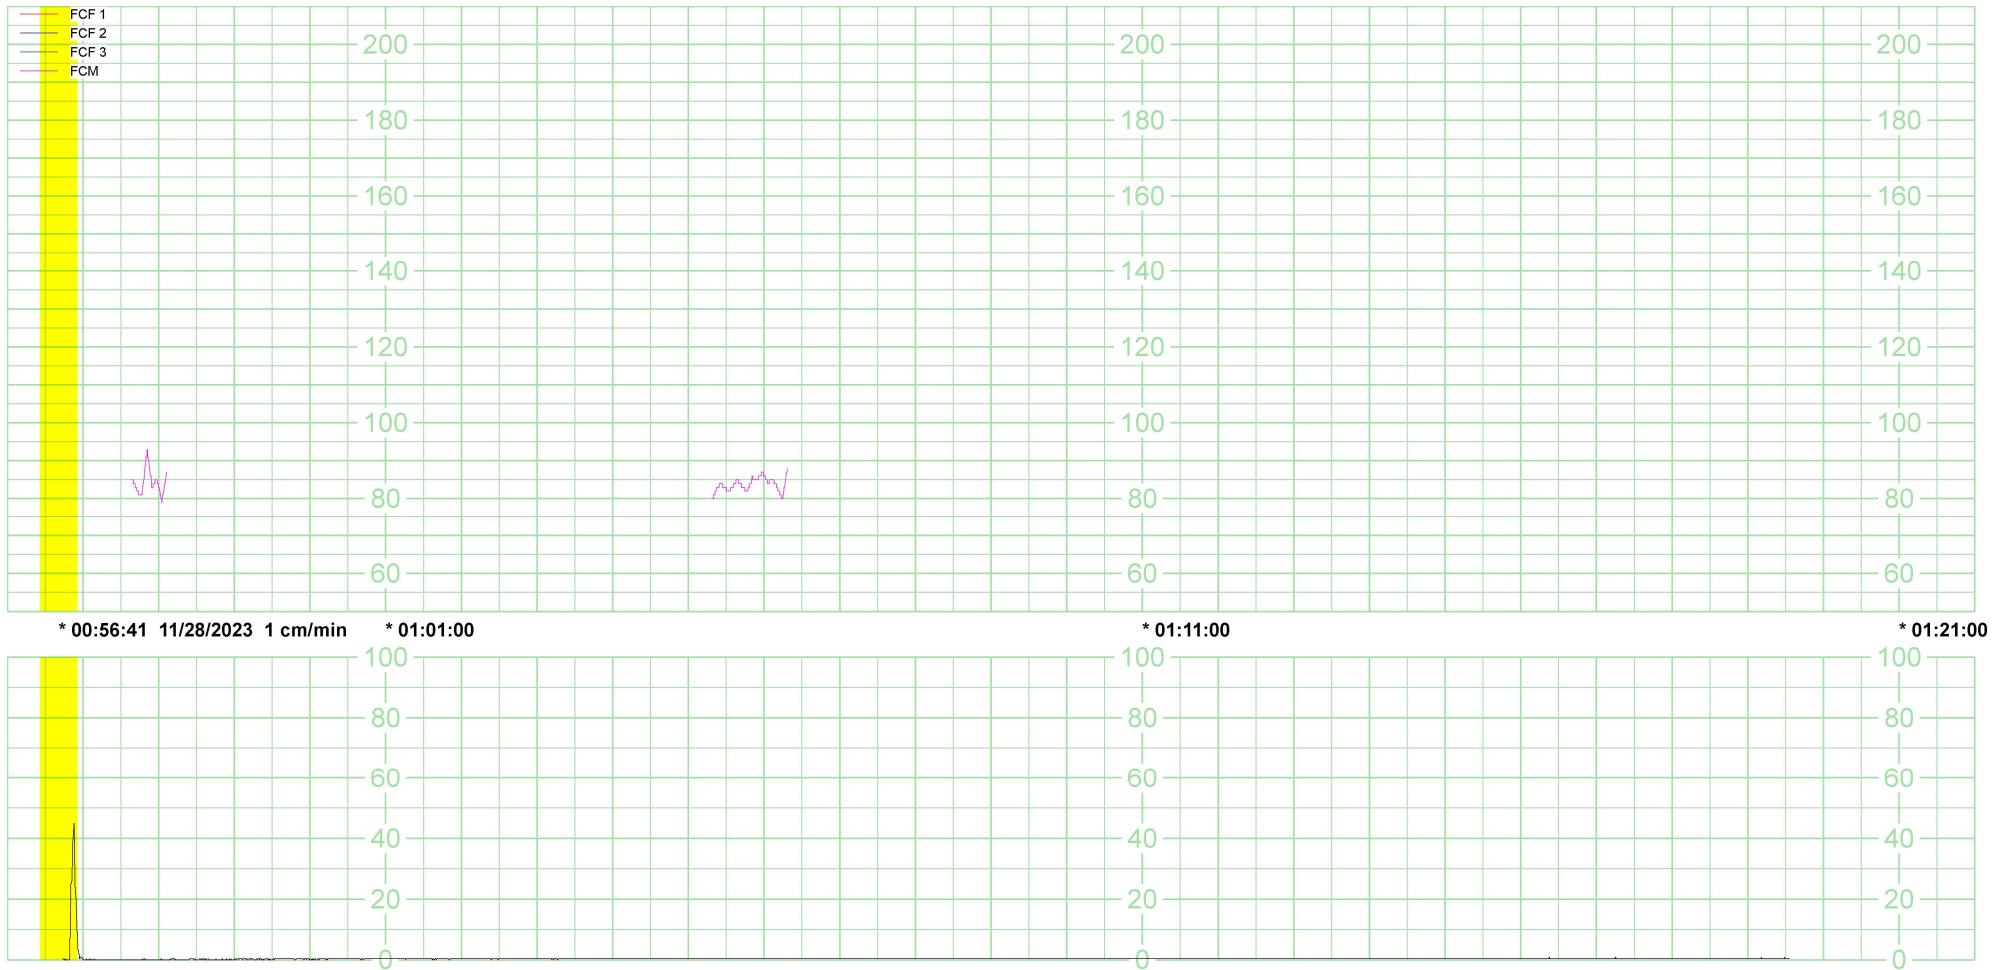



Estado de la telemetría: Activado  
Modo FCF1: US  
Estado del FMP: Activado  
Estado del registrador: Desactivado  
Estado del registrador: Activado  
Modo Toco: externo

Modo FCF1: no transductor


Modo FCF2: US

Modo Toco: no transductor  
Modo Toco : externo

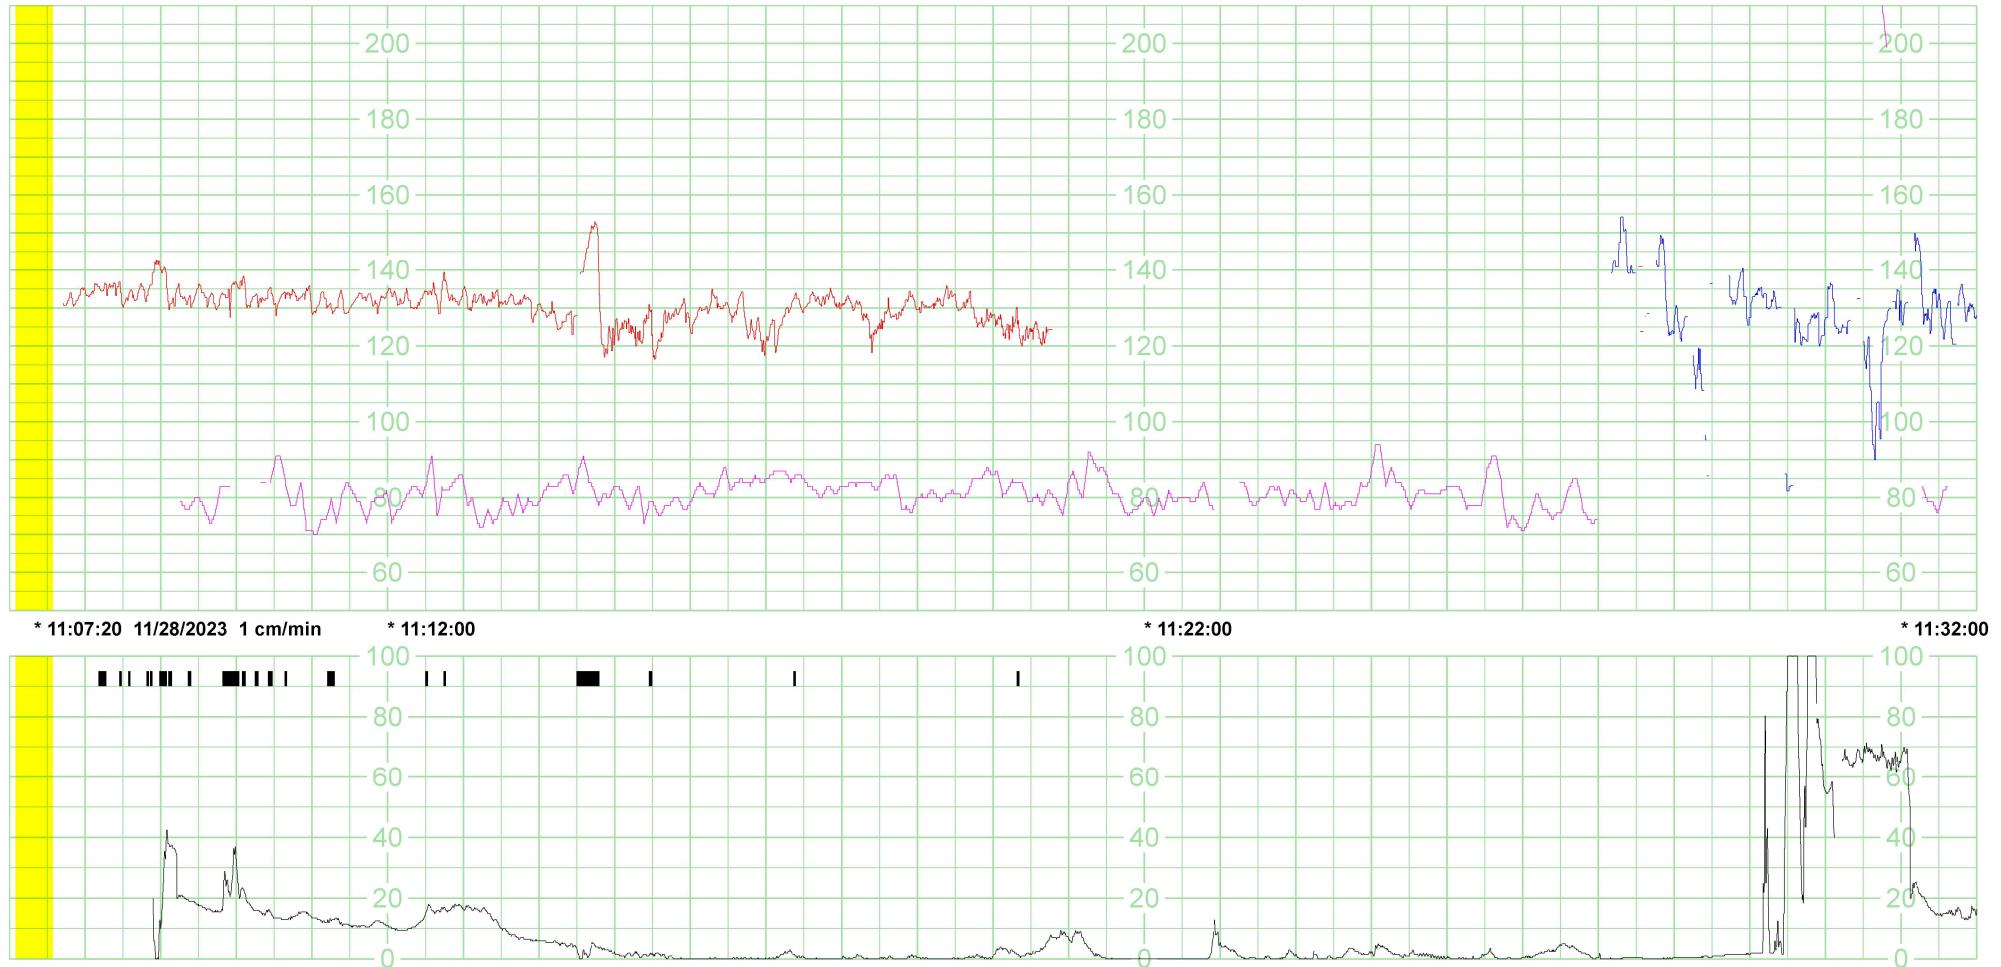

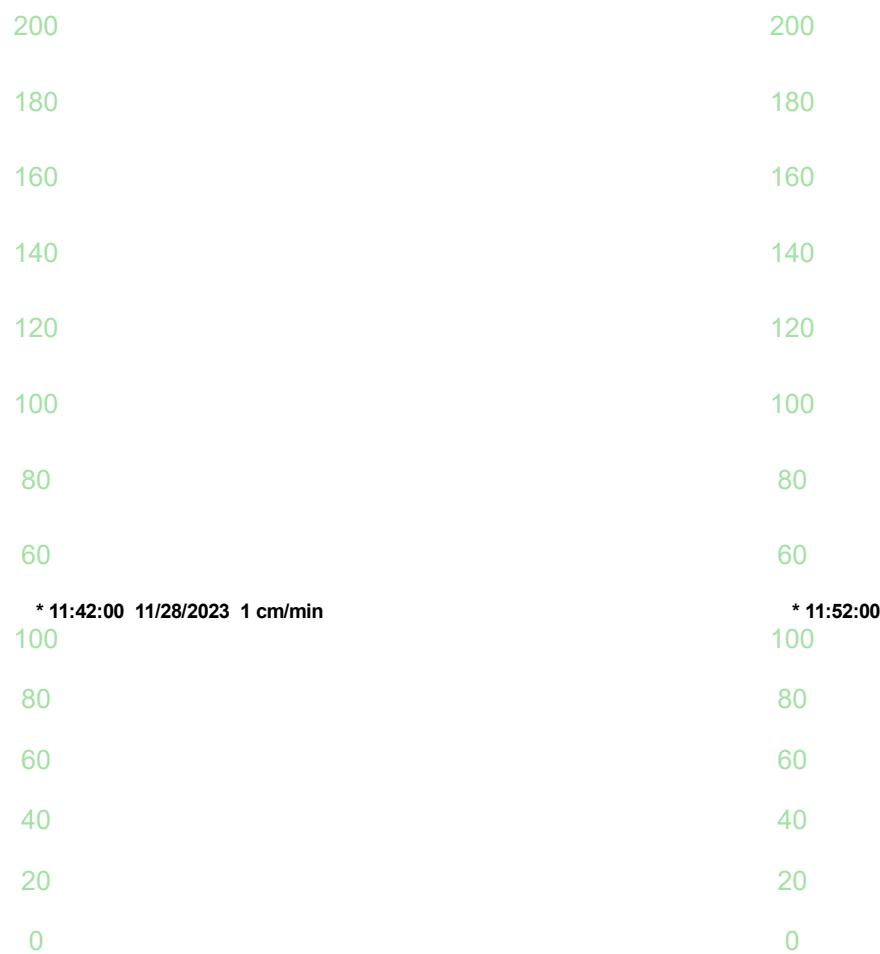


Estado del monitor: En espera  
Modo FCF2: no transductor  
Modo Toco: no transductor  
Estado del registrador: Desactivado  
Estado de la telemetría: Desactivado

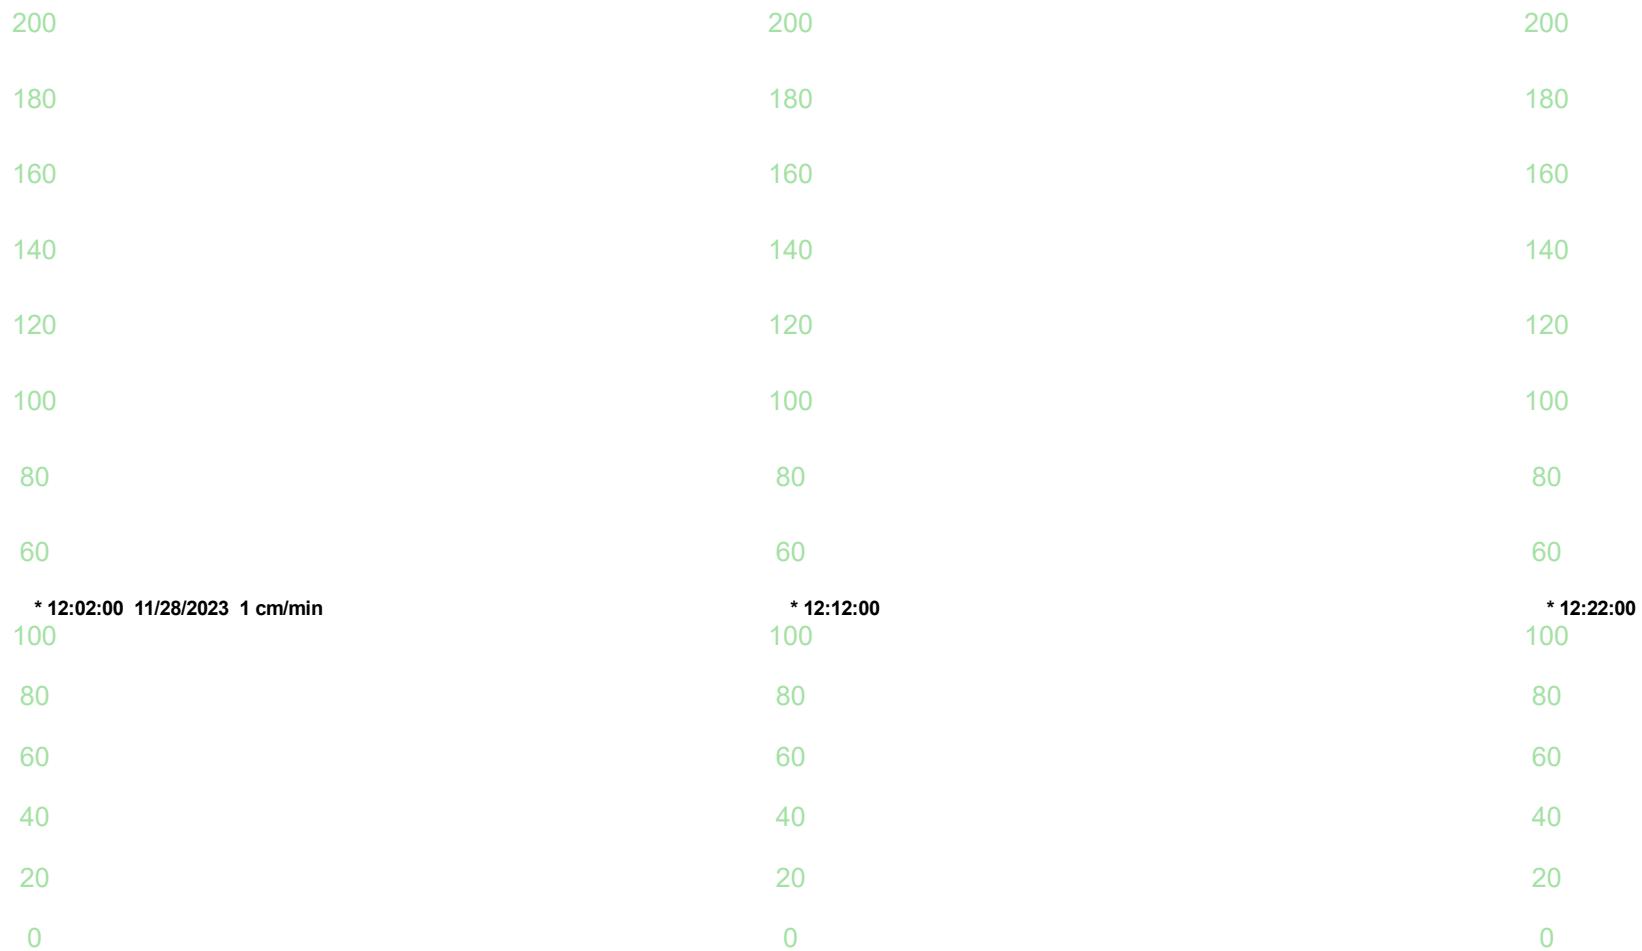


Estado de la telemetría: Activado  
Estado del monitor: Activado  
Estado del registrador: Activado  
Estado de la telemetría: Desactivado  
Estado de la telemetría: Activado  
Modo FCF: US  
Estado del FMP: Activado  
Modo Toco: externo


\*\* FCF1: BRADICARDIA  
Alarma con acuse de recibo



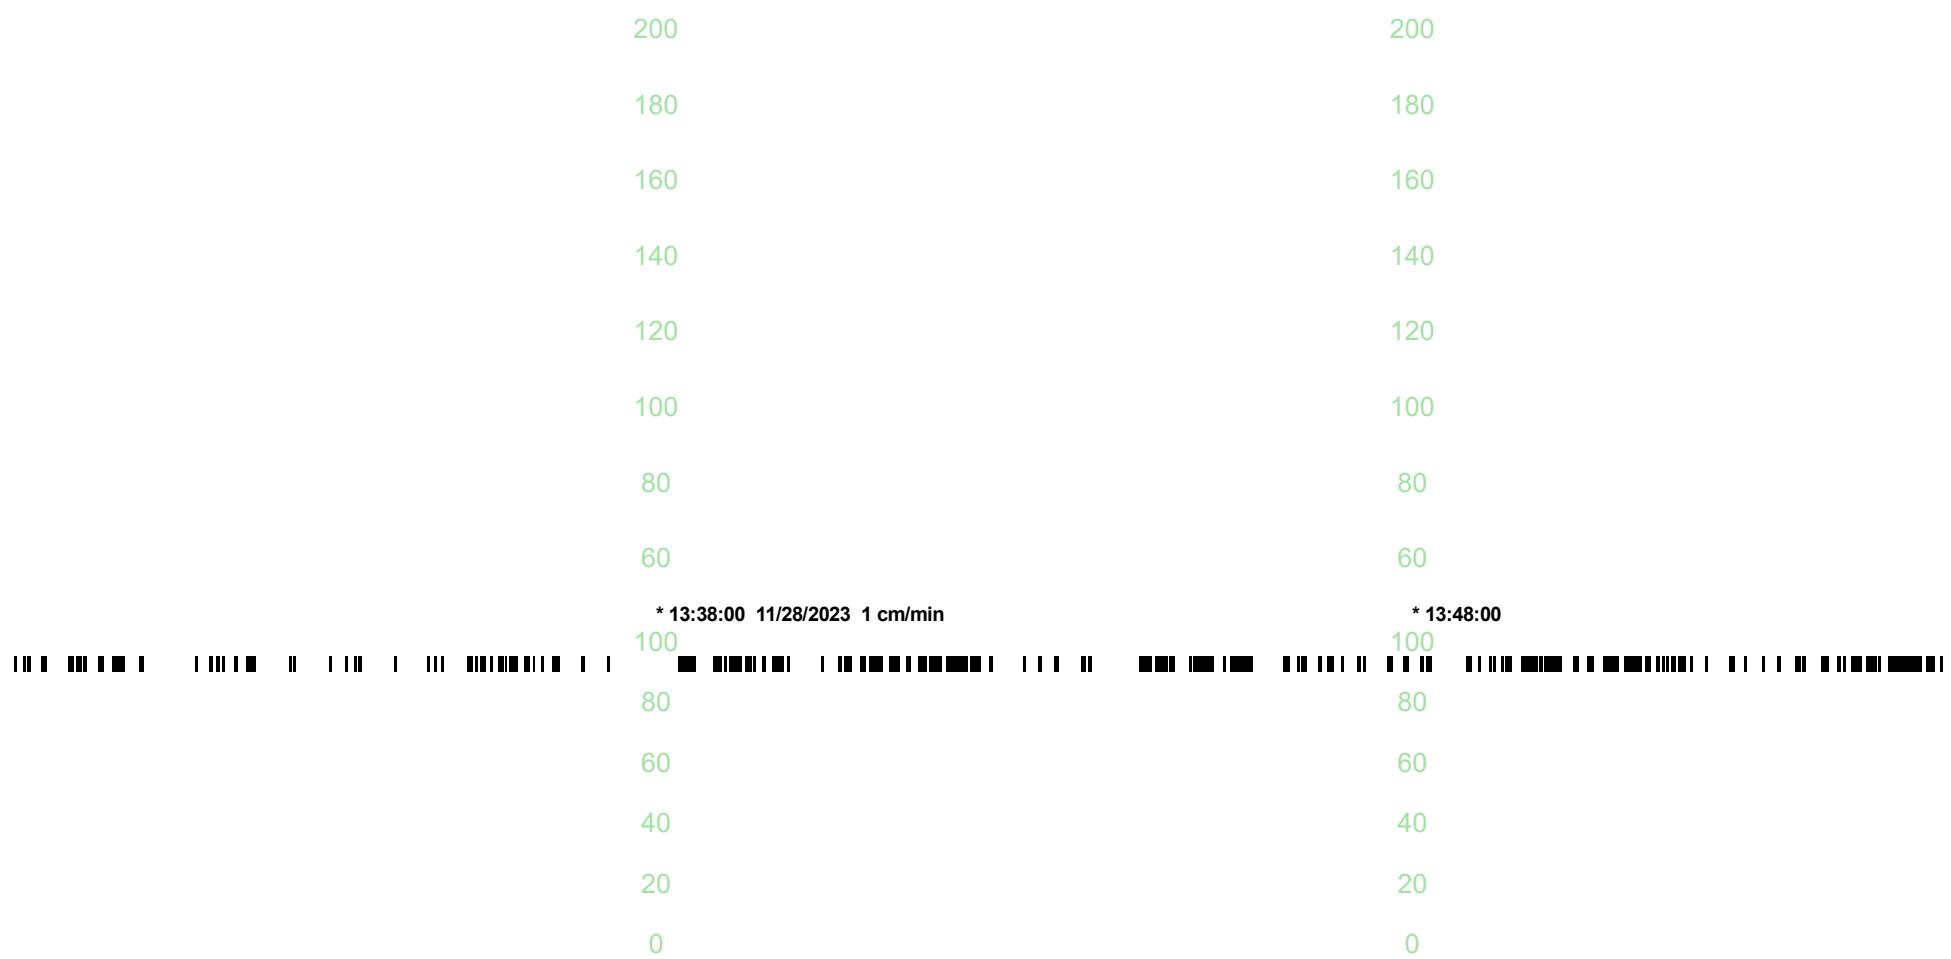

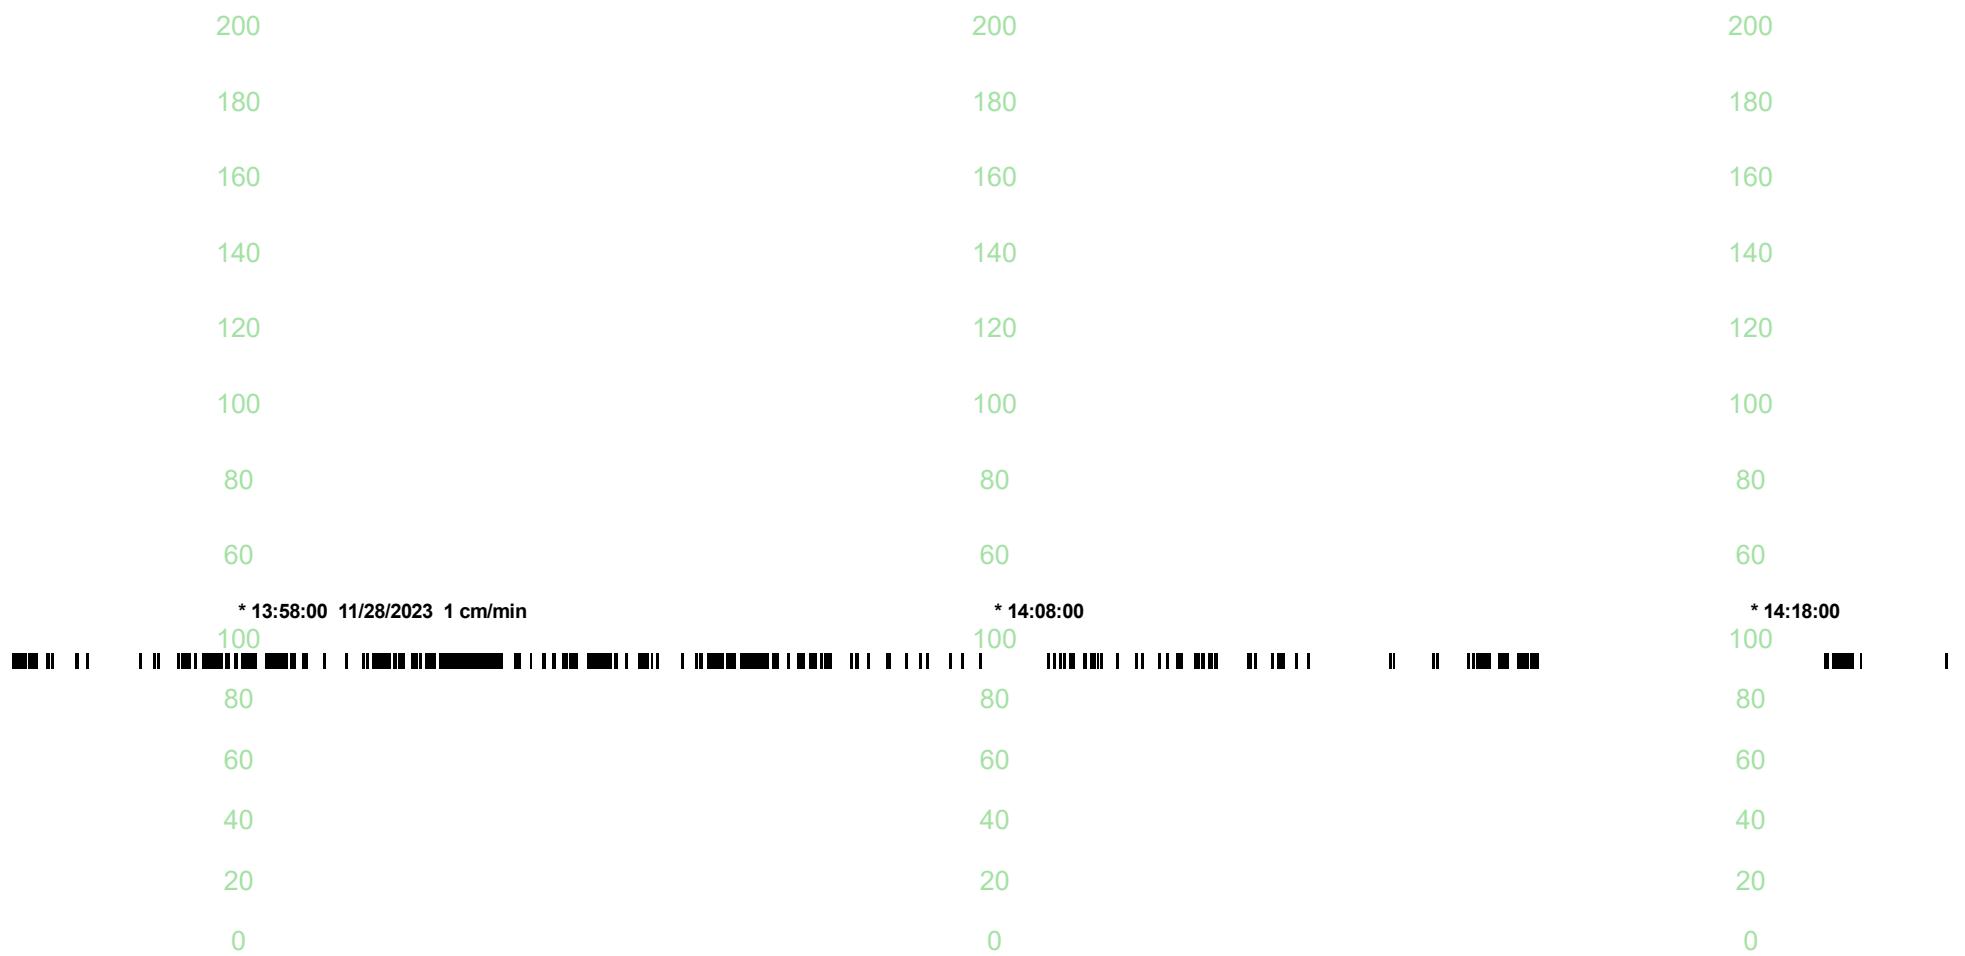


Estado de coincidencia: Activado  
\* COINCIDENCIA  
Alarma con acuse de recibo

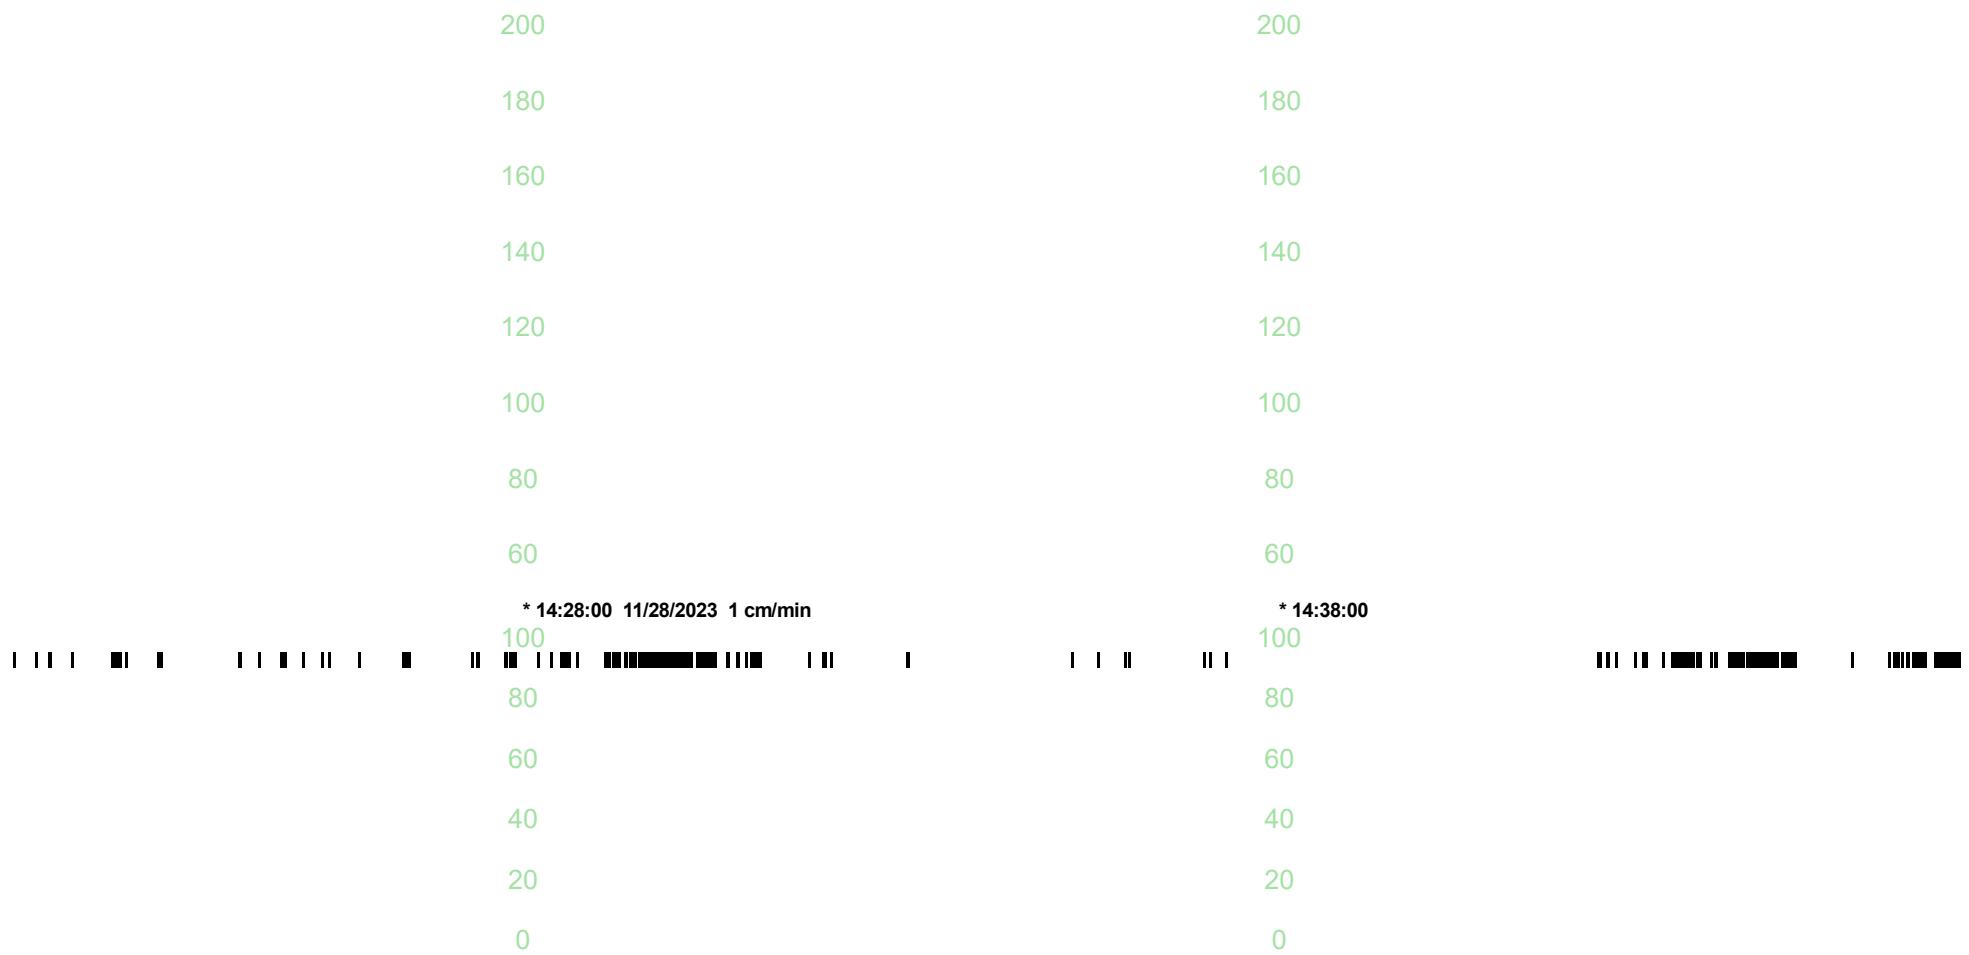



Modo Toco: no transductor  
Estado del monitor: Desactivado  
Traslado: 'Pari-1' a 'Dila-3'


Estado del monitor: Activado  
ID del Monitor: M2703A  
Estado del registrador: Desactivado  
Estado de la telemetría: Activado  
Modo FCF1: no transductor  
Modo FCF2: no transductor  
Modo FCF3: no transductor  
Modo FCM: no transductor  
Modo Toco: no transductor  
Modo FCF1: US  
Estado del FMP: Activado  
Modo Toco: externo  
Estado del registrador: Activado  
AJUSTES DE ALARMAS PARA  
PACIENTE

Estado del registrador: Desactivado  
Estado del registrador: Activado

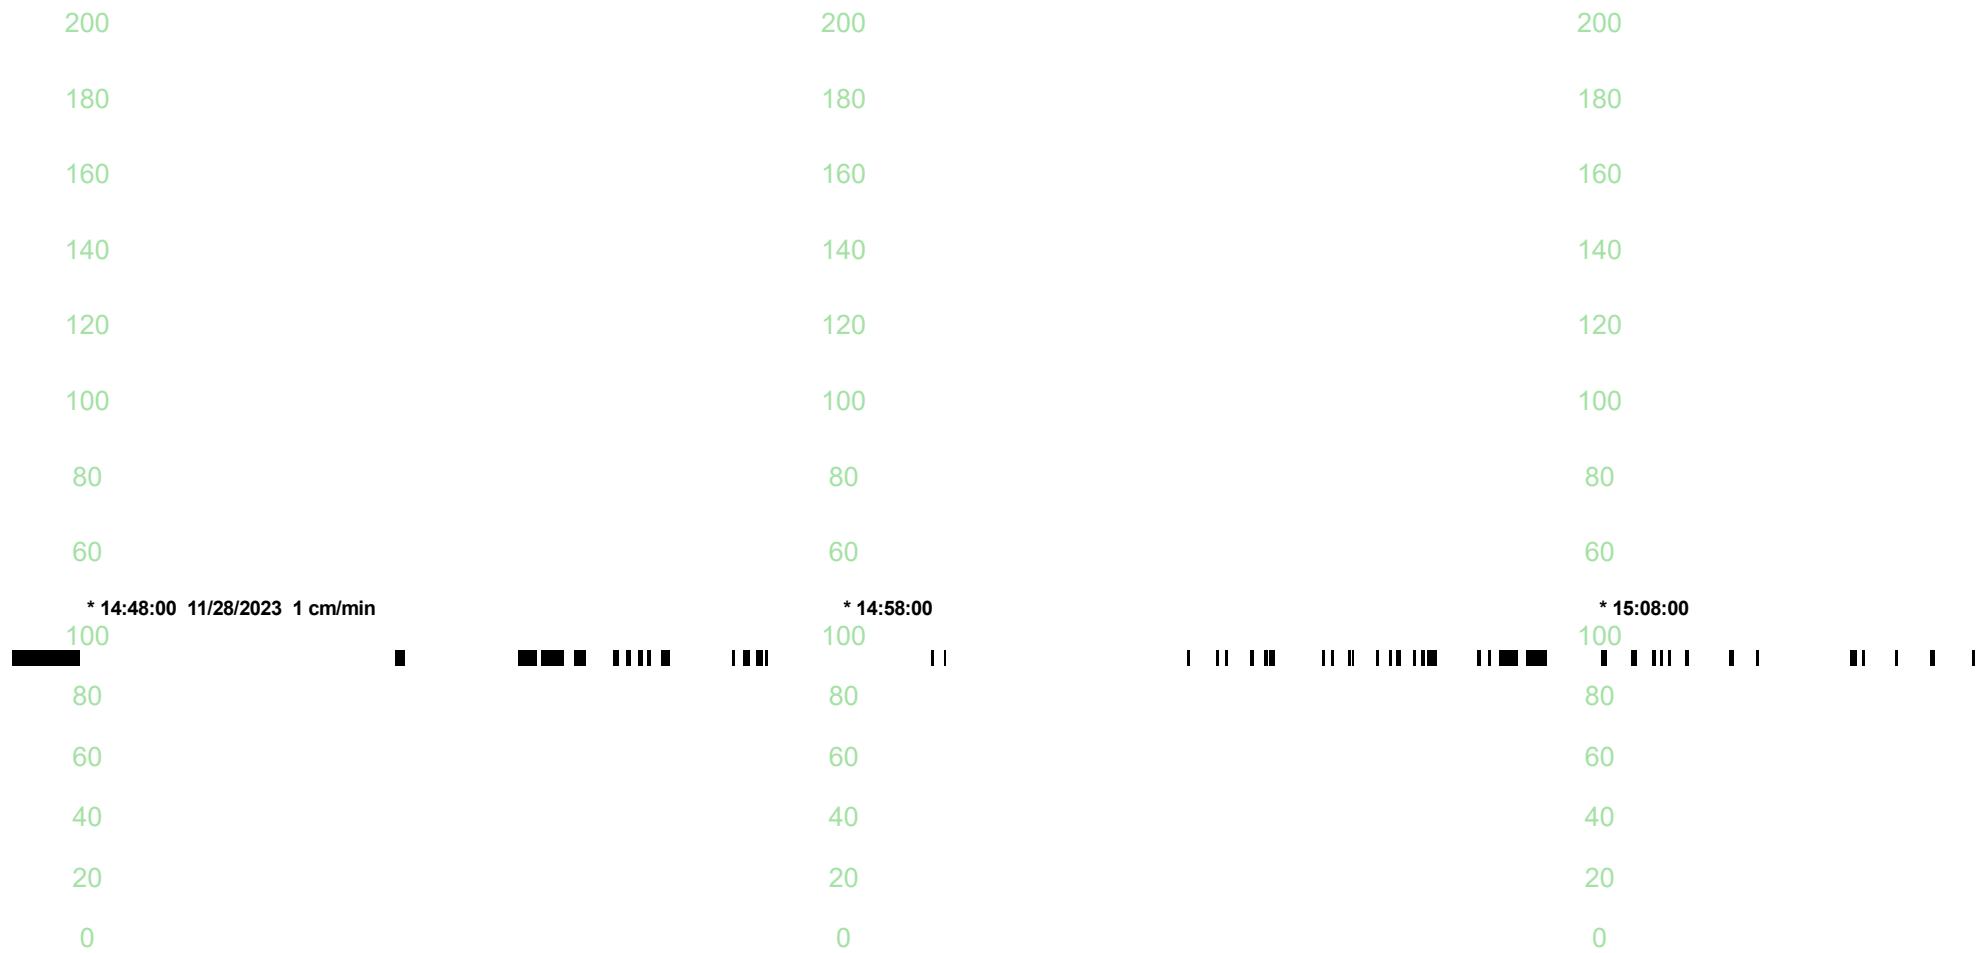


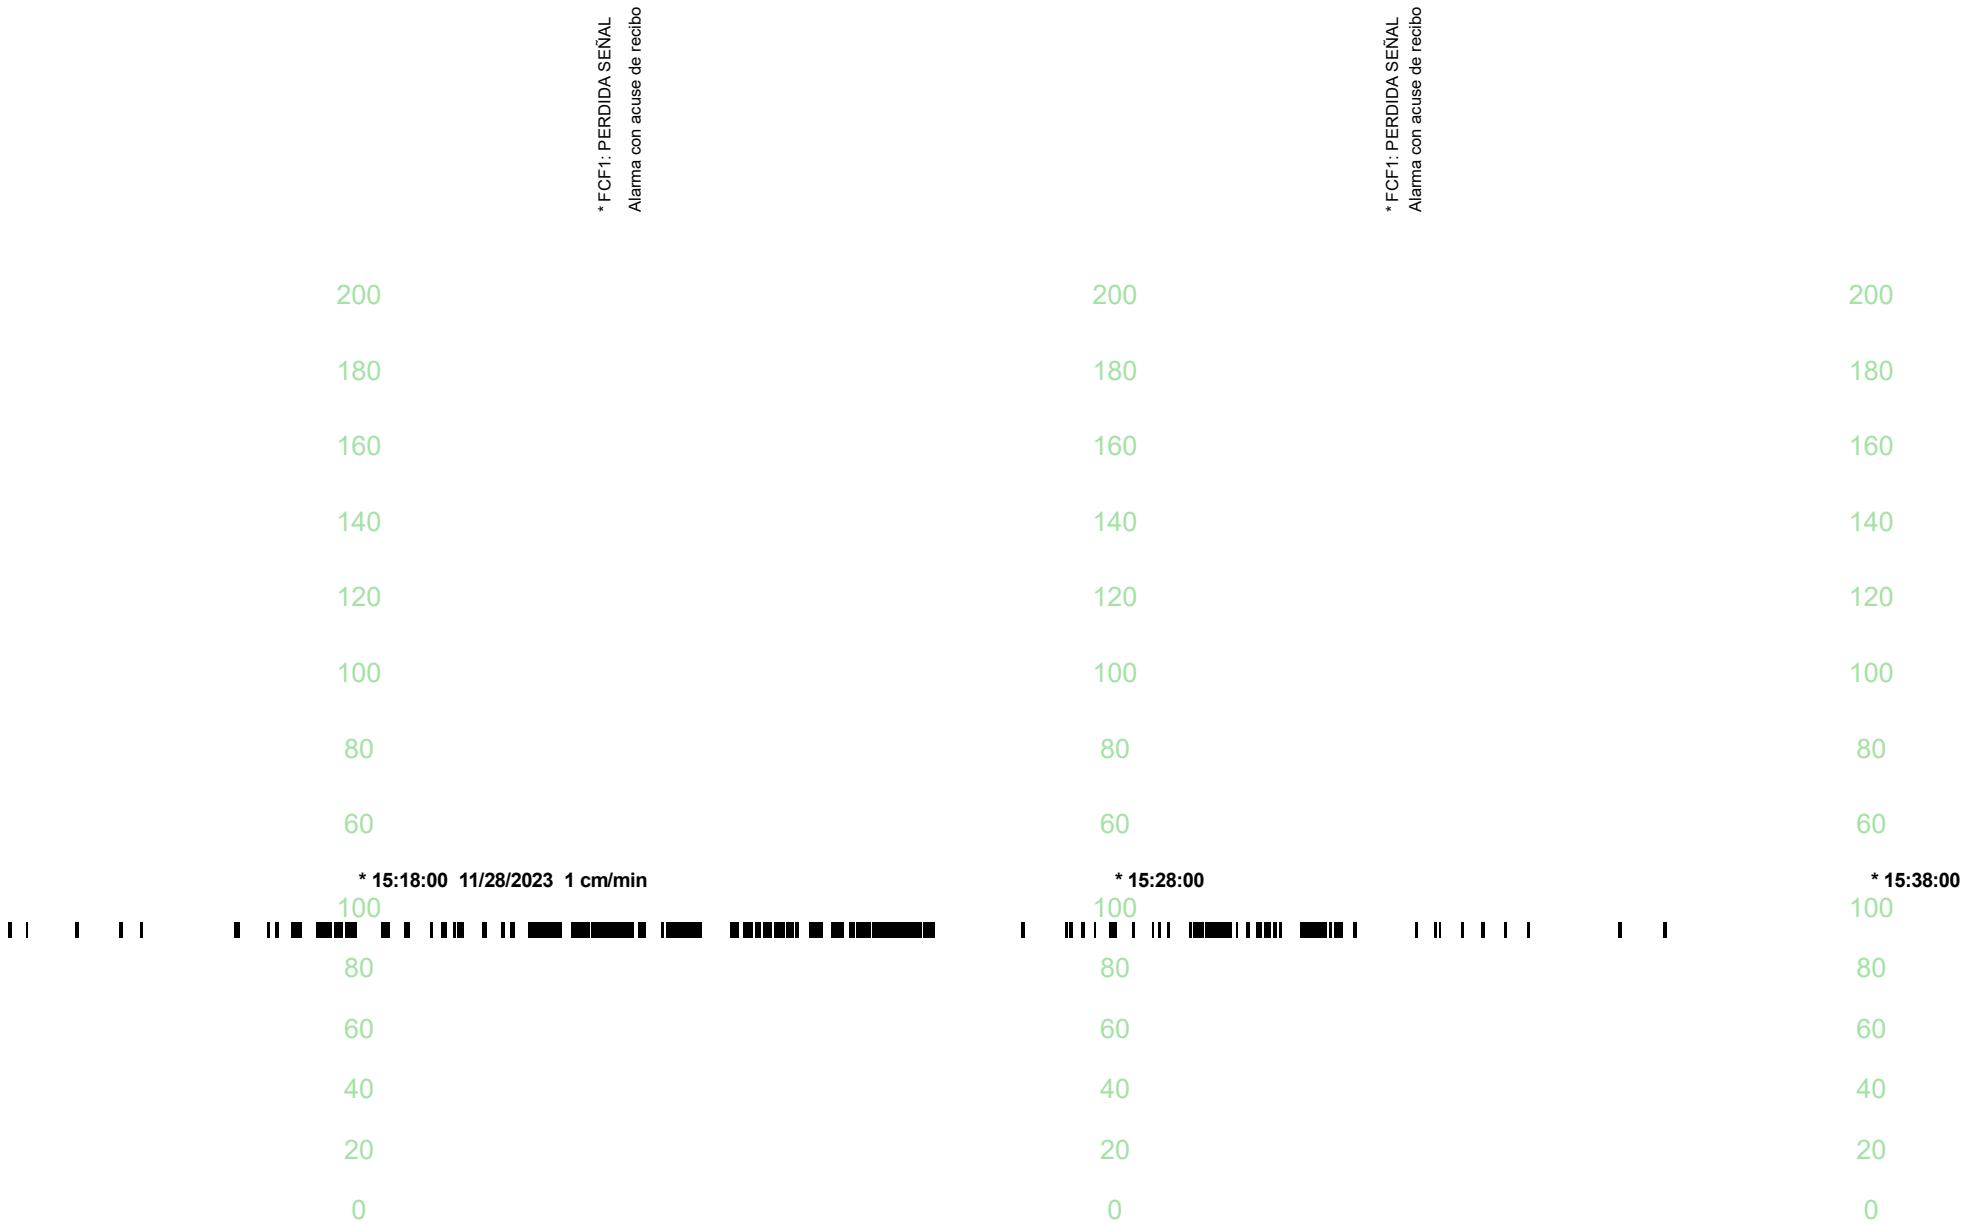



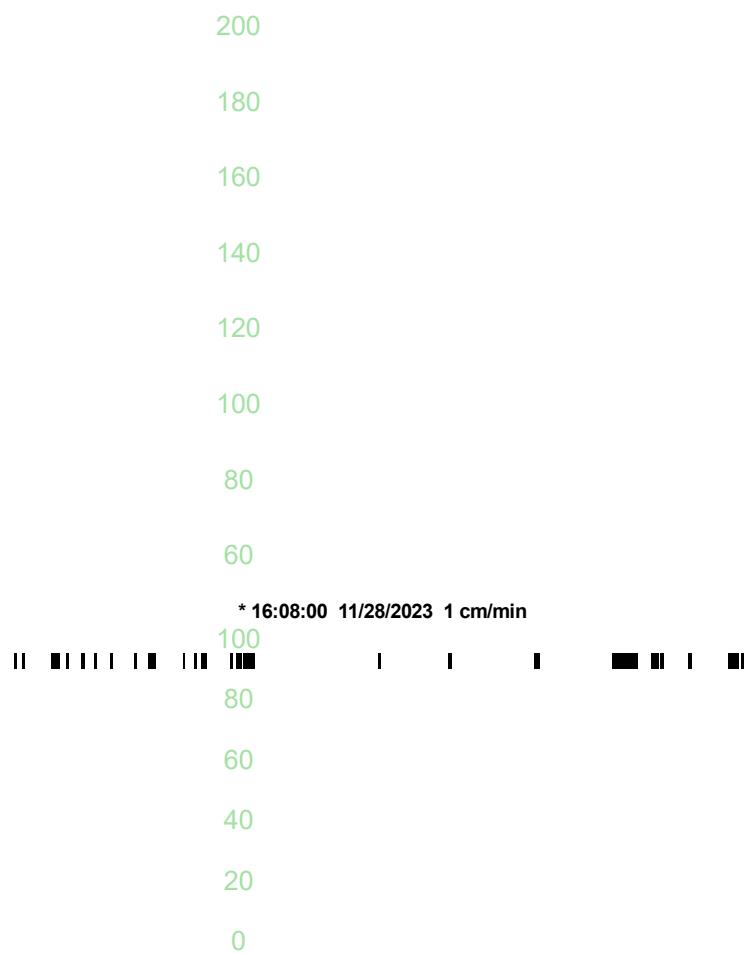


\* FCF1: PERDIDA SEÑAL.  
Alarma con acuse de recibo

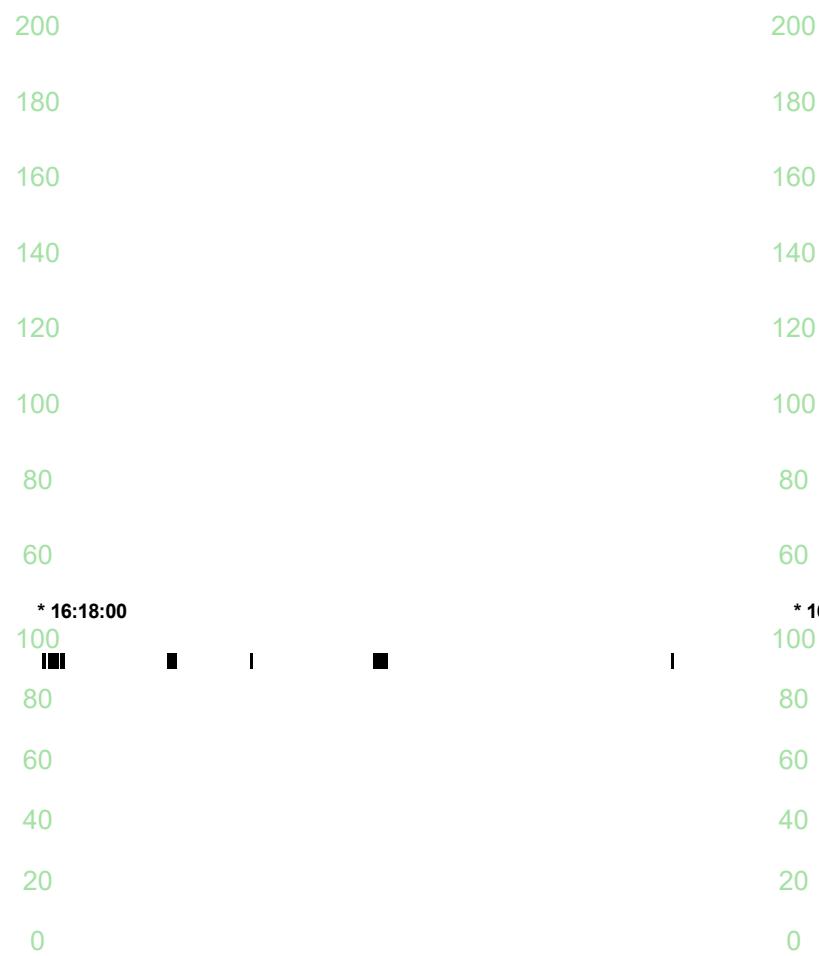



\* FCF1: PERDIDA SEÑAL.  
Alarma con acuse de recibo


\*\* FCF1: PERDIDA SEÑAL.  
Alarma con acuse de recibo



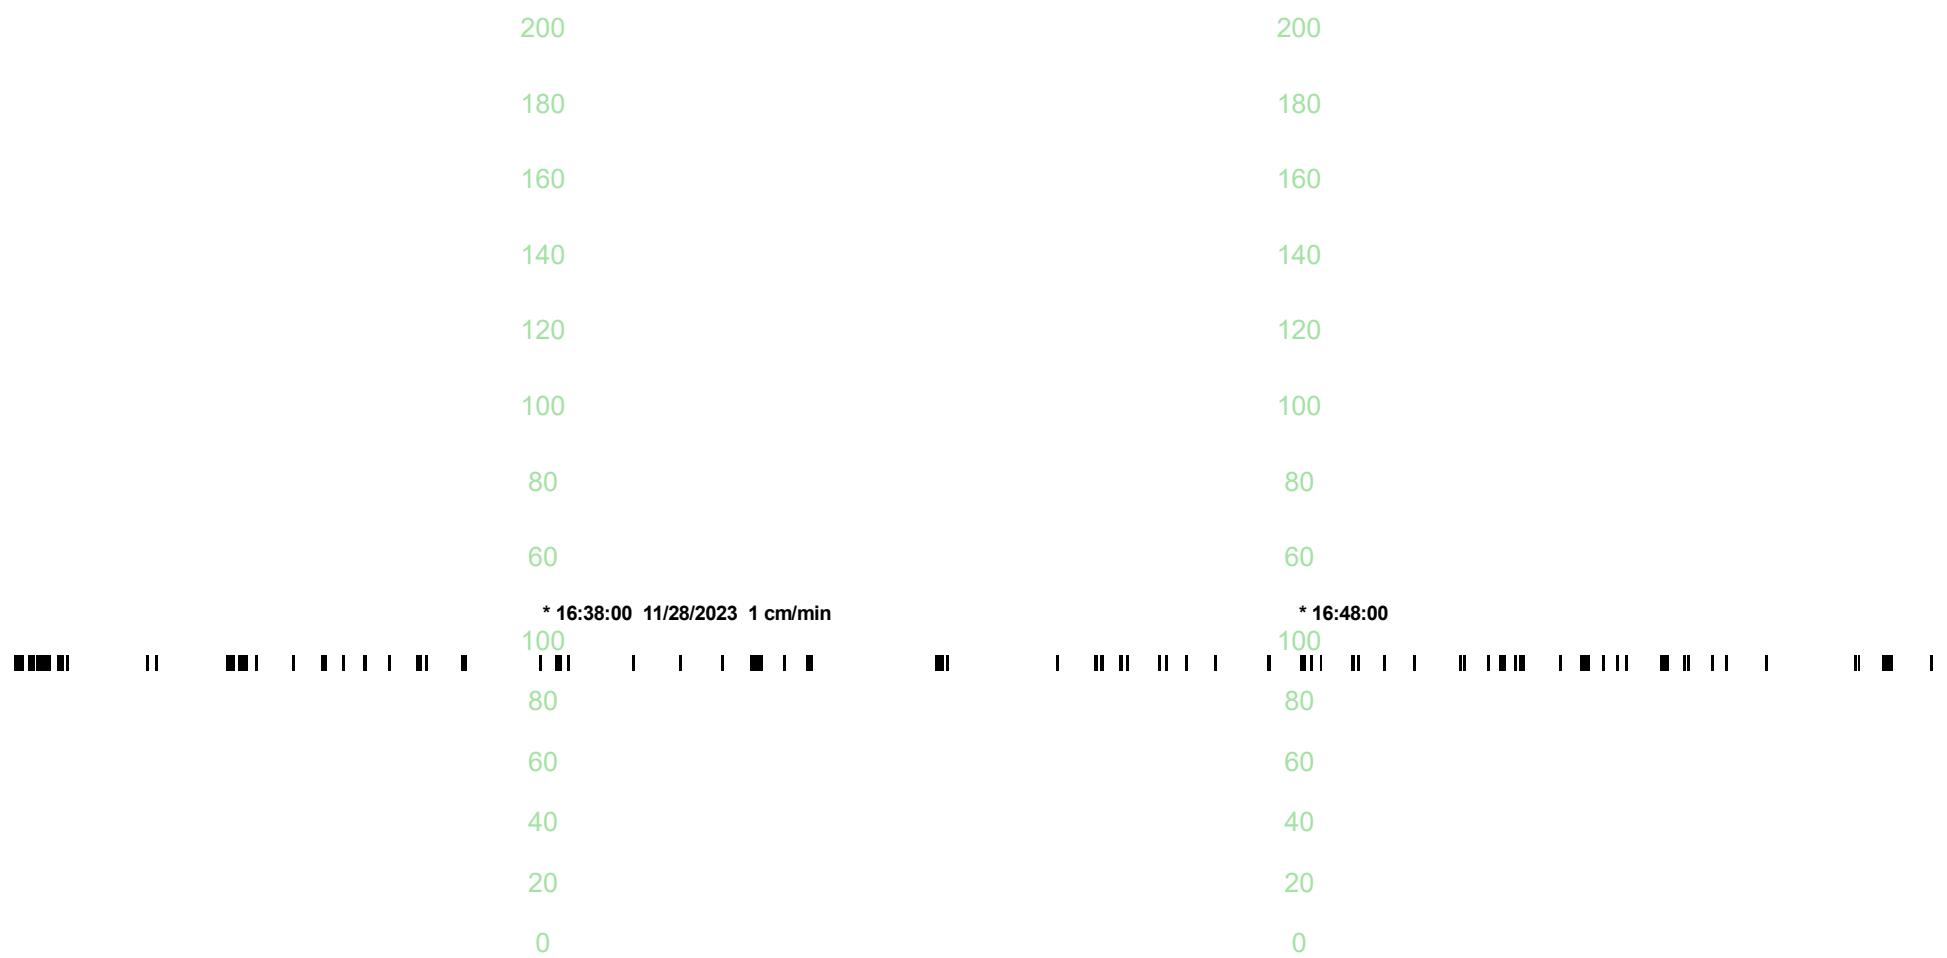


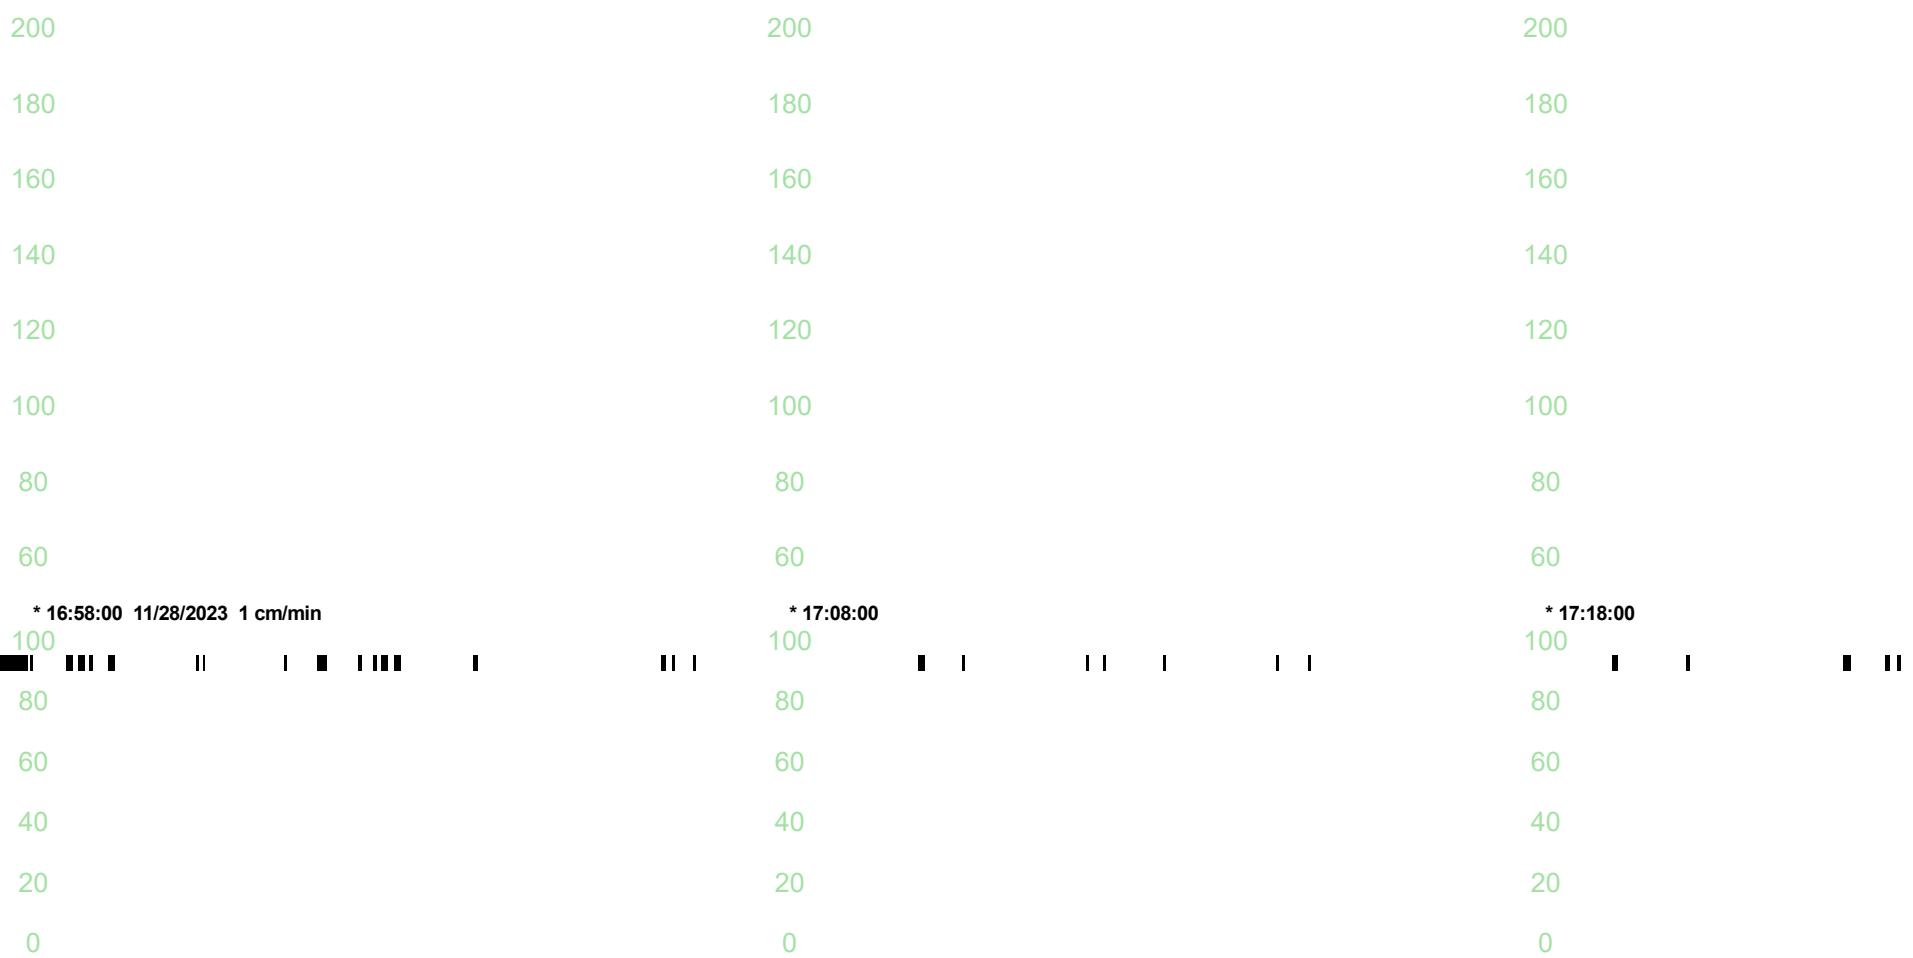

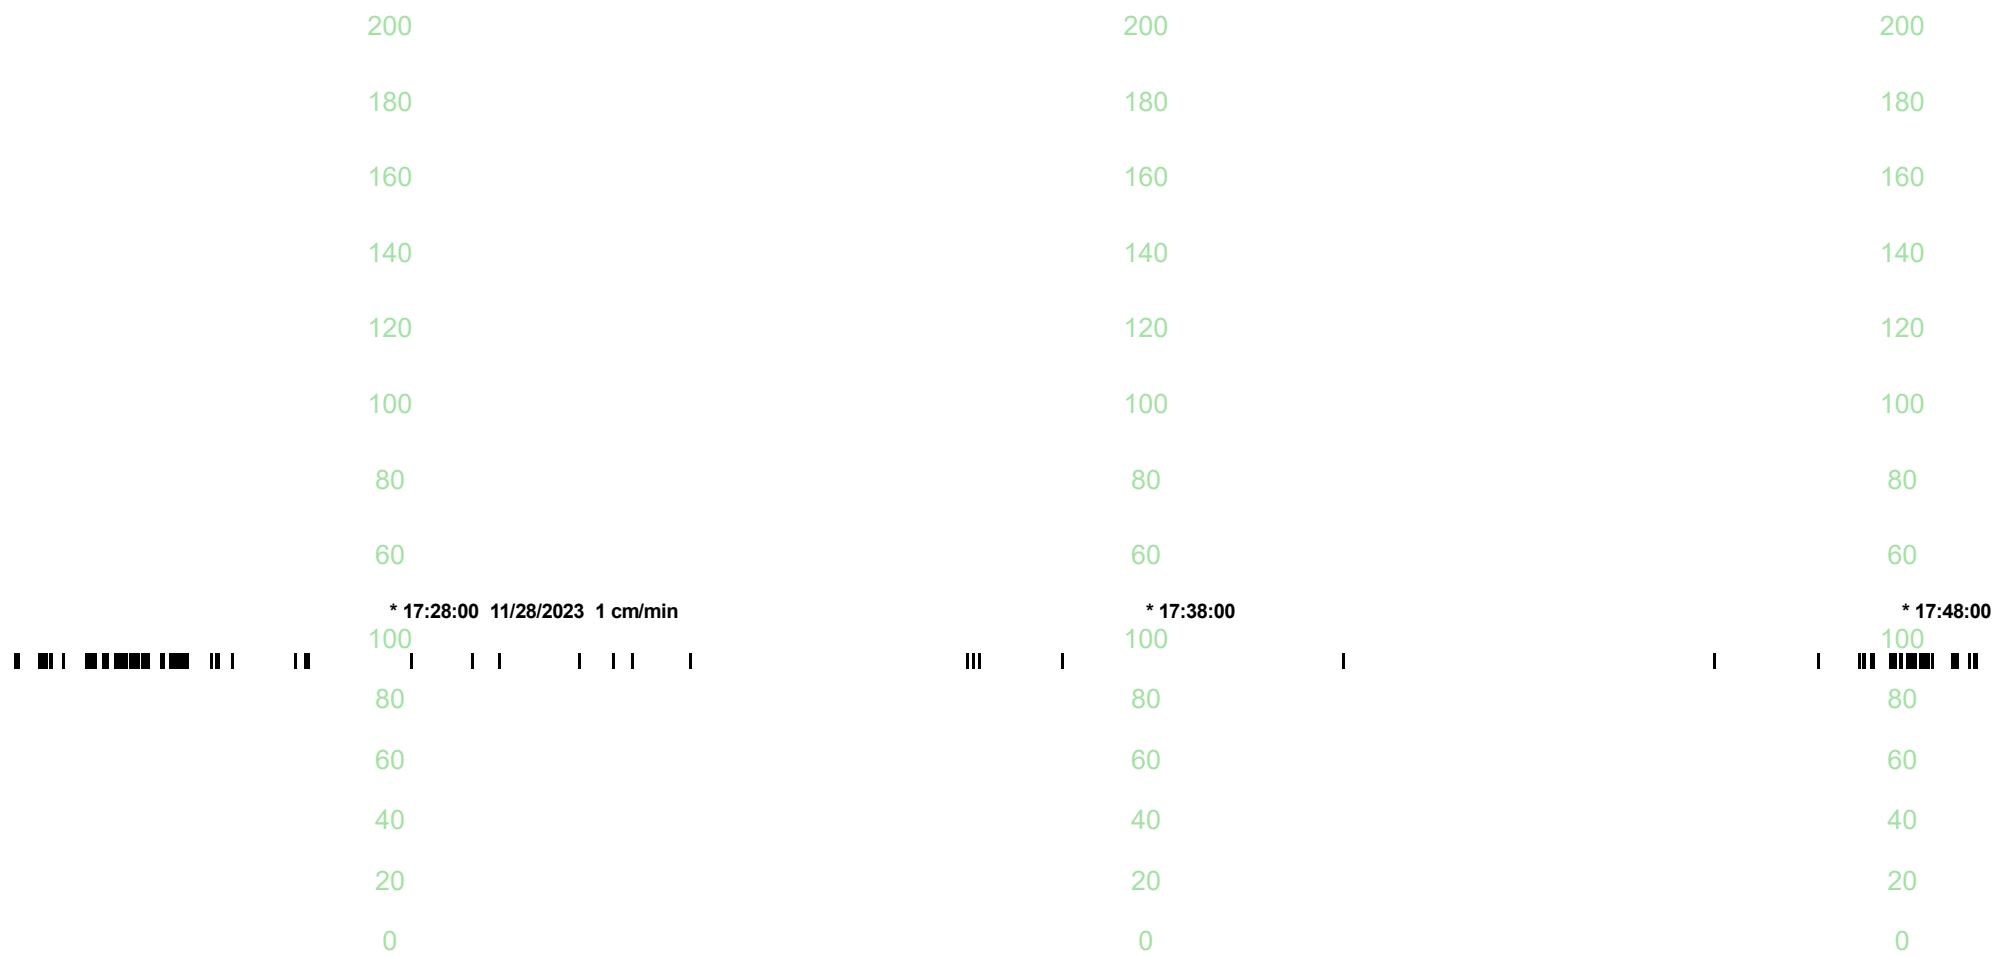


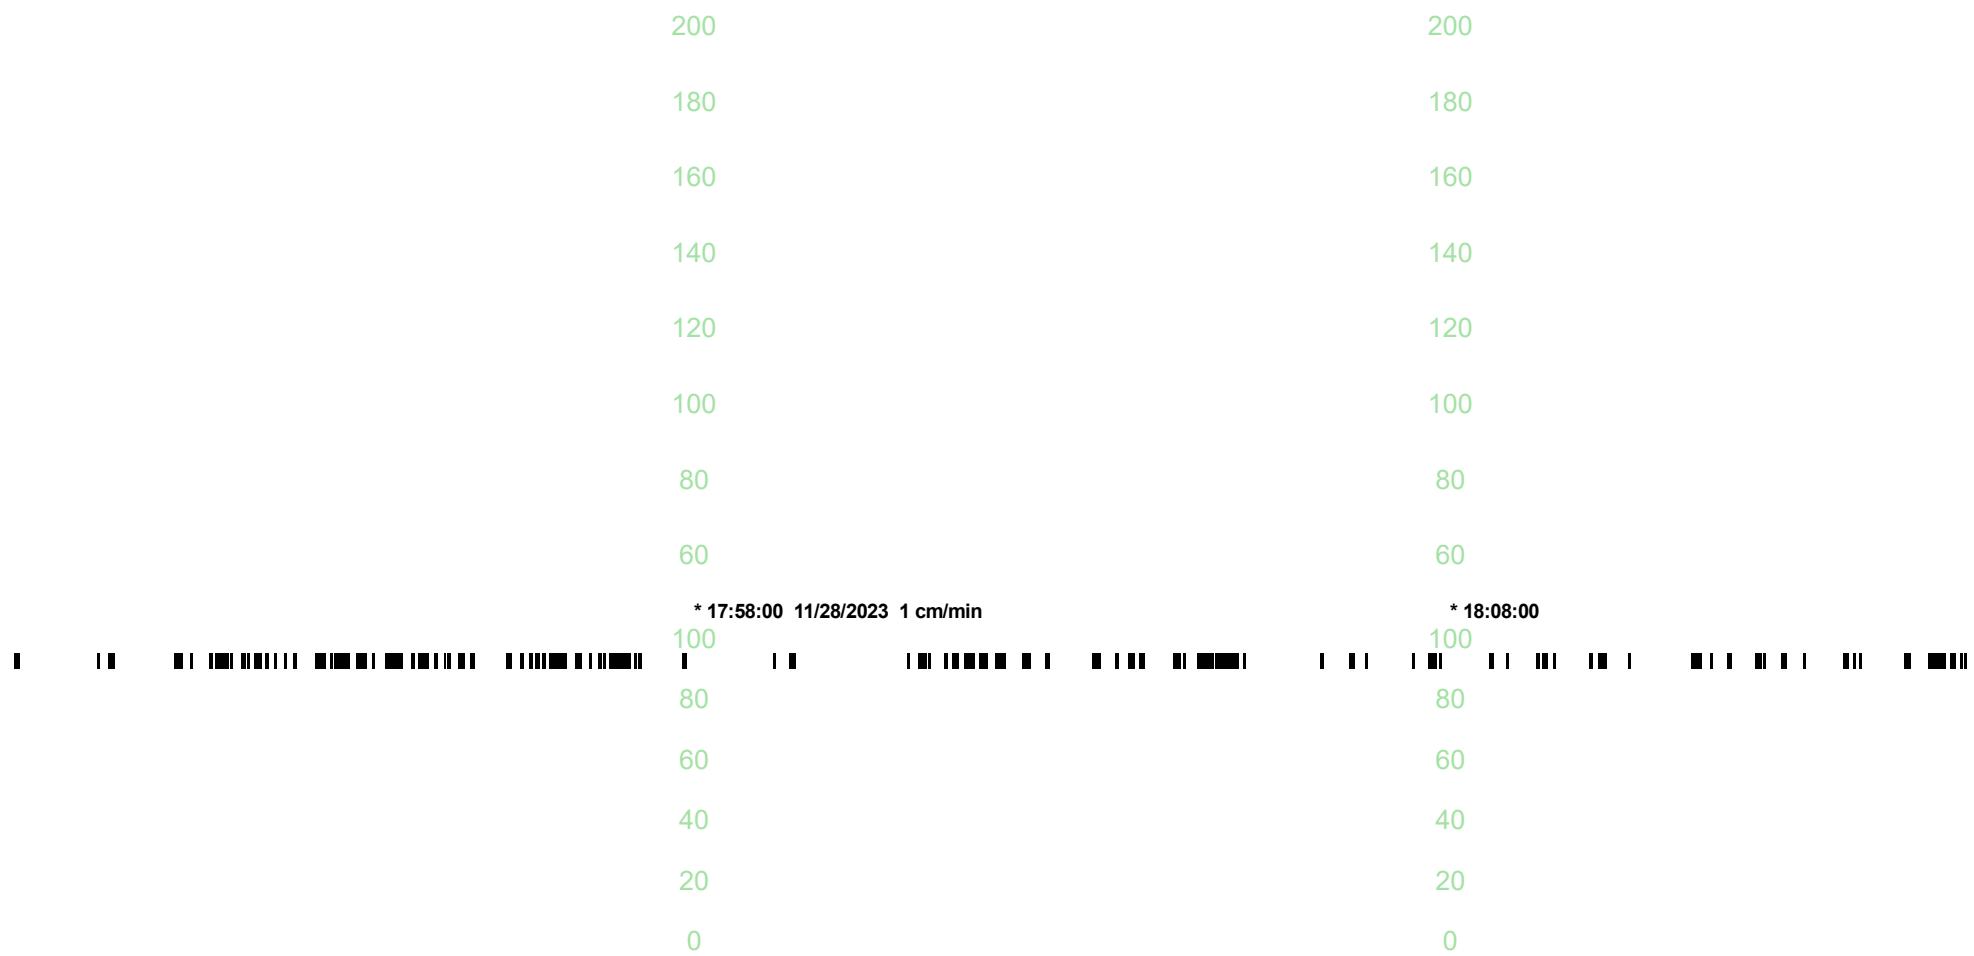


Estado del monitor: Desactivado

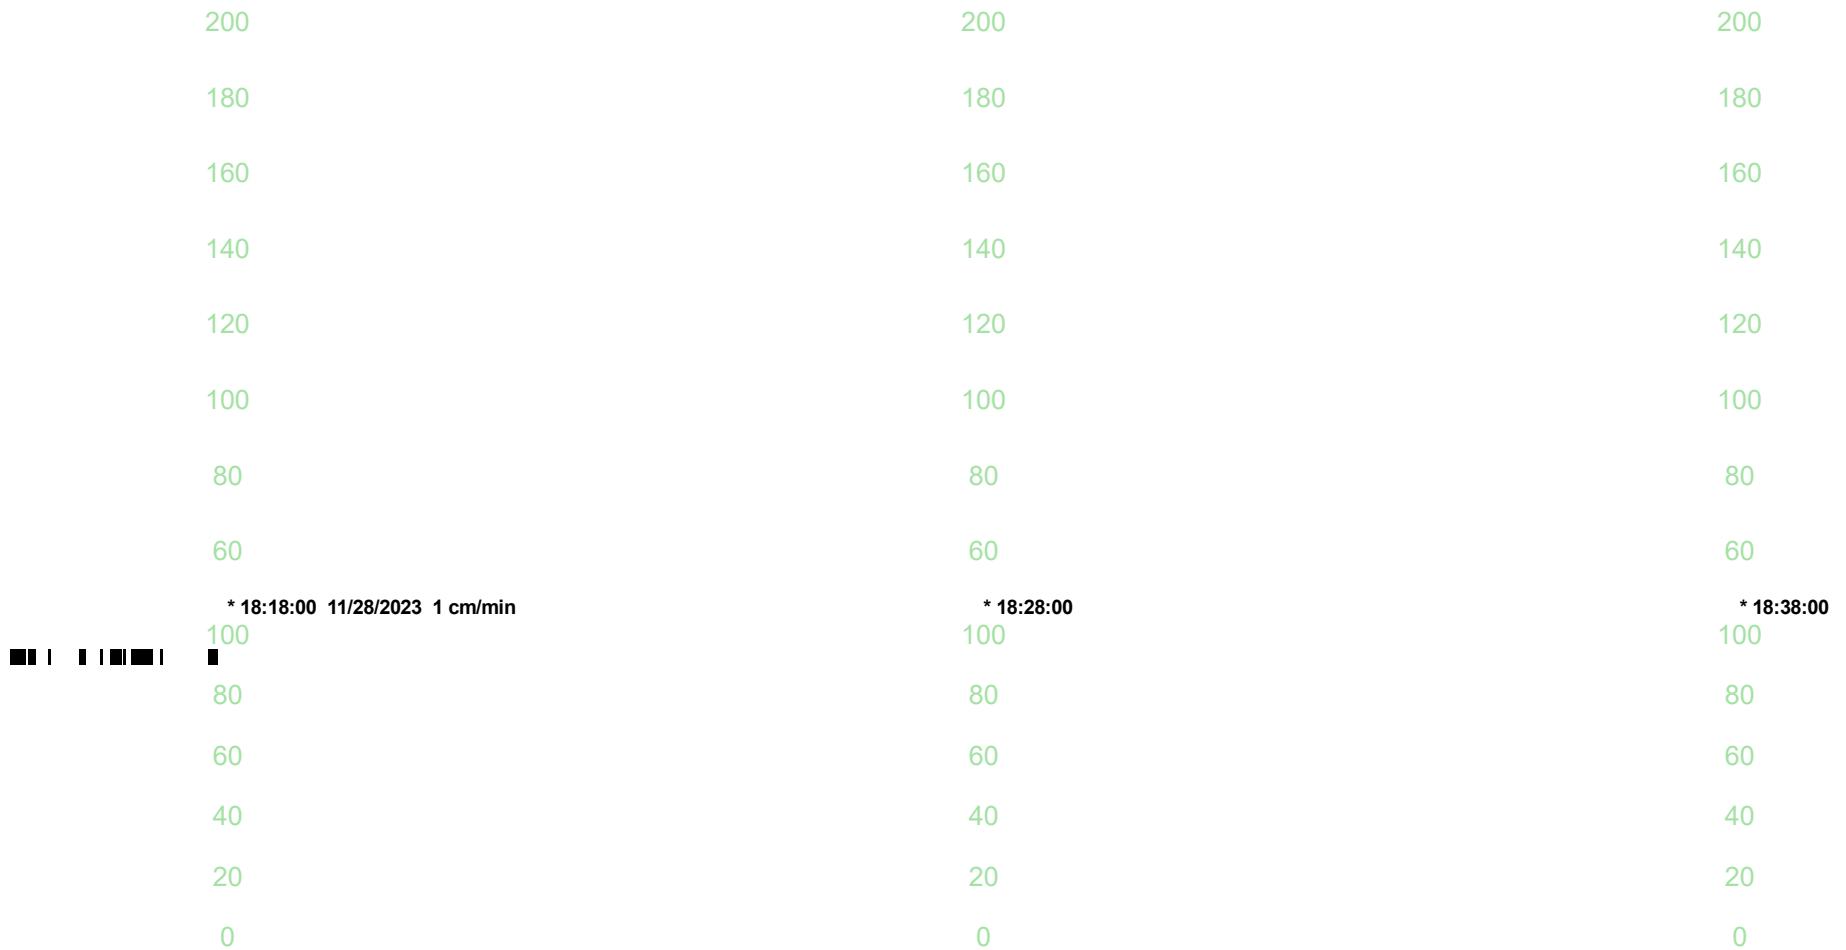


Estado del monitor: Activado  
ID del Monitor: M2703A  
Estado del registrador: Desactivado  
Modo FCF1: no transductor  
Modo FCF2: no transductor  
Modo FCF3: no transductor  
Modo FCM: no transductor  
Modo Toco: no transductor  
Estado de la telemetría: Activado  
Modo Toco: externo  
Modo FCF1: US  
Estado del FMP: Activado  
AJUSTES DE ALARMAS PARA  
PACIENTE  
Estado del registrador: Activado

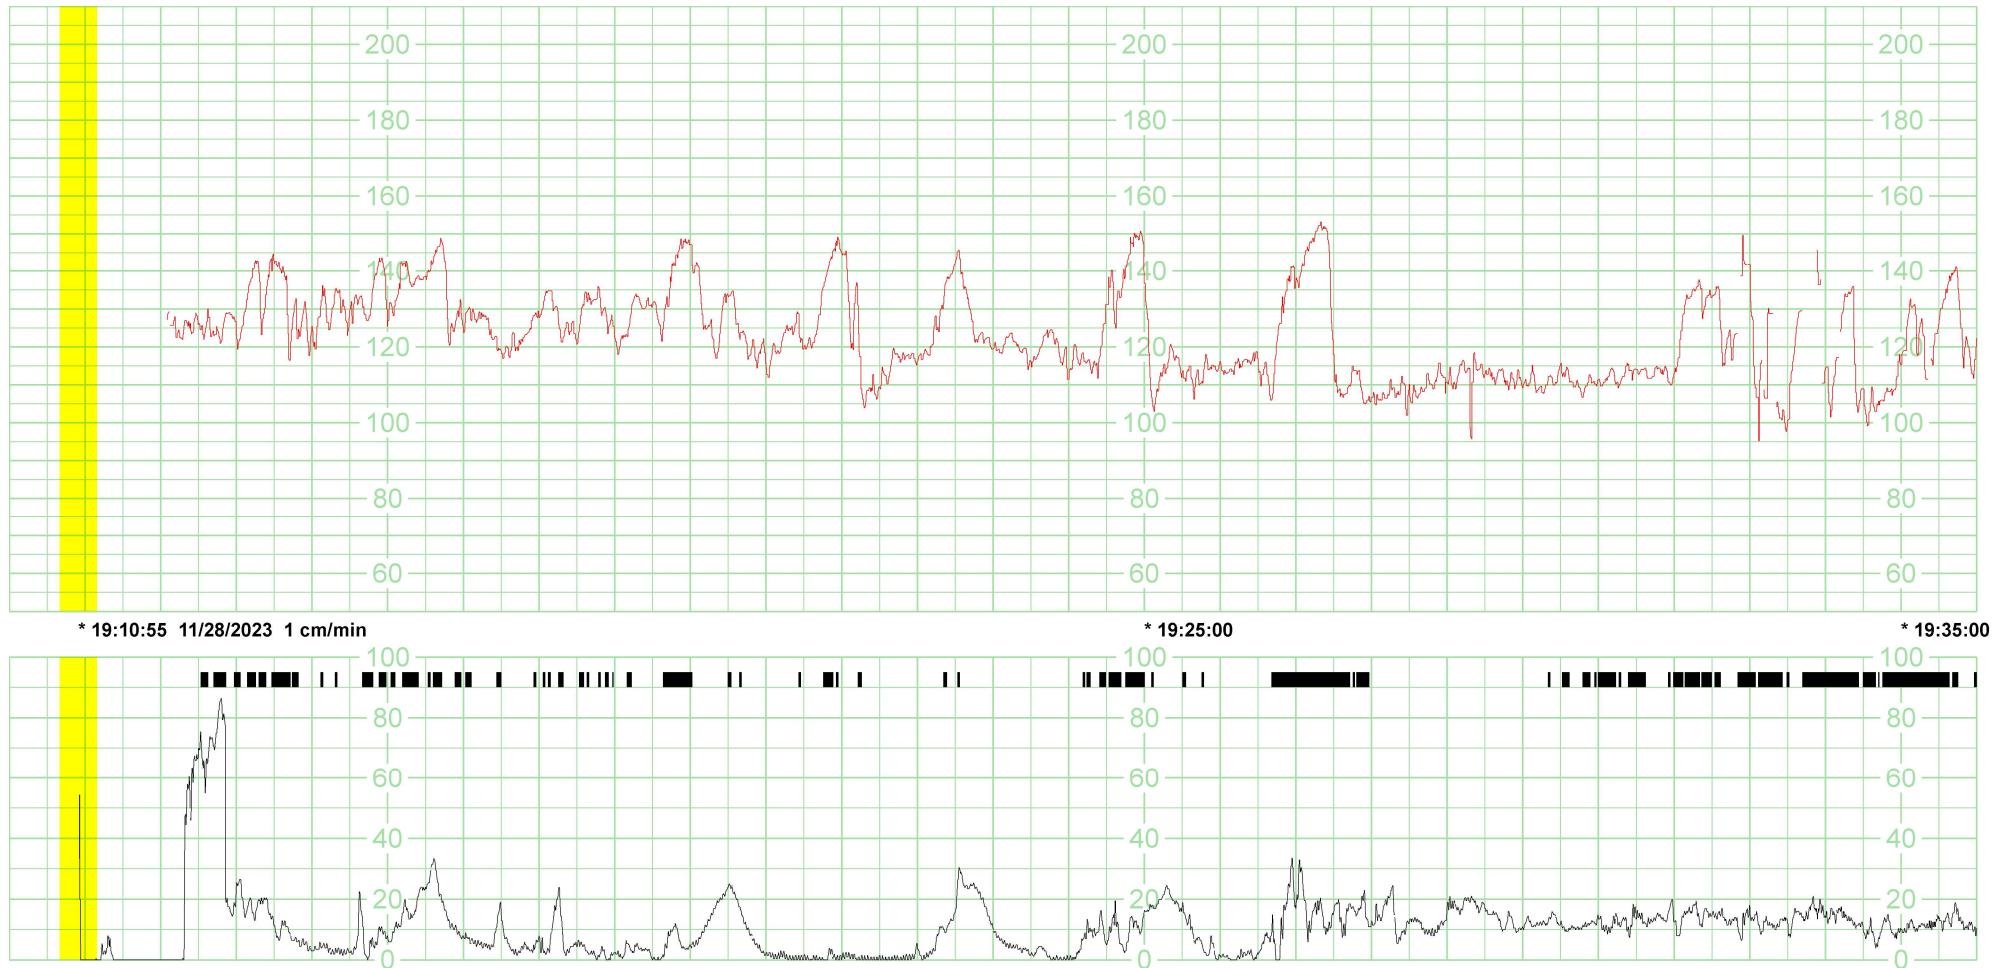

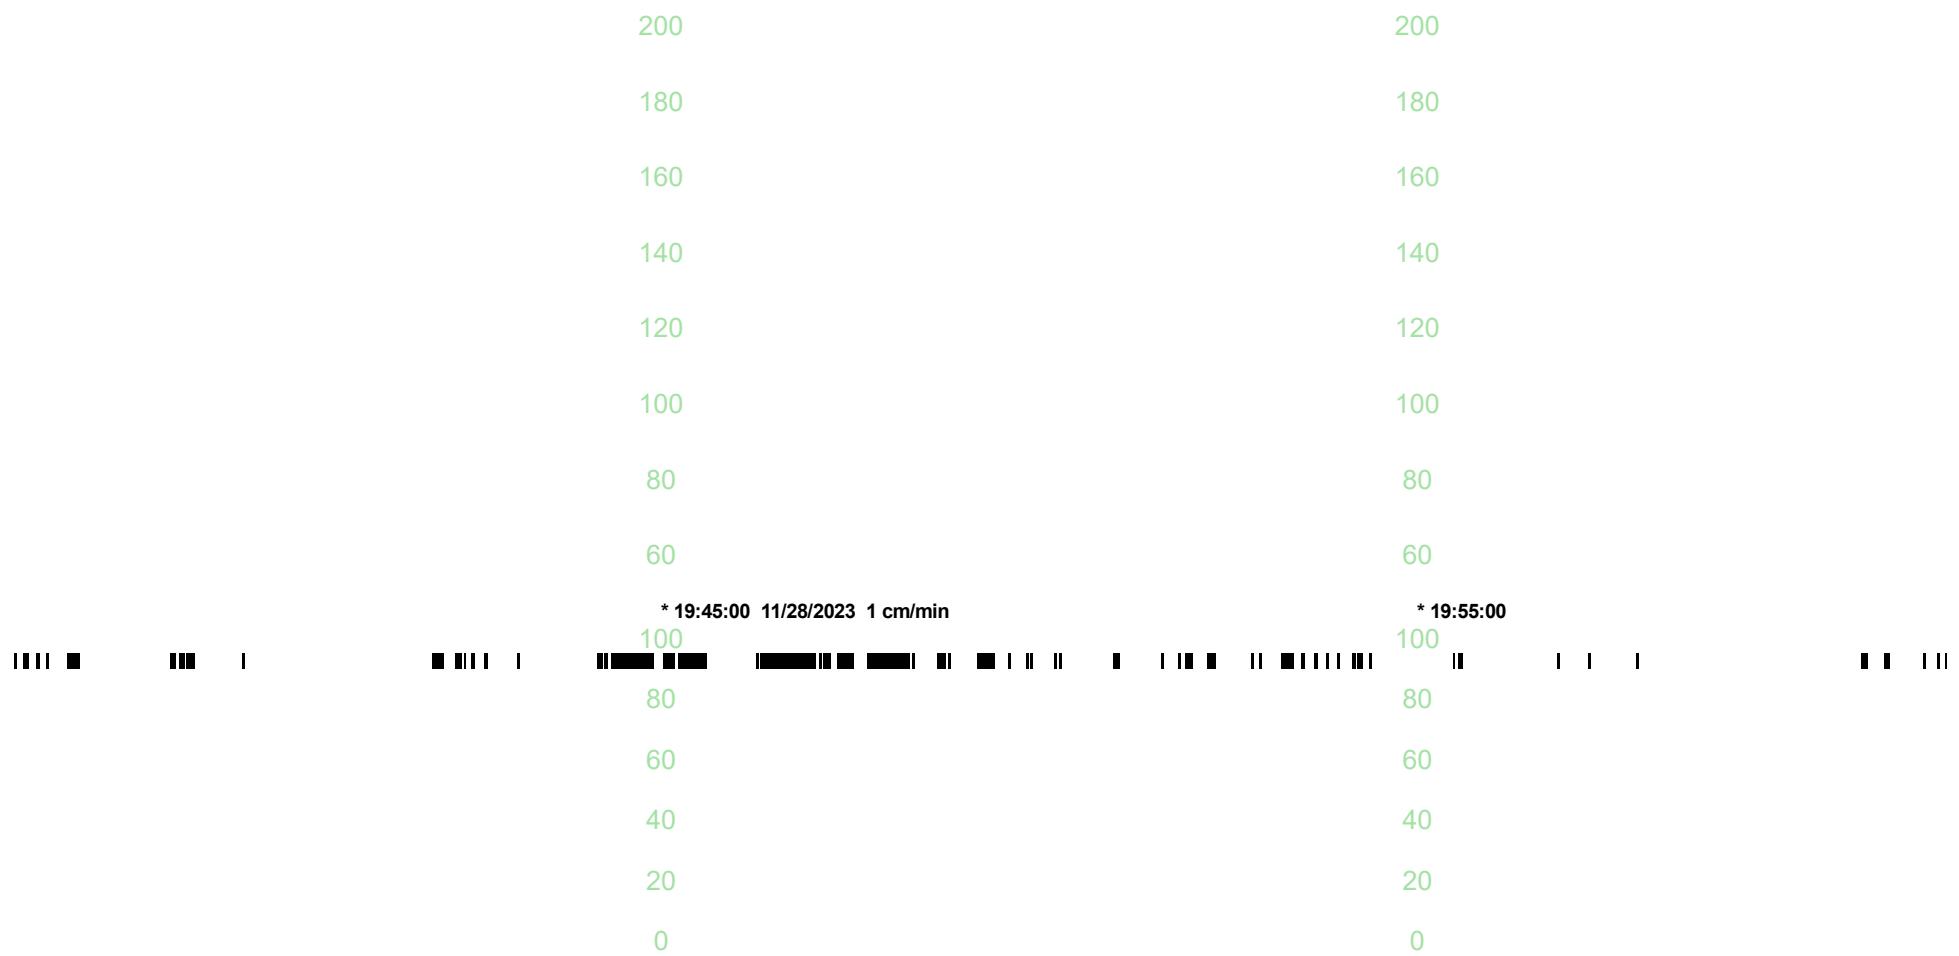

Estado del monitor: En espera  
Modo FCF: no transductor  
Modo Toco: no transductor  
Estado del registrador: Desactivado  
Estado de la telemetría: Desactivado

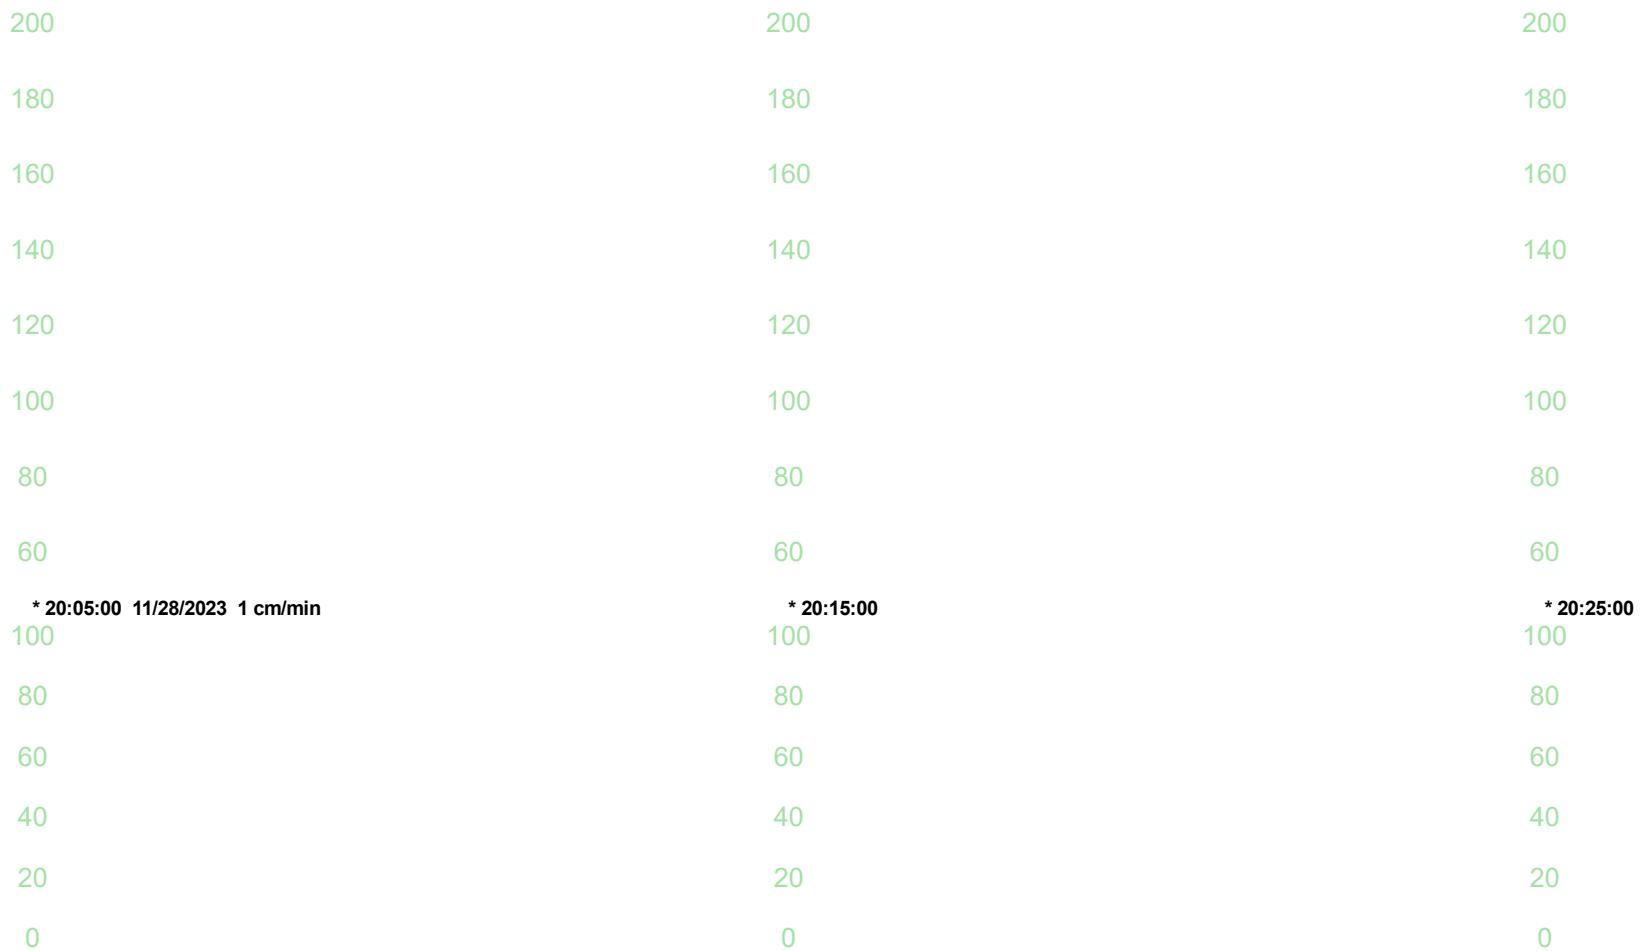


Estado del monitor: Activado  
Estado de la telemetría: Activado  
Estado del registrador: Activado  
Modo FCF1: US  
Estado del FMP: Activado  
Modo Toco: externo

\*FCF1: BRADICARDIA


Alarma con acuse de recibo


Estado del monitor: Desactivado  
Estado del monitor: Activado  
ID del Monitor: M2703A

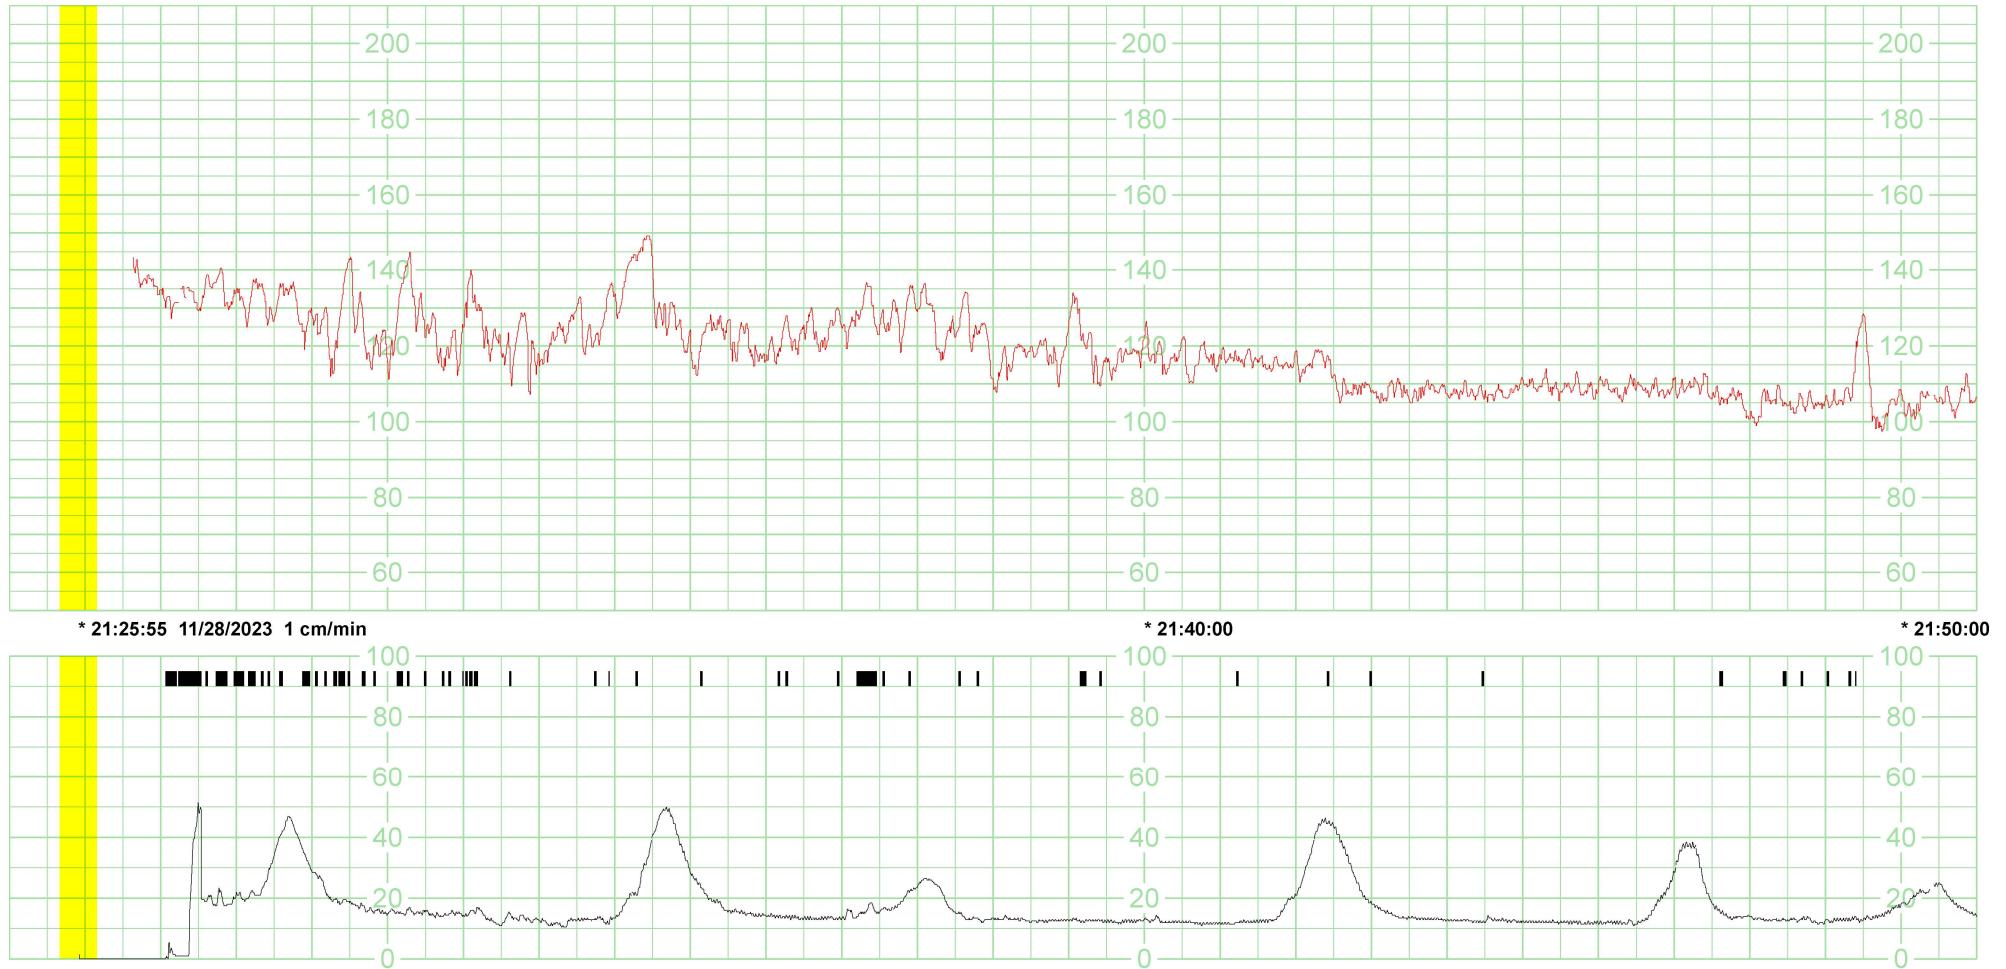


Estado del monitor: Desactivado  
Estado del monitor: Activado  
ID del Monitor: M2703A


\* FCF1:BRADICARDIA  
Alarma con acuse de recibo

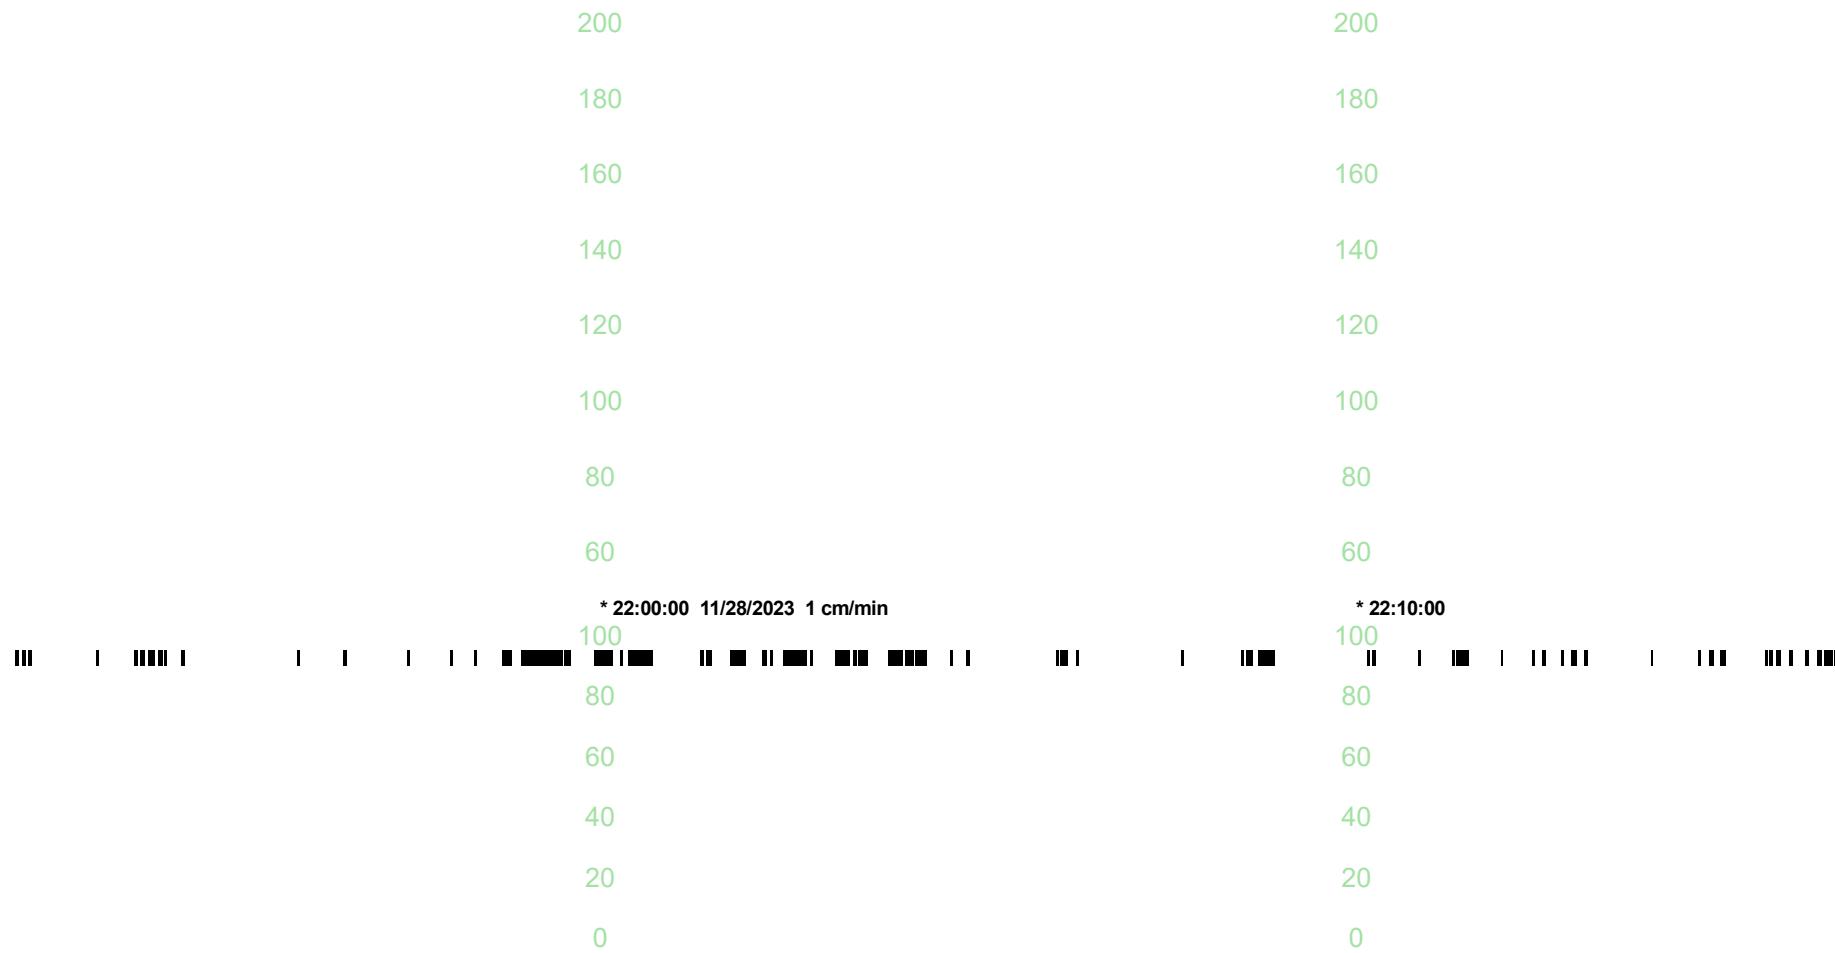

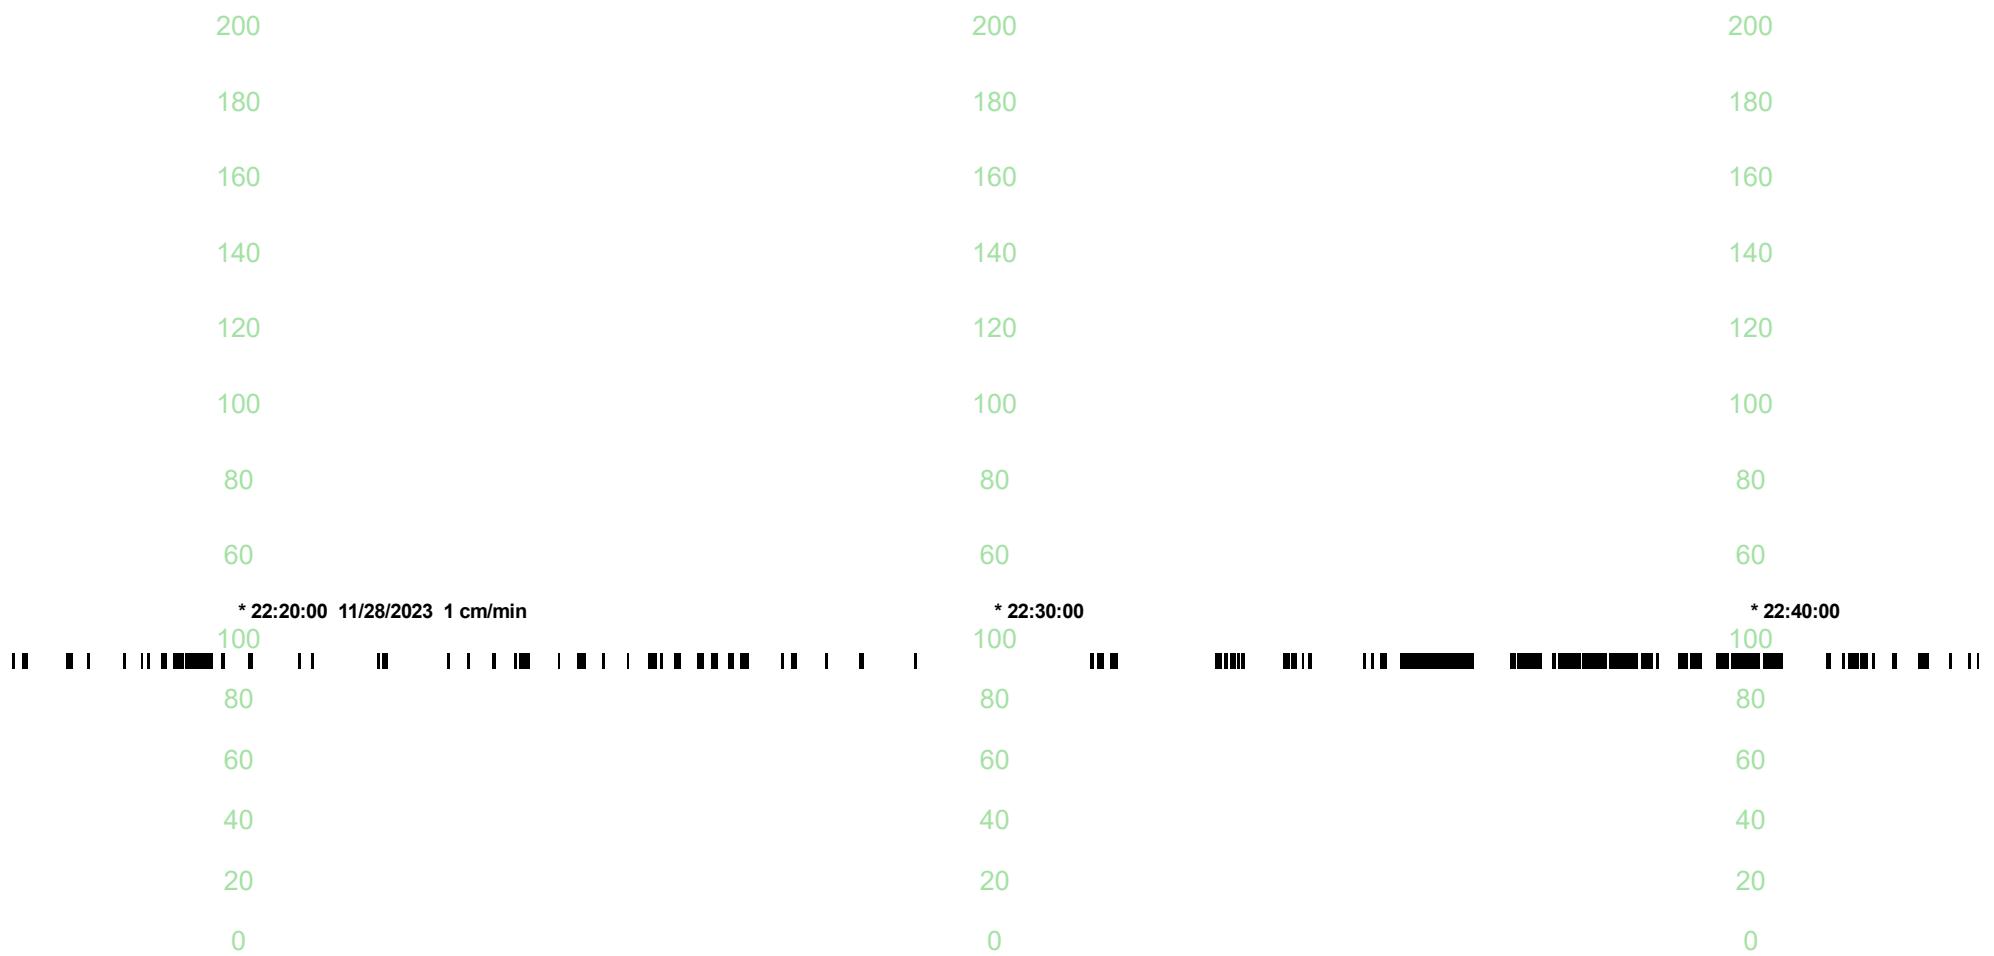



\*\* FCF1: BRADICARDIA  
Alarma con acuse de recibo

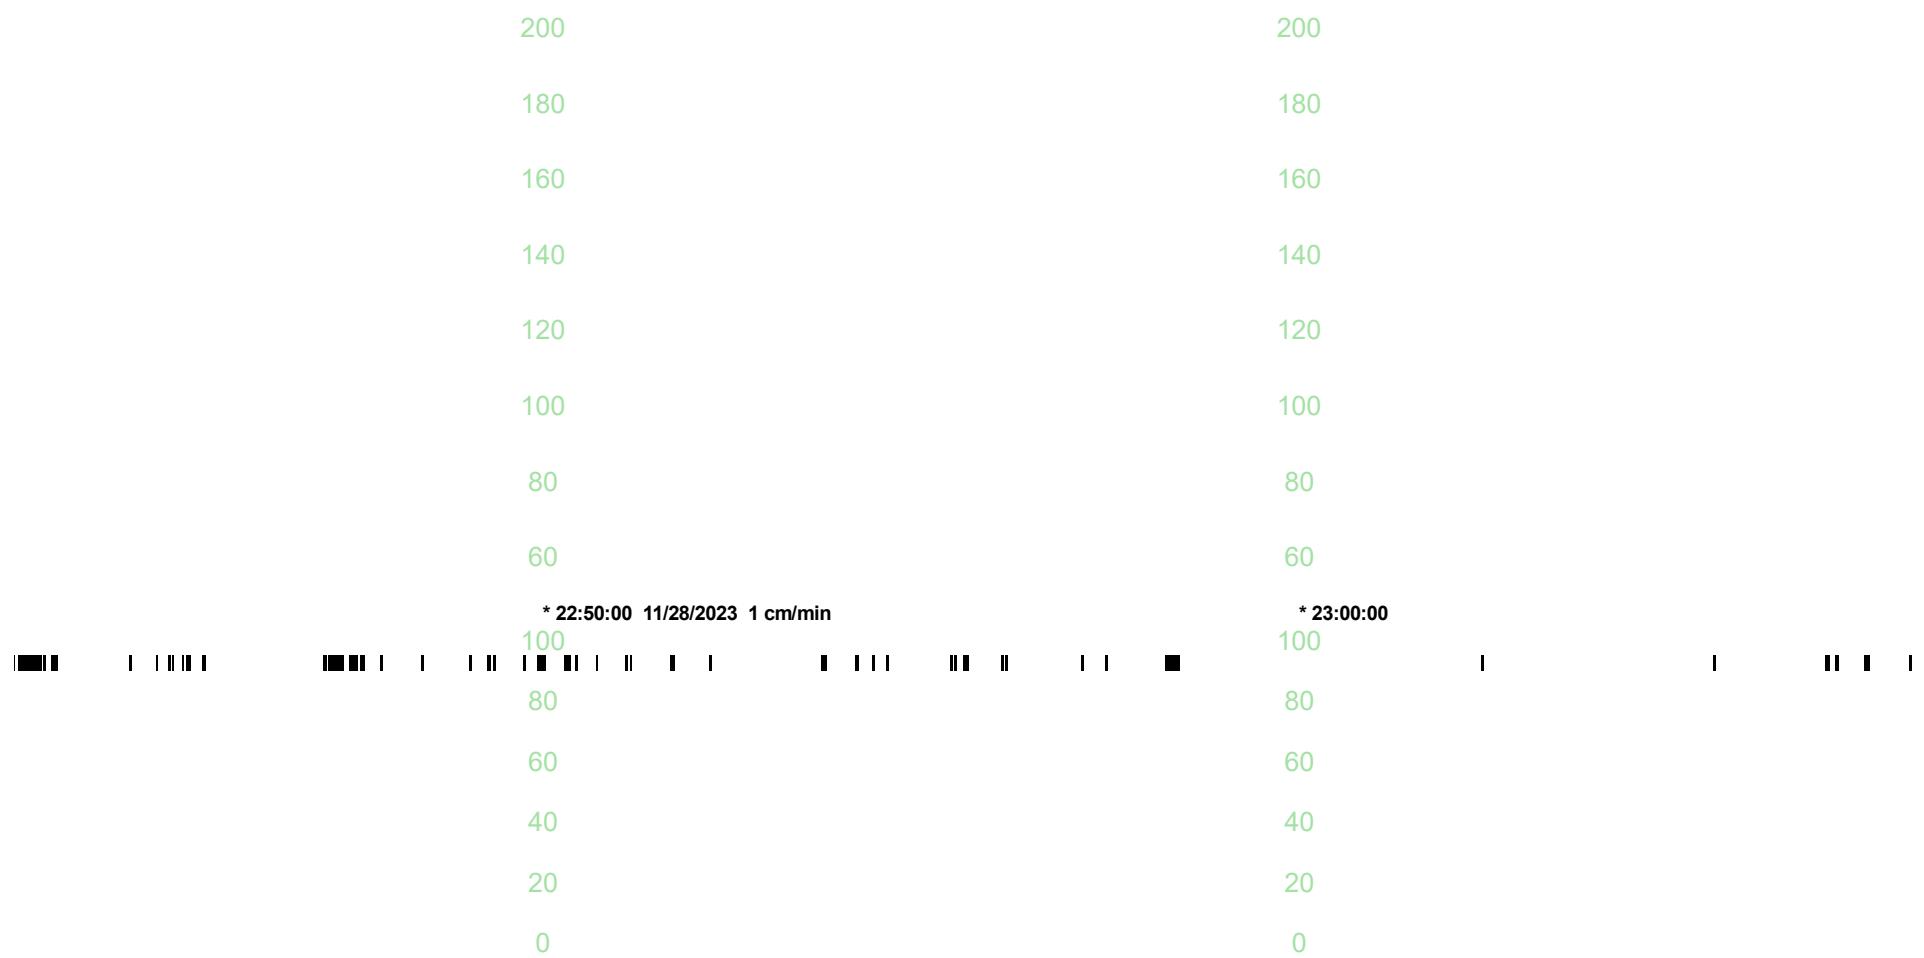


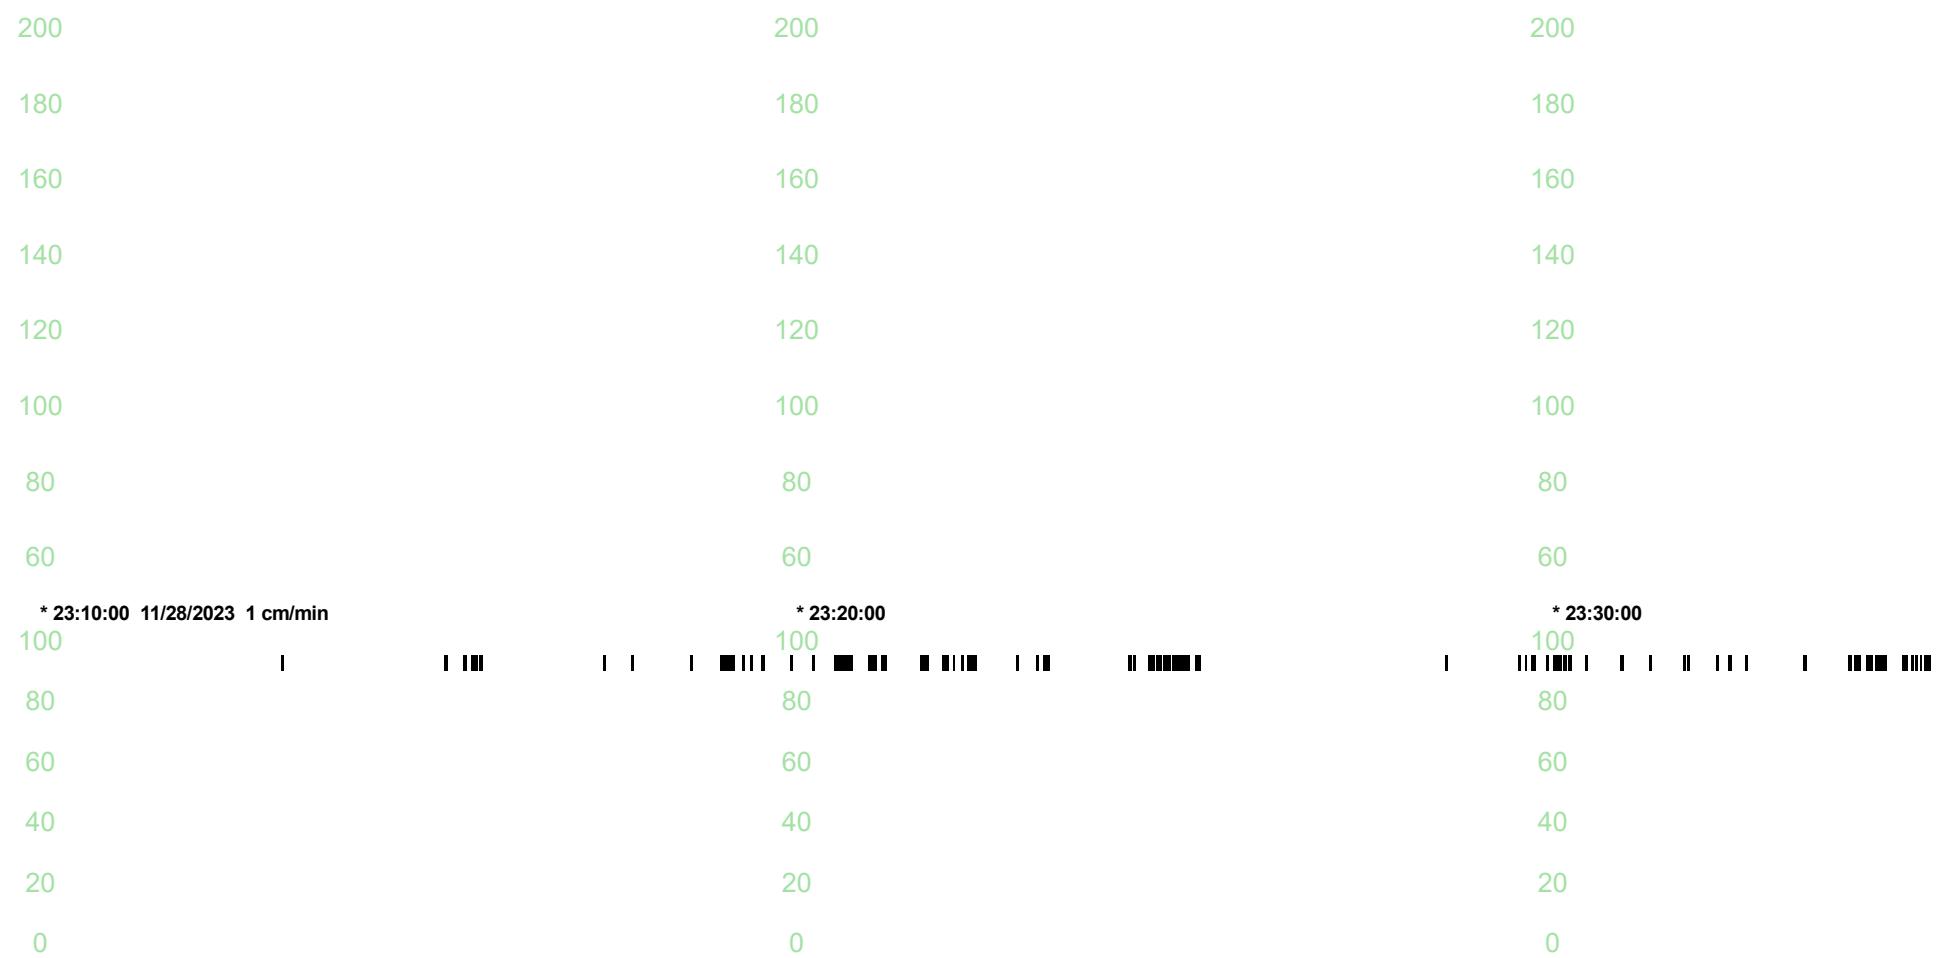



\*\* FCF1: BRADICARDIA  
Alarma con acuse de recibo

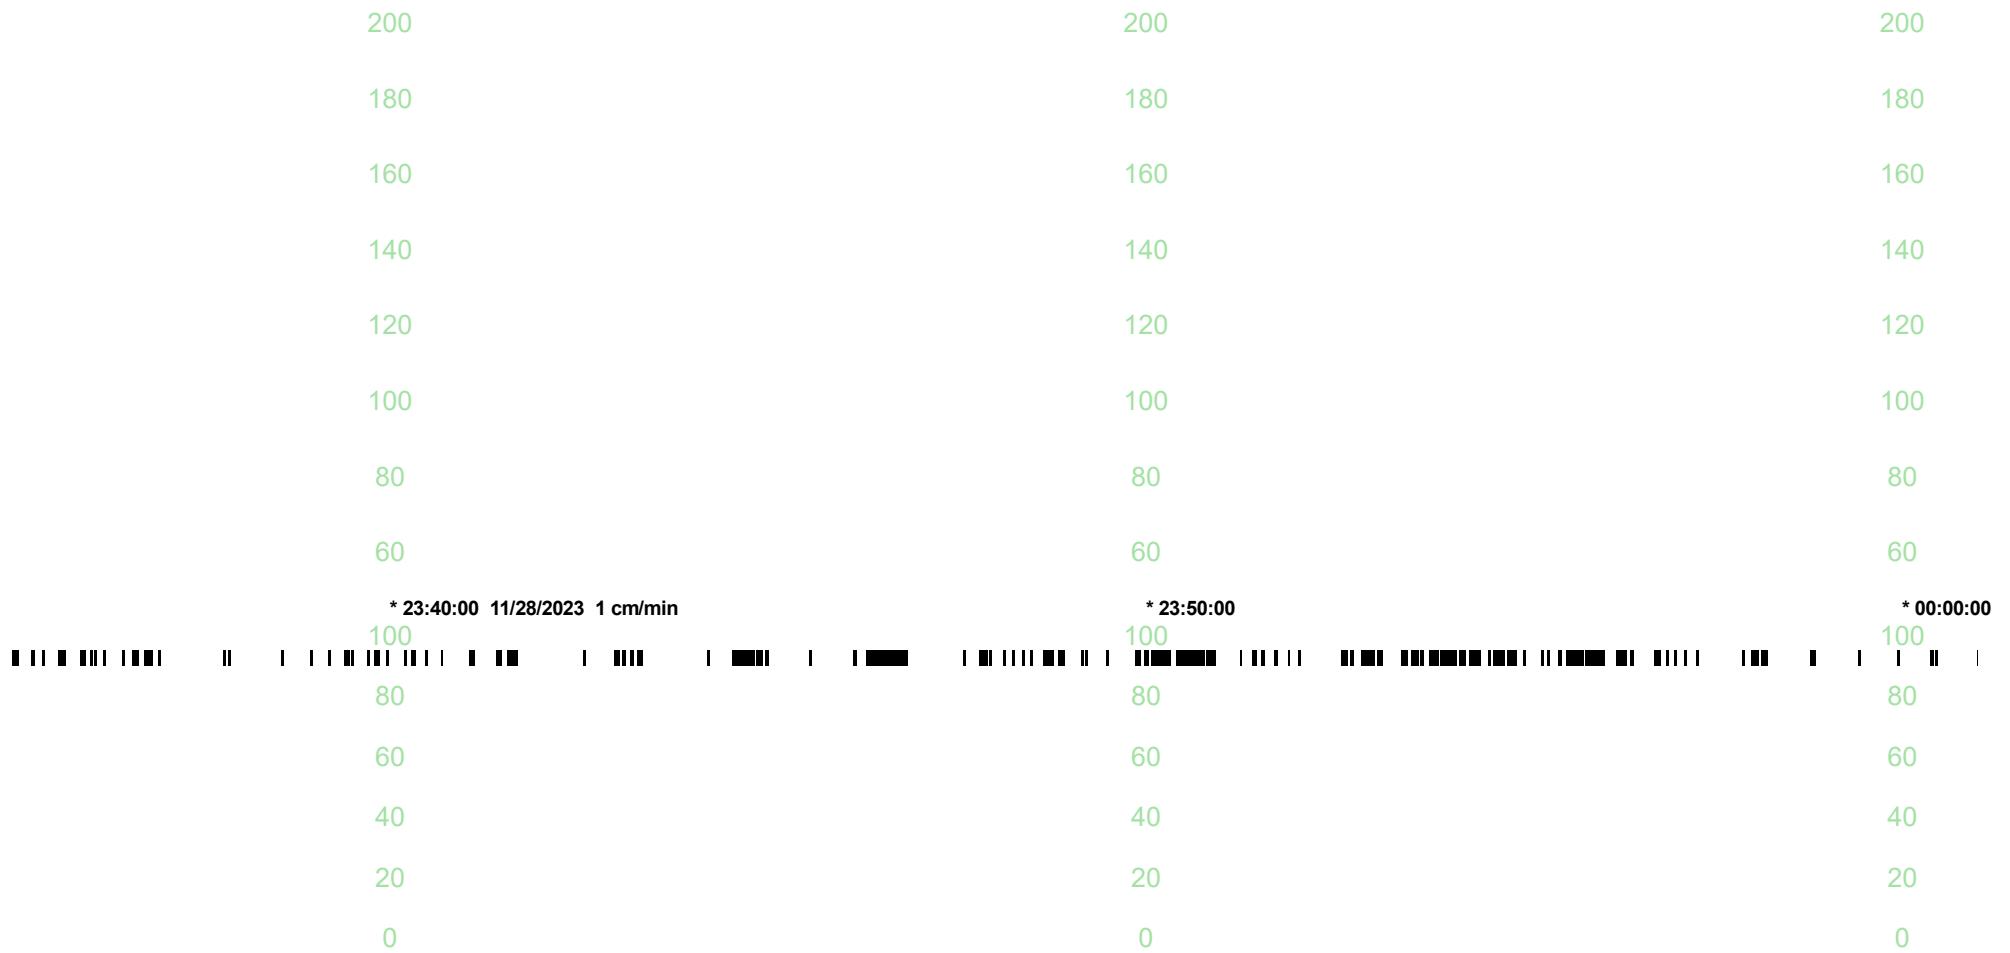


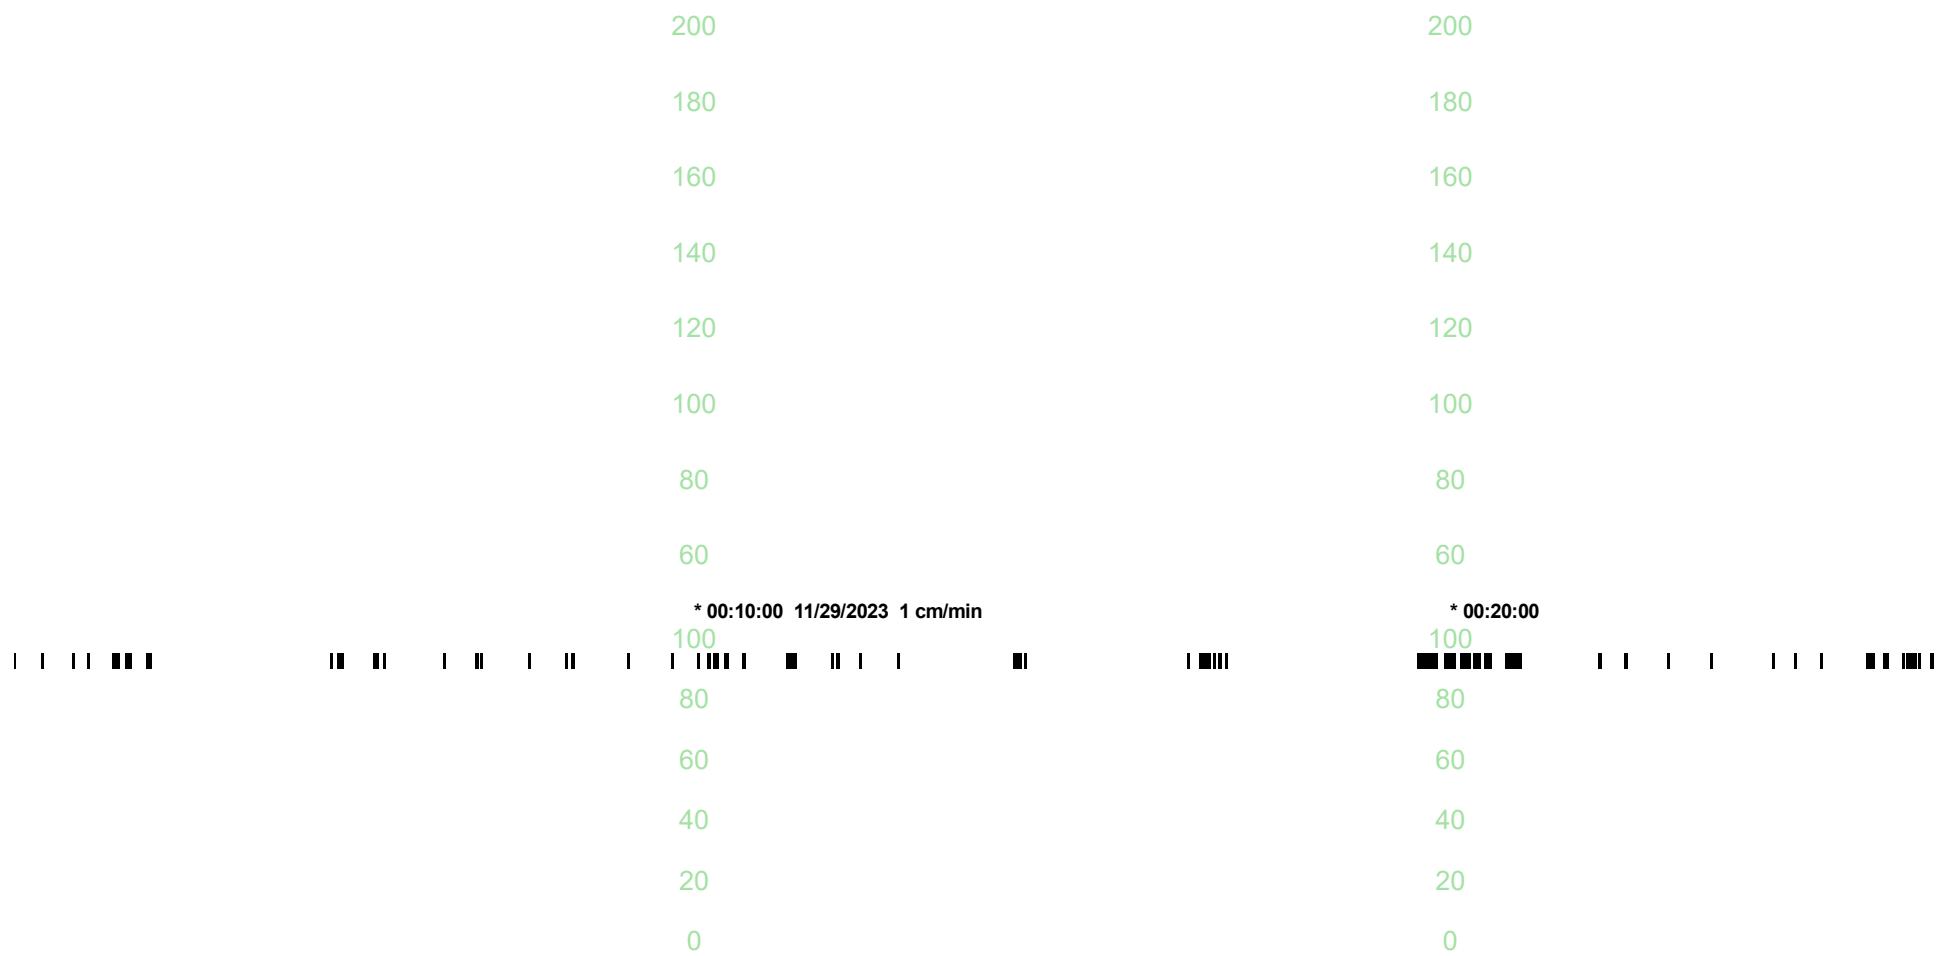


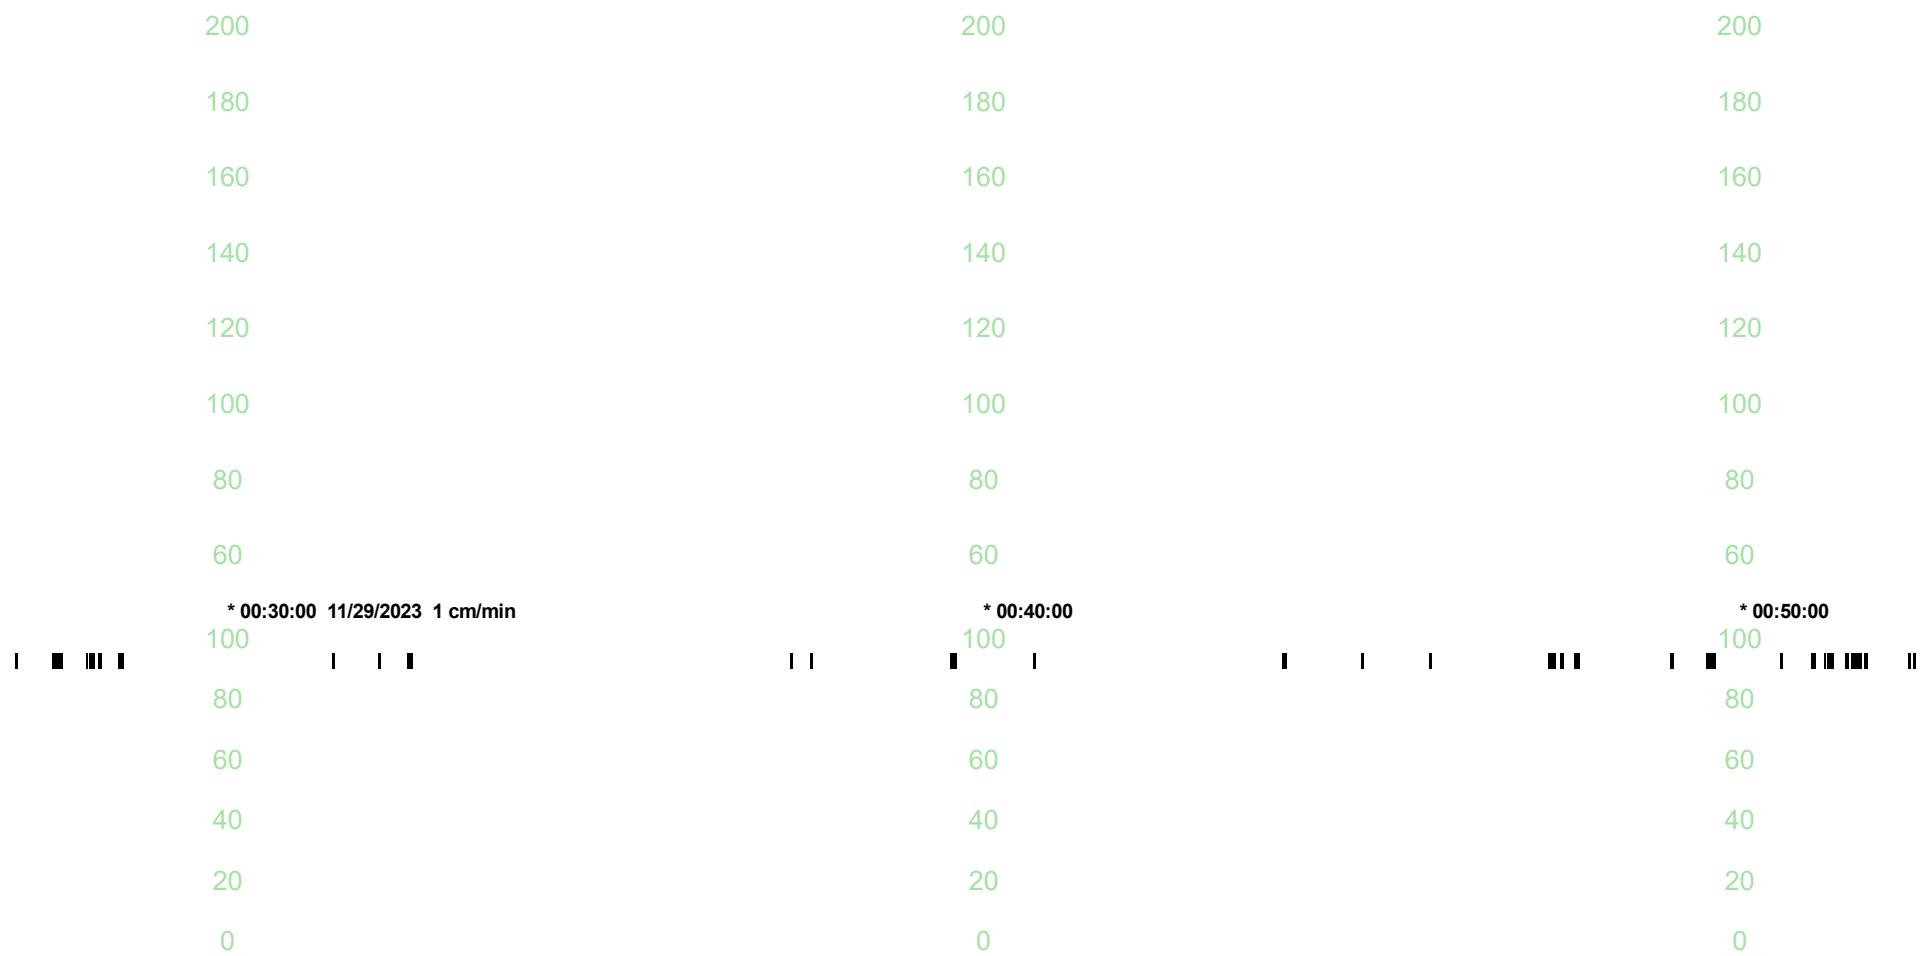

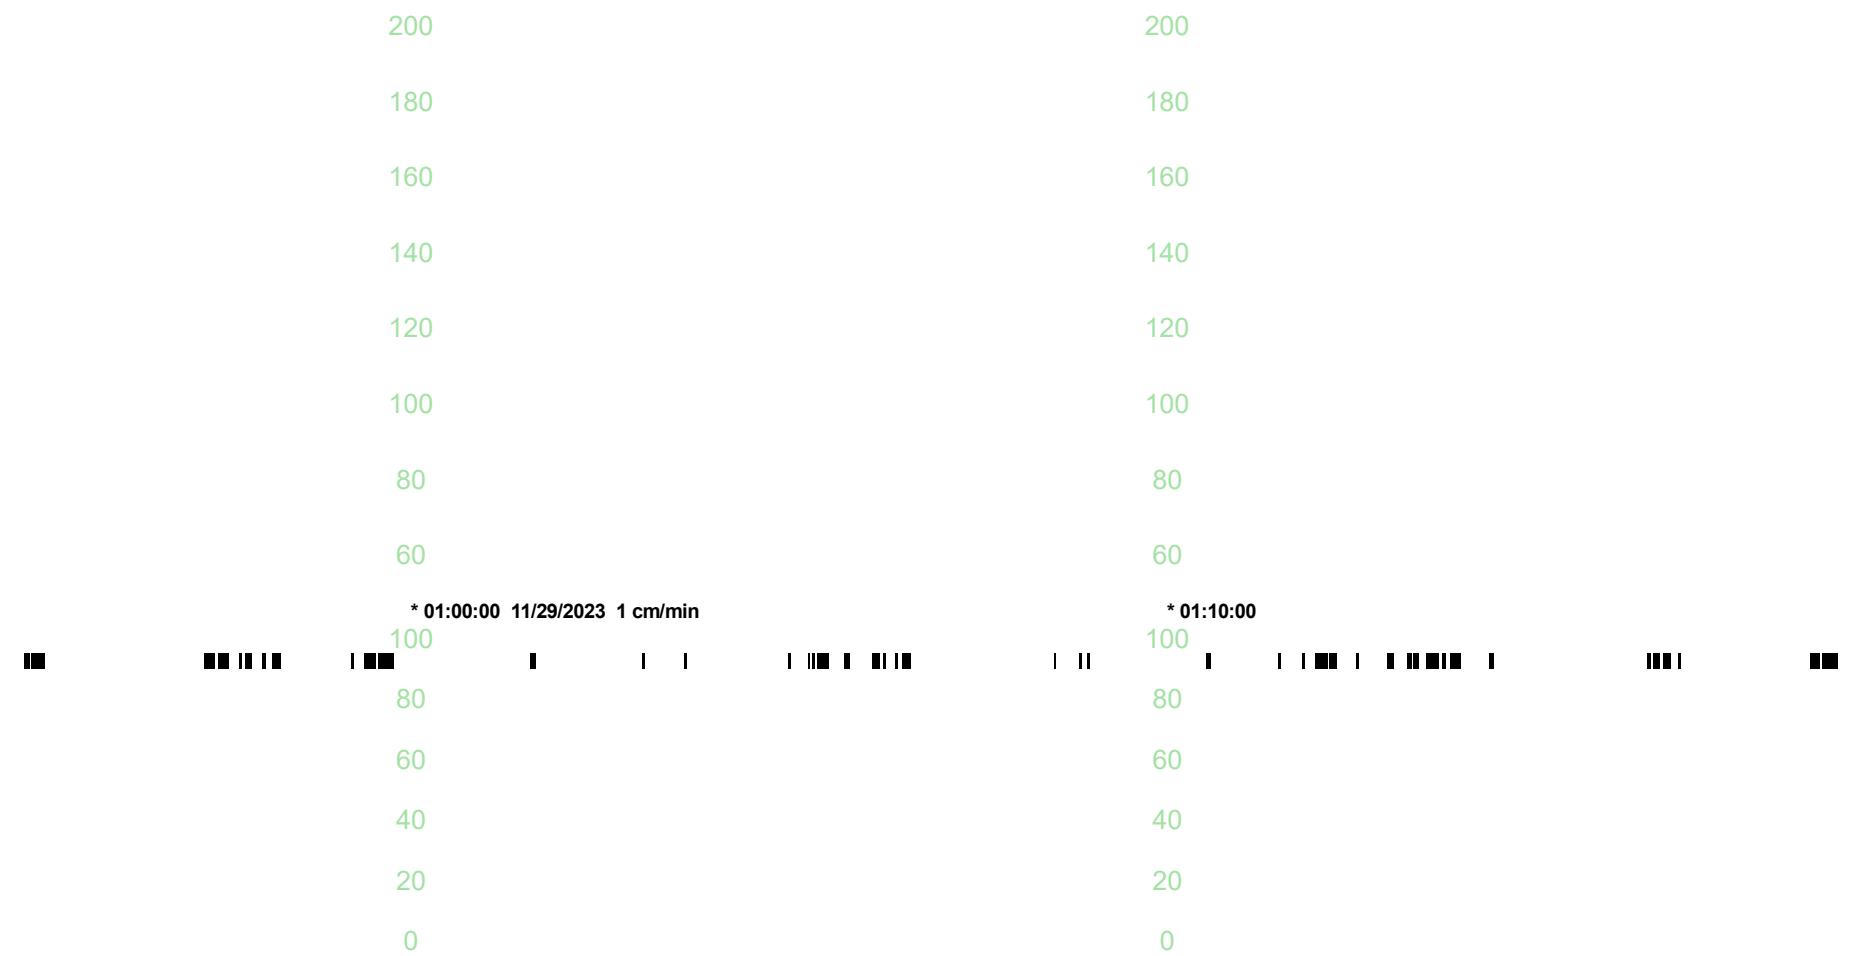

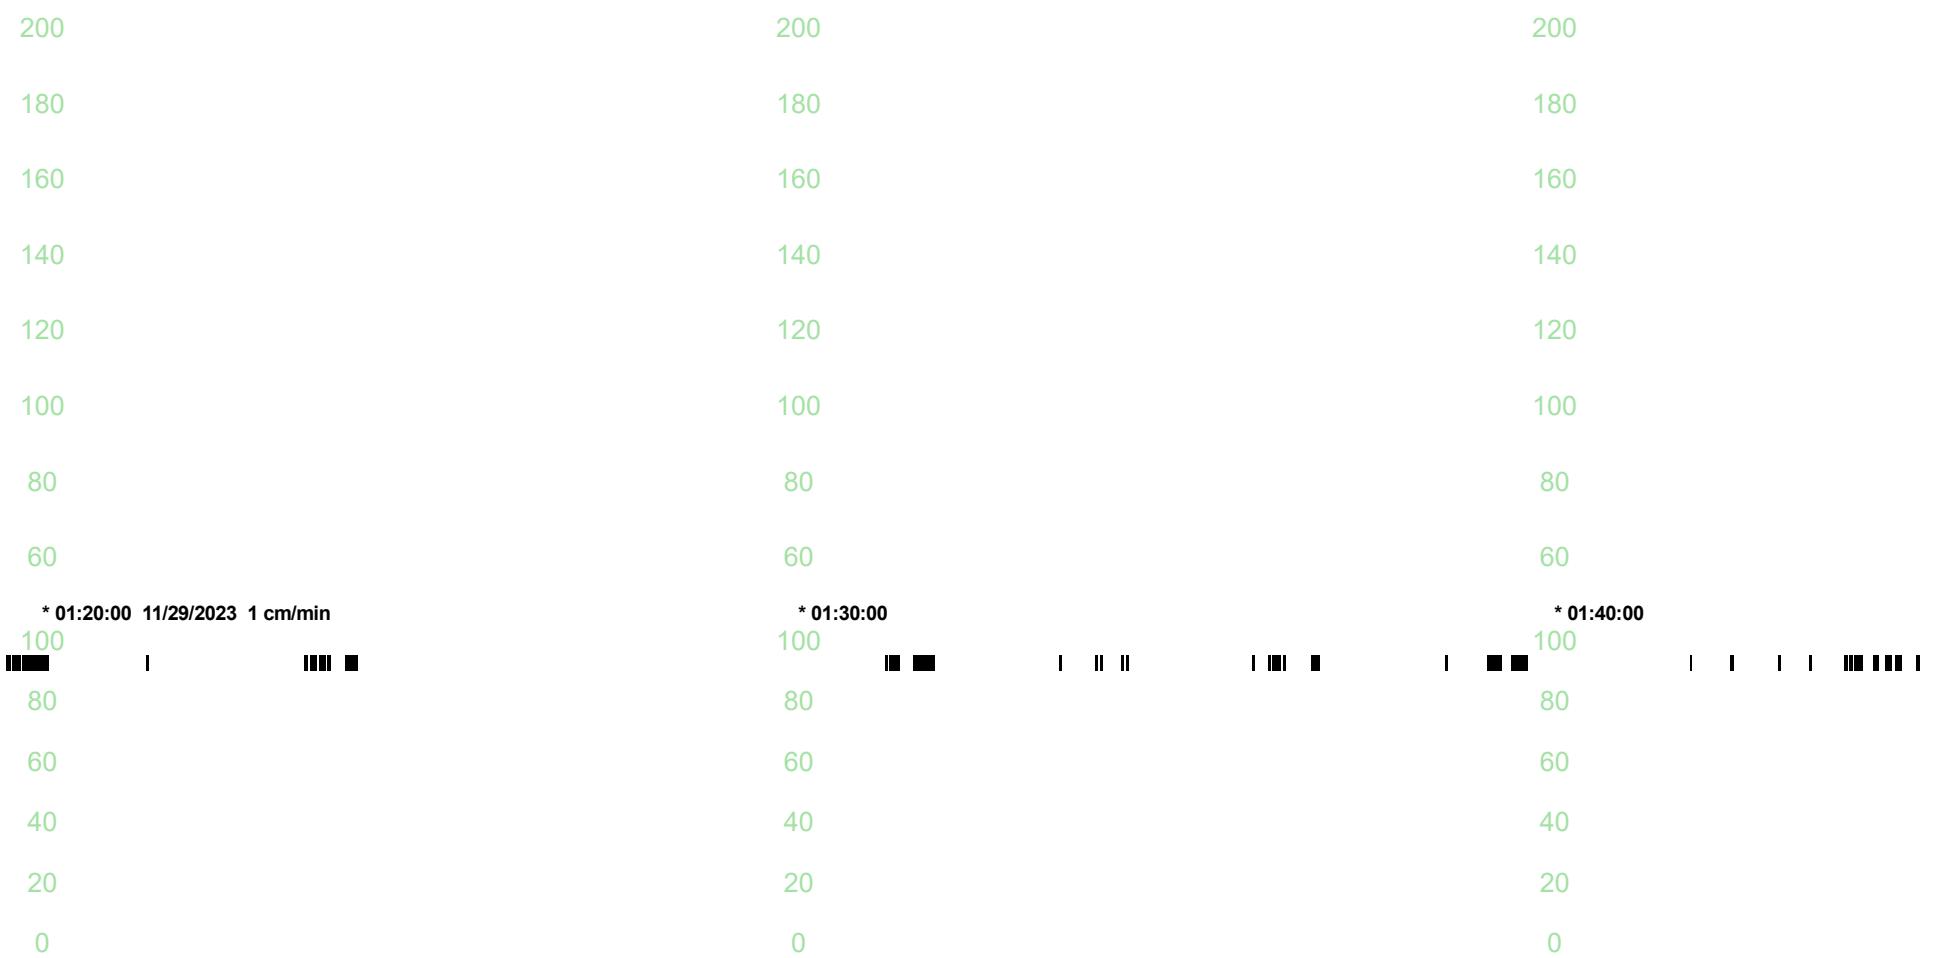


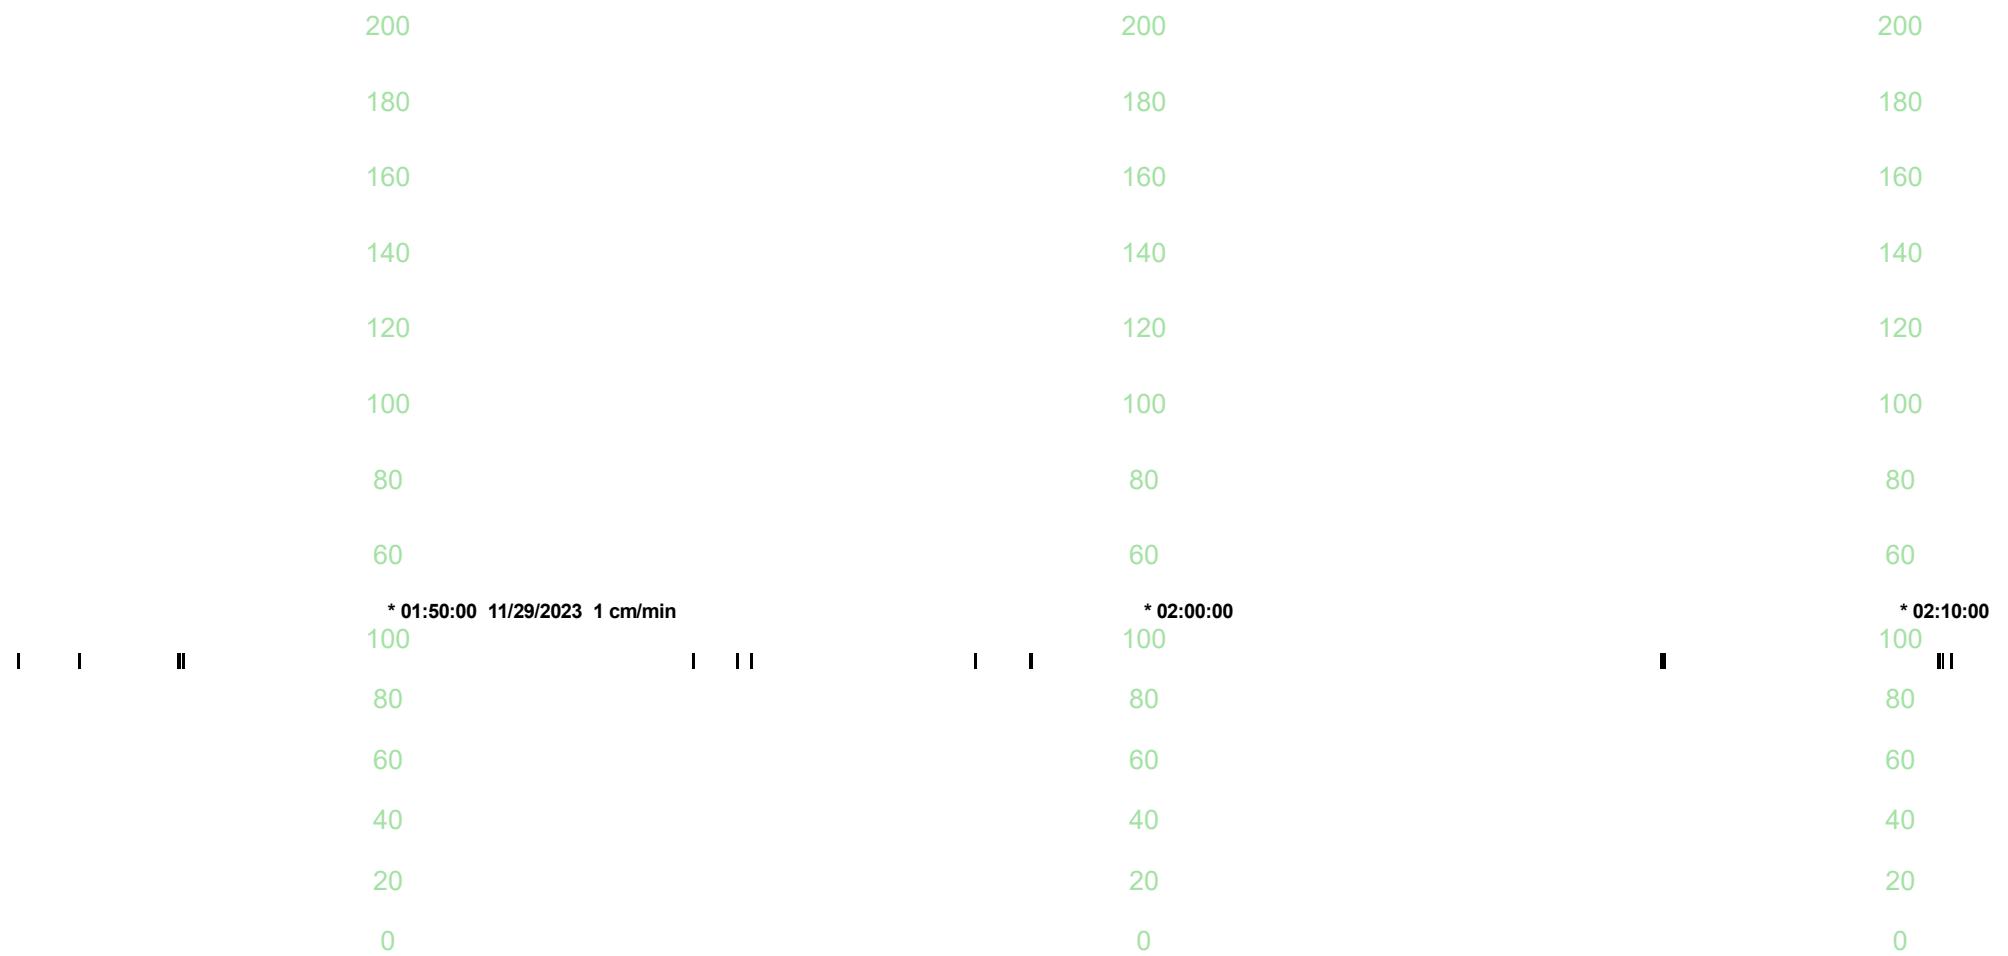

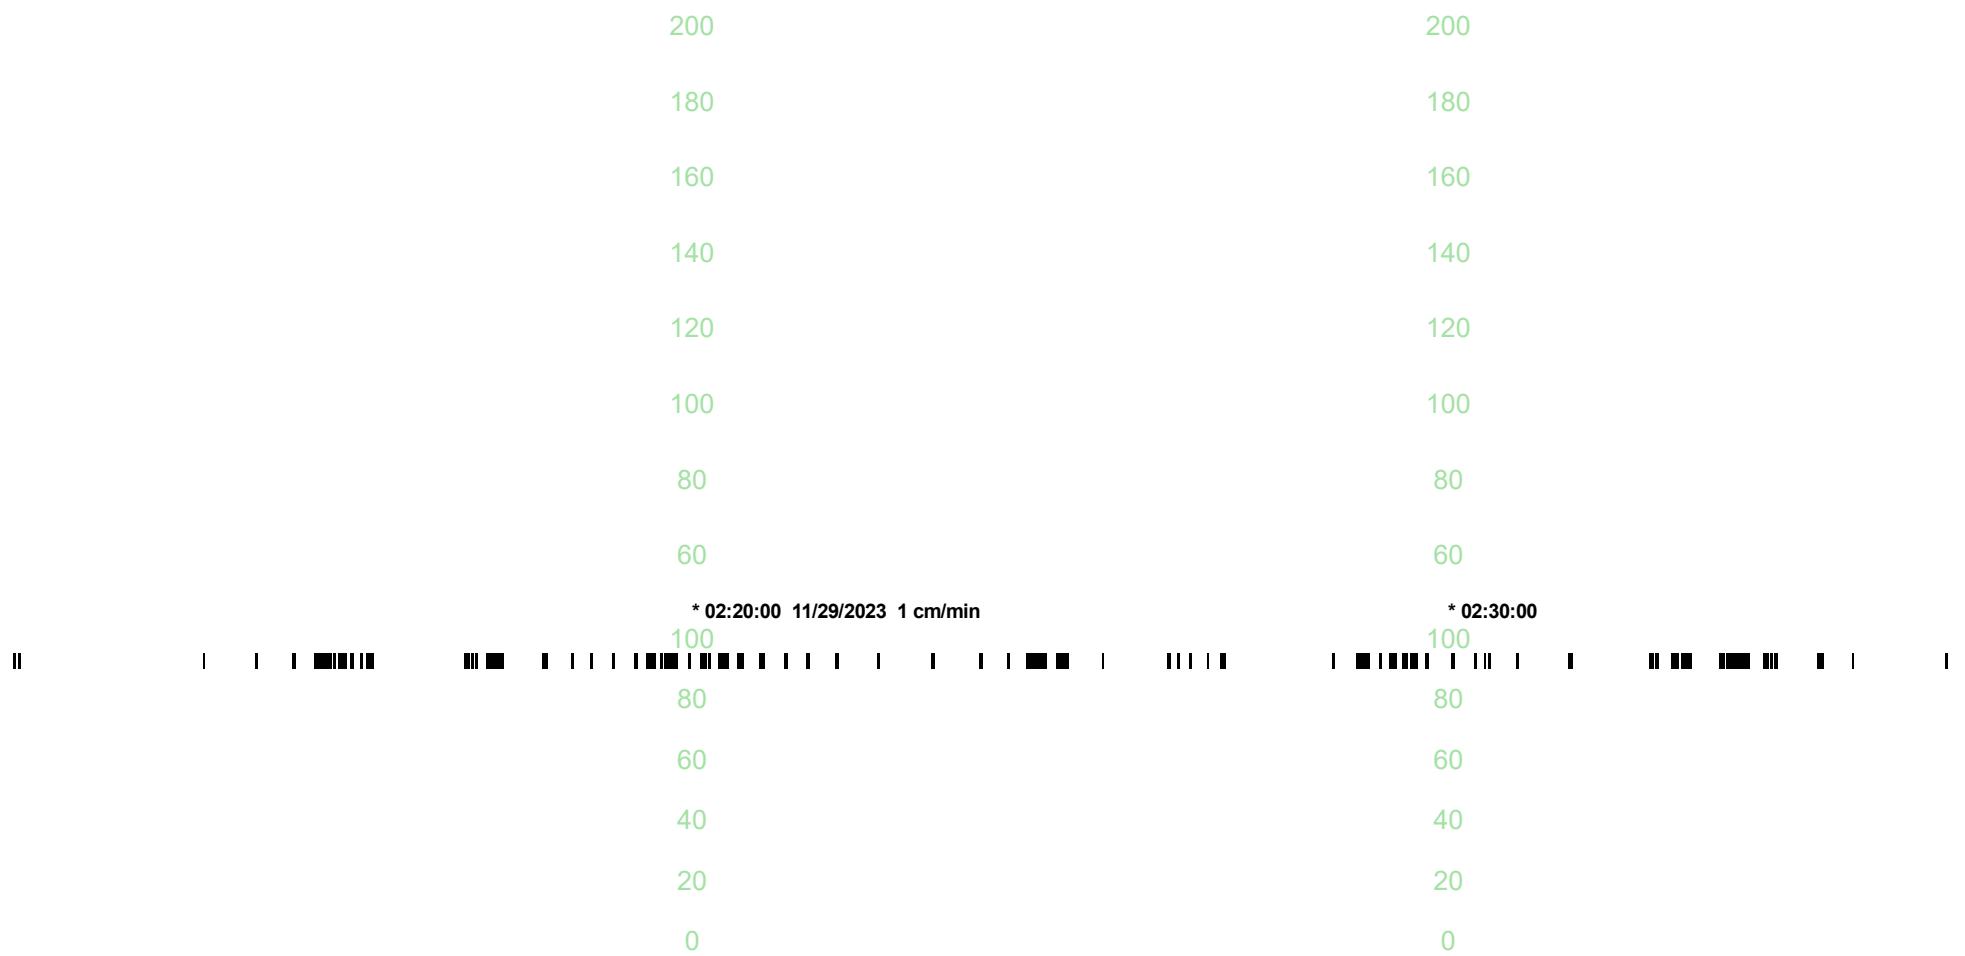


\* FCF1: PERDIDA SEÑAL  
Alarma con acuse de recibo






Alarma con acuse de recibo

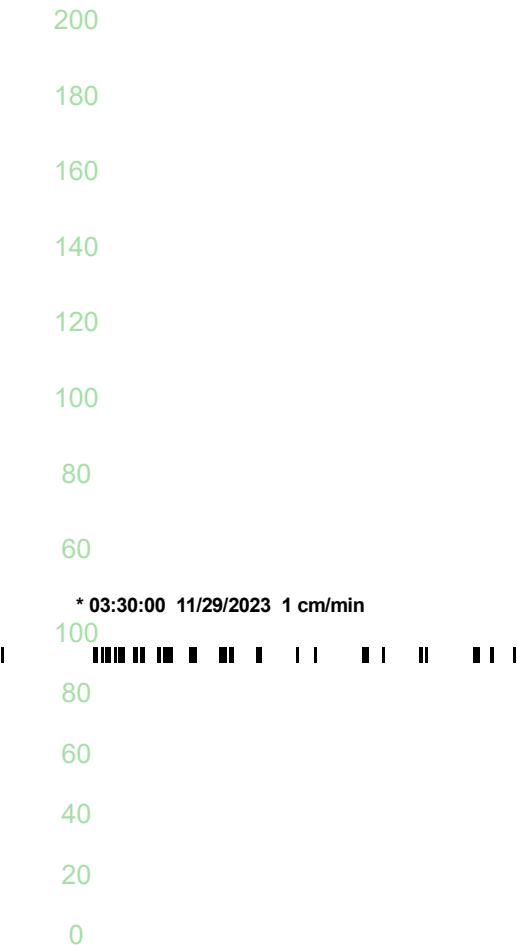

\* FCF1: PERDIDA SEÑAL  
Alarma con acuse de recibo

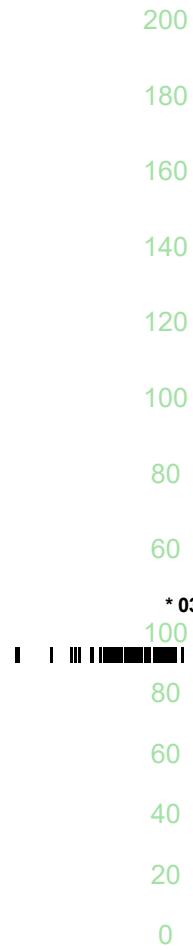


\*\* FCF1: BRADICARDIA  
Alarma con acuse de recibo





\*\* FCF1: BRADICARDIA


Alarma con acuse de recibo




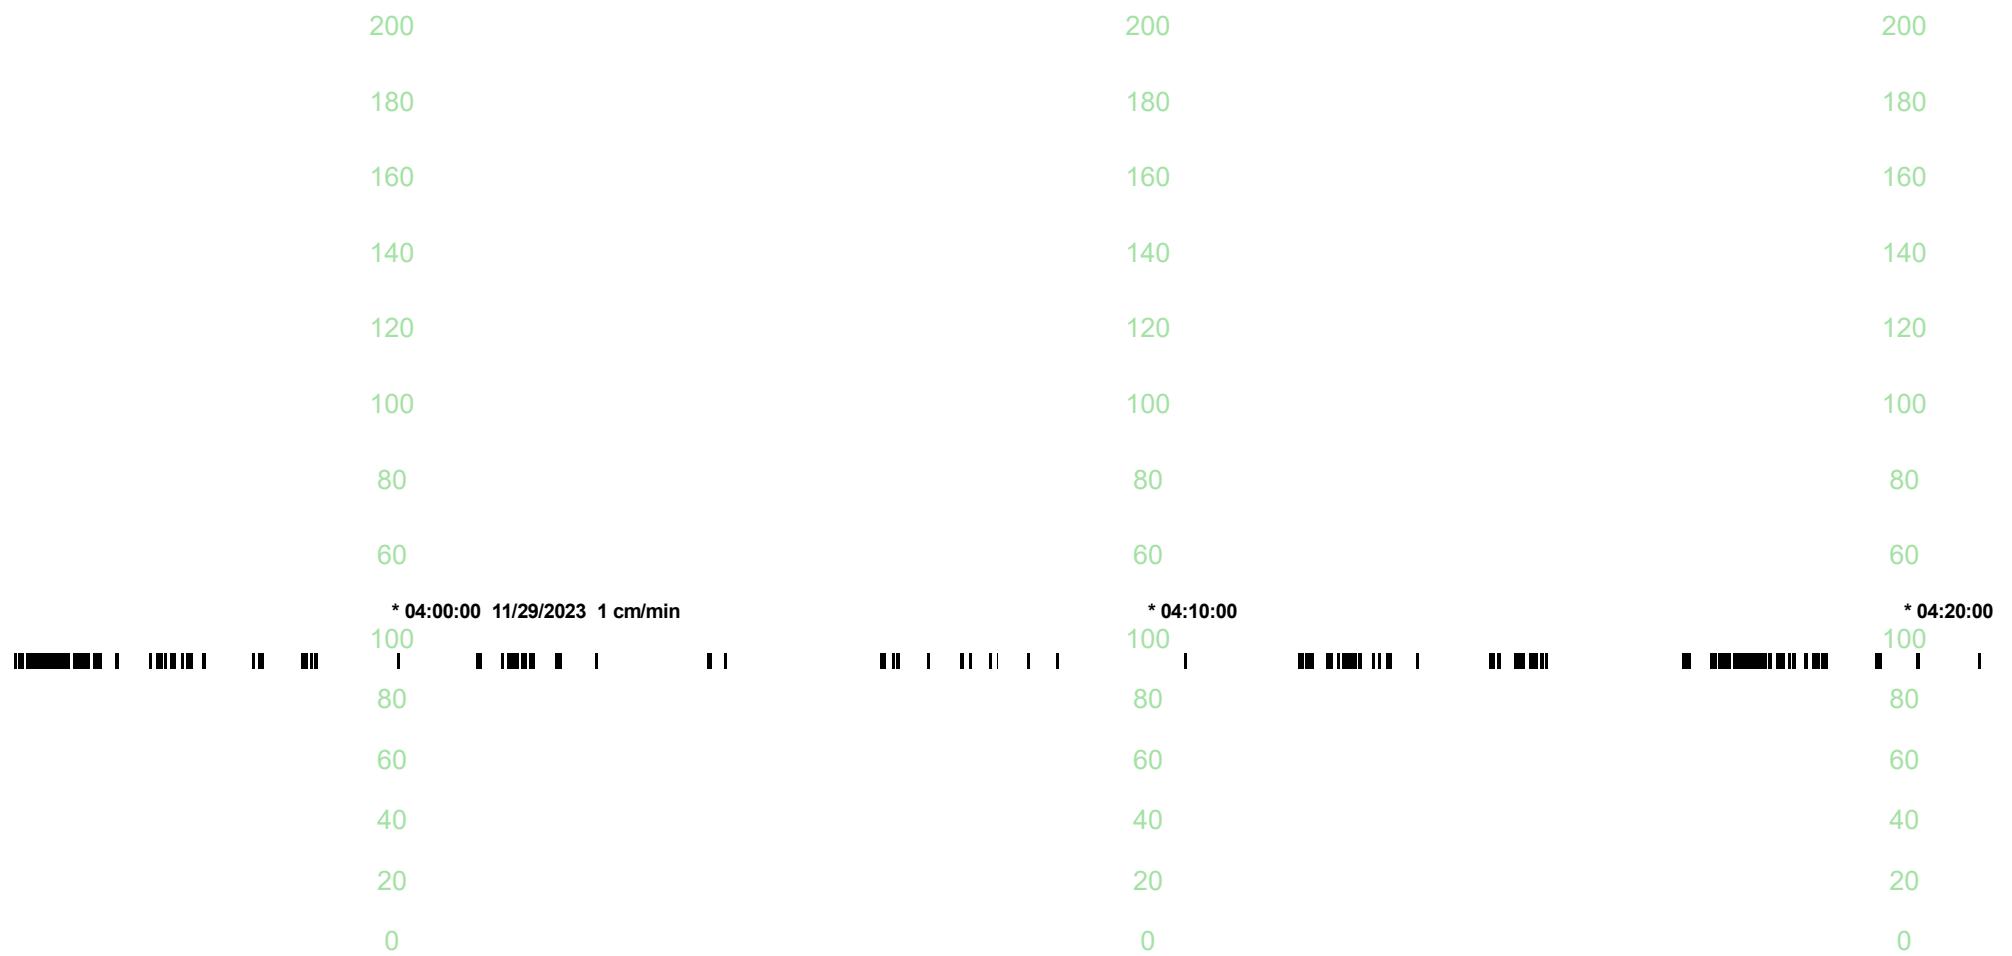

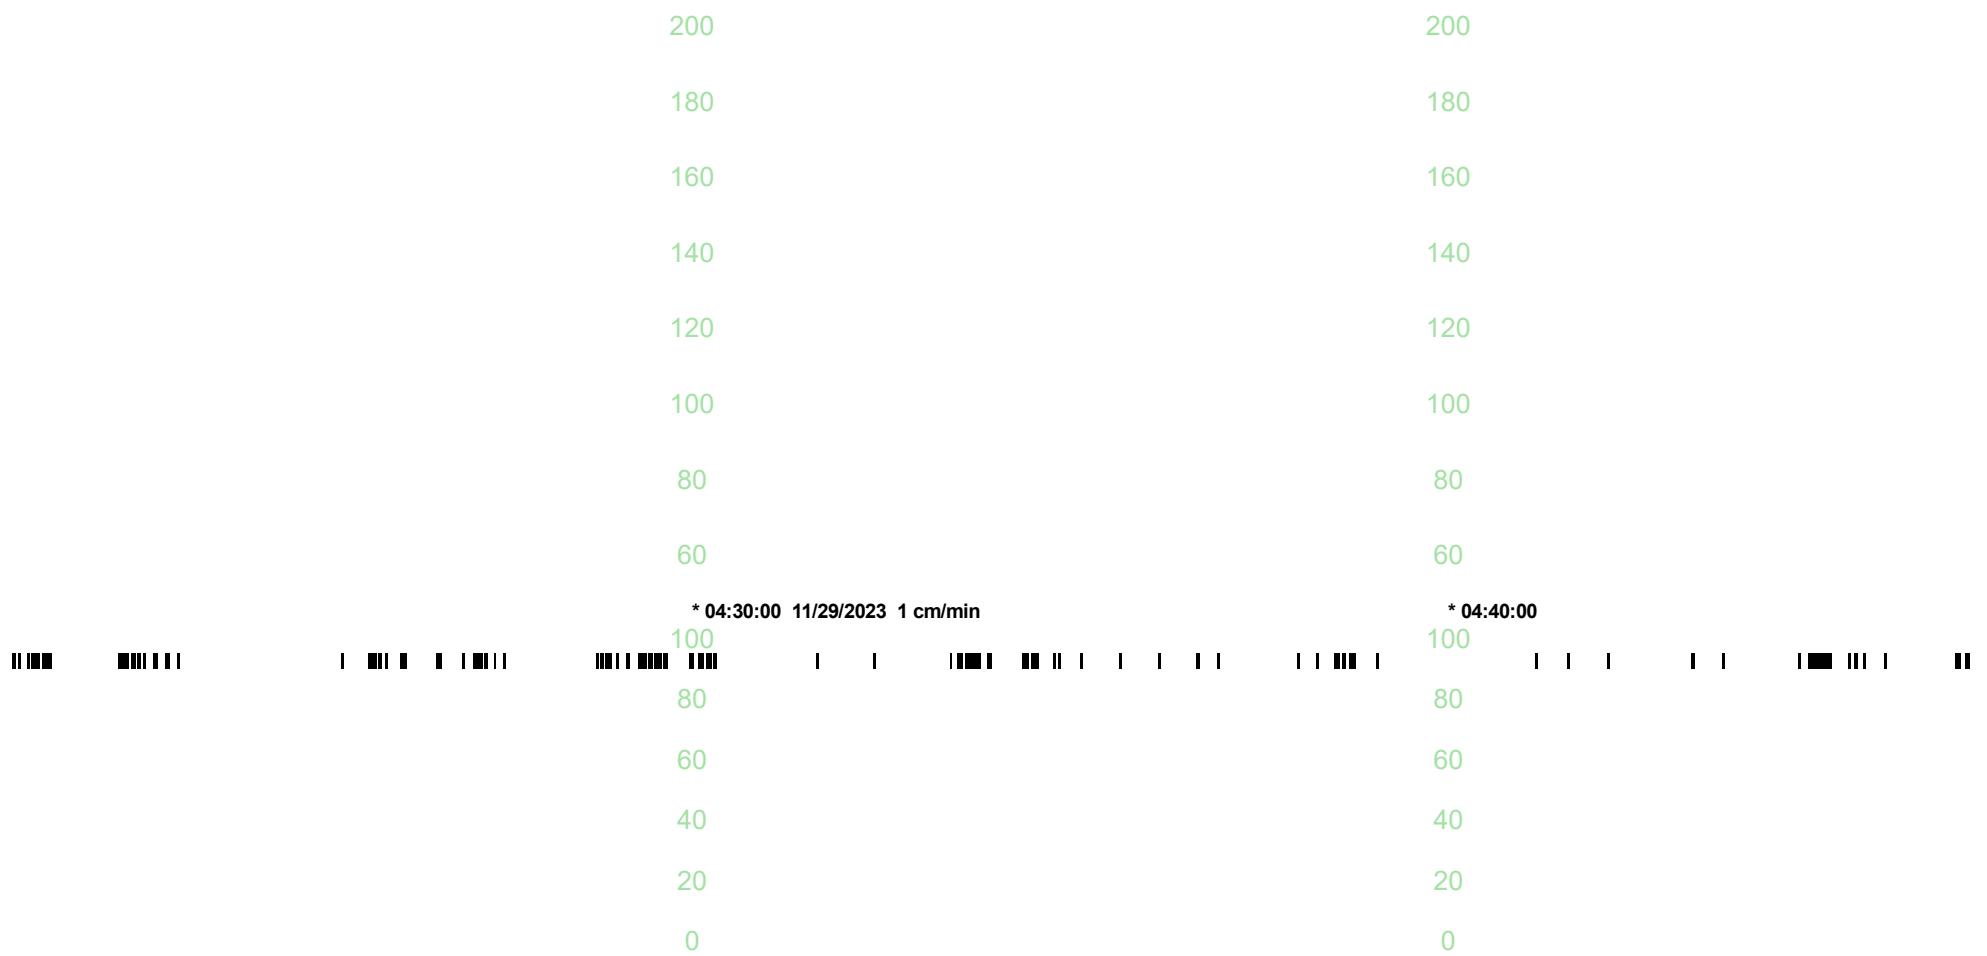


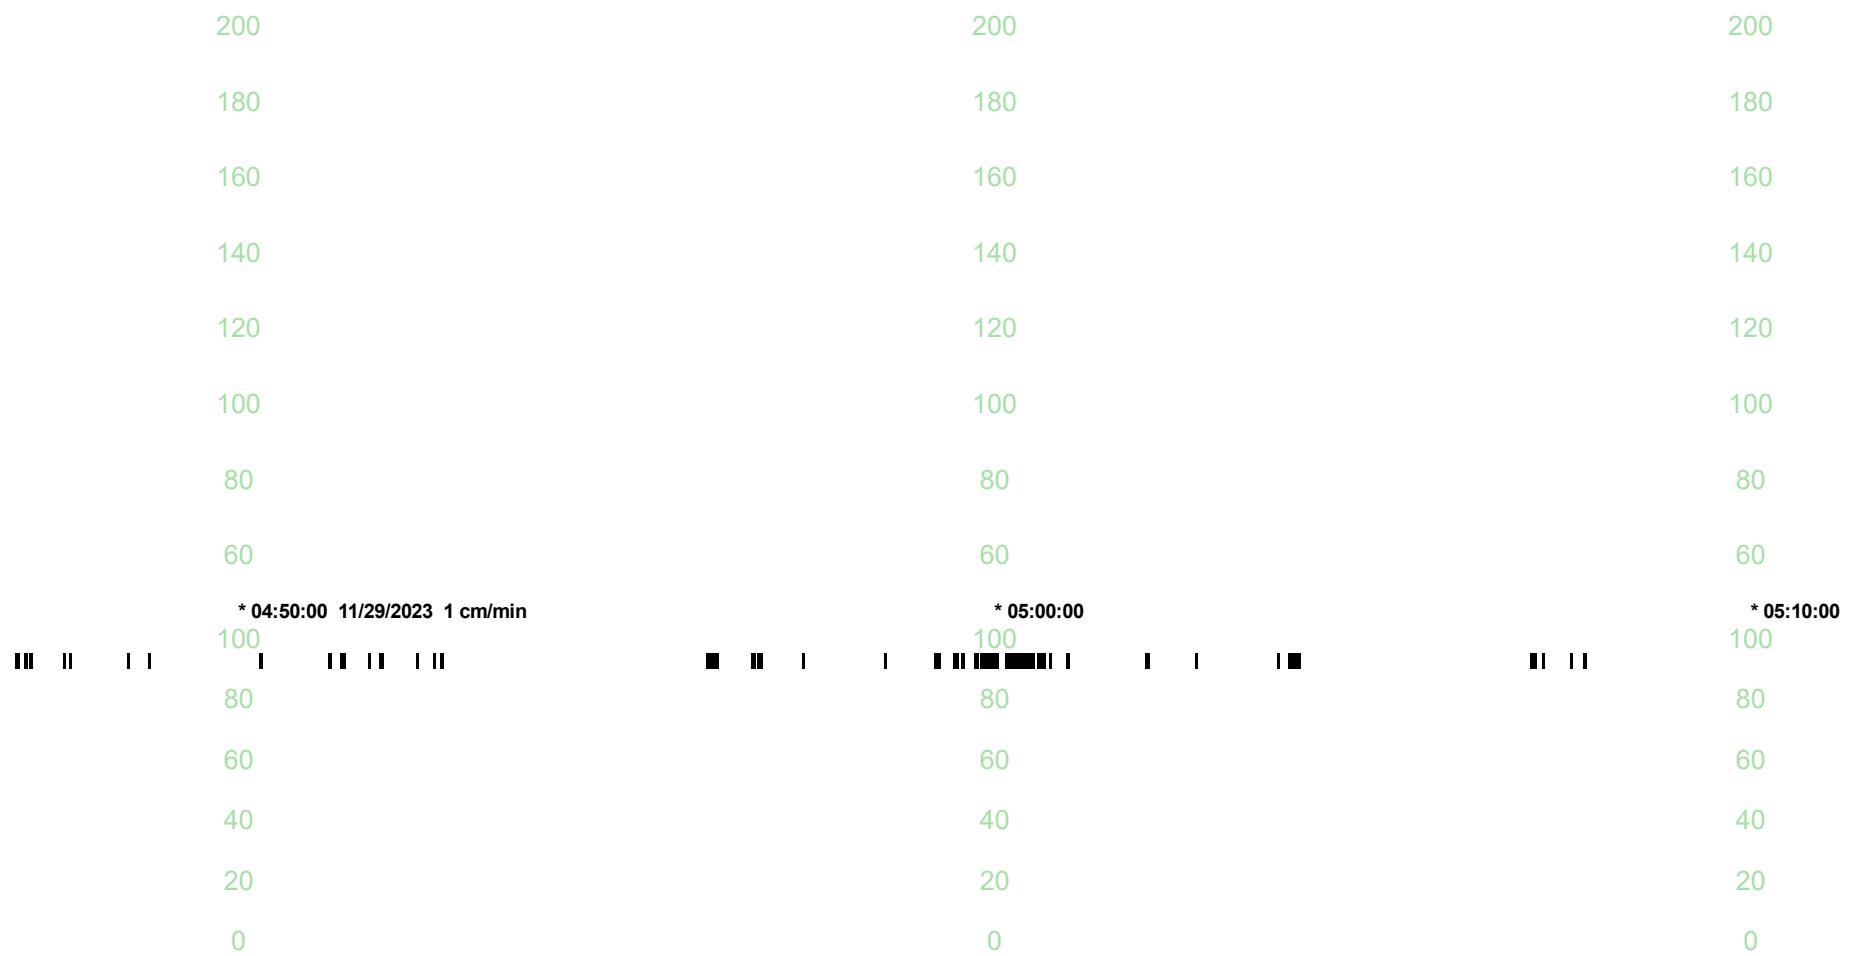


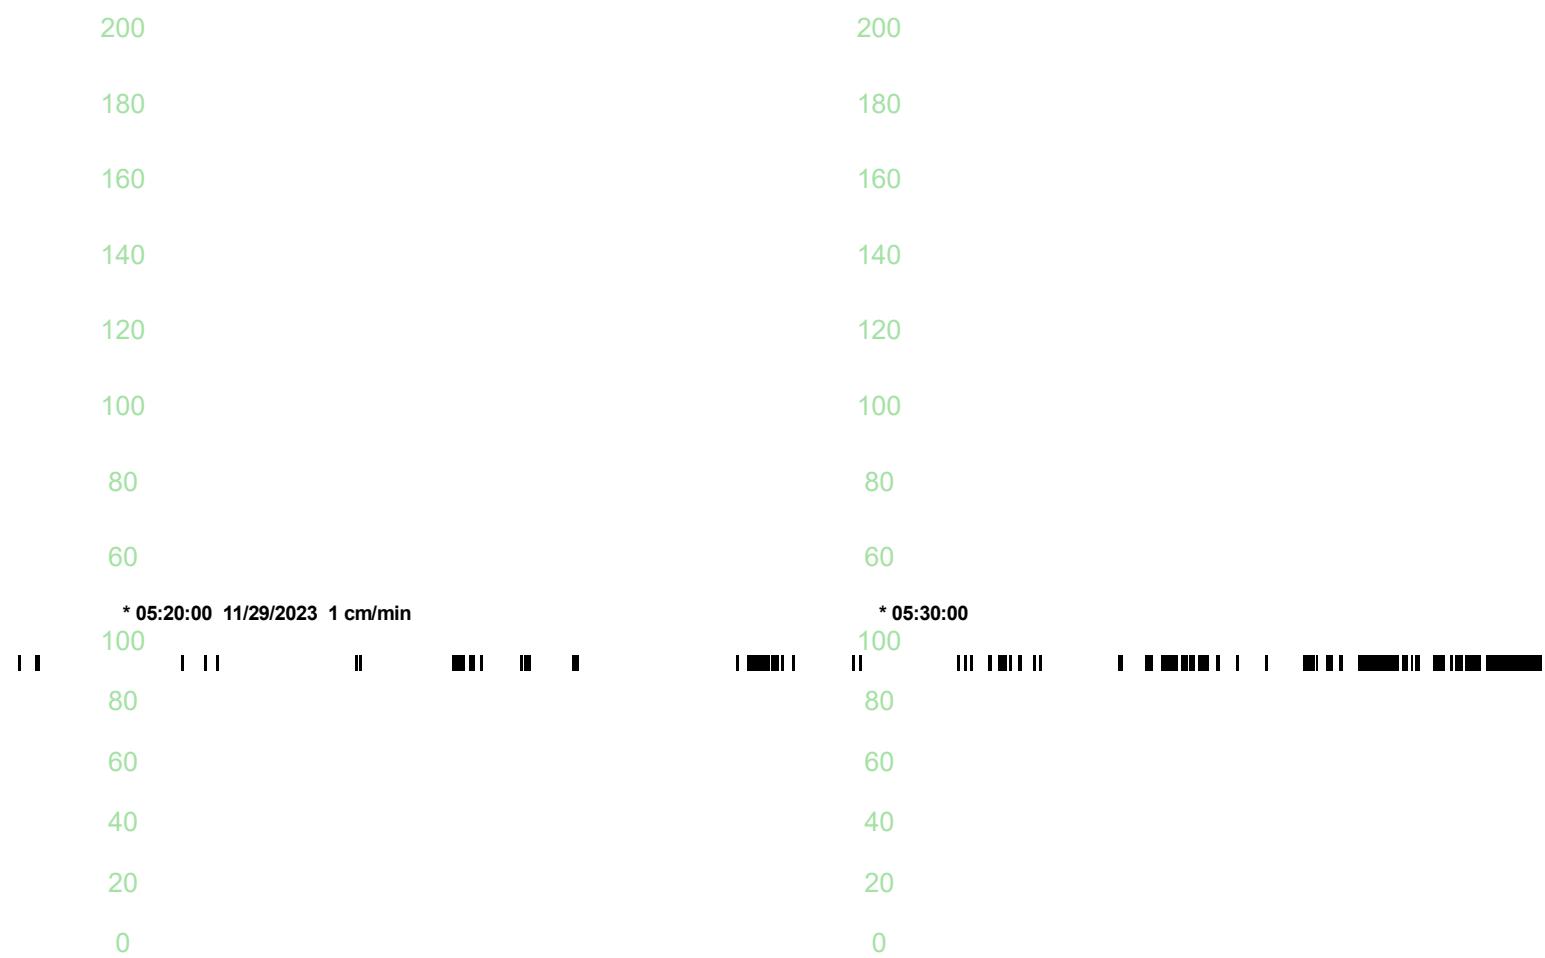


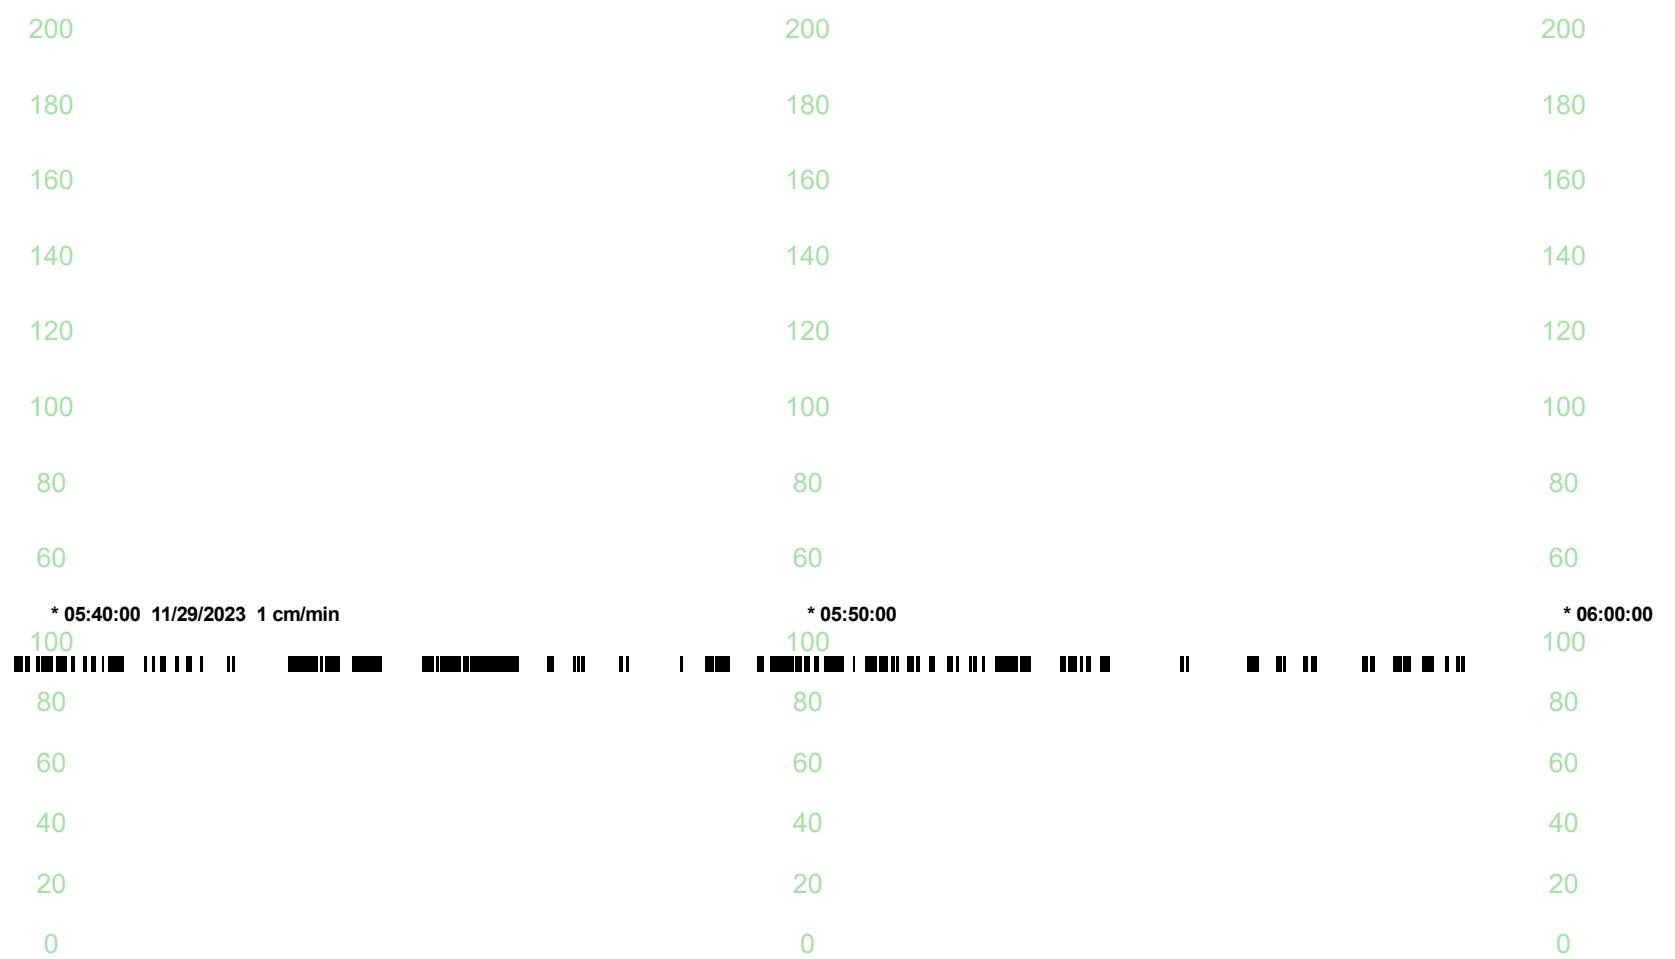

\* FCF1:BRADICARDIA  
Alarma con acuse de recibo

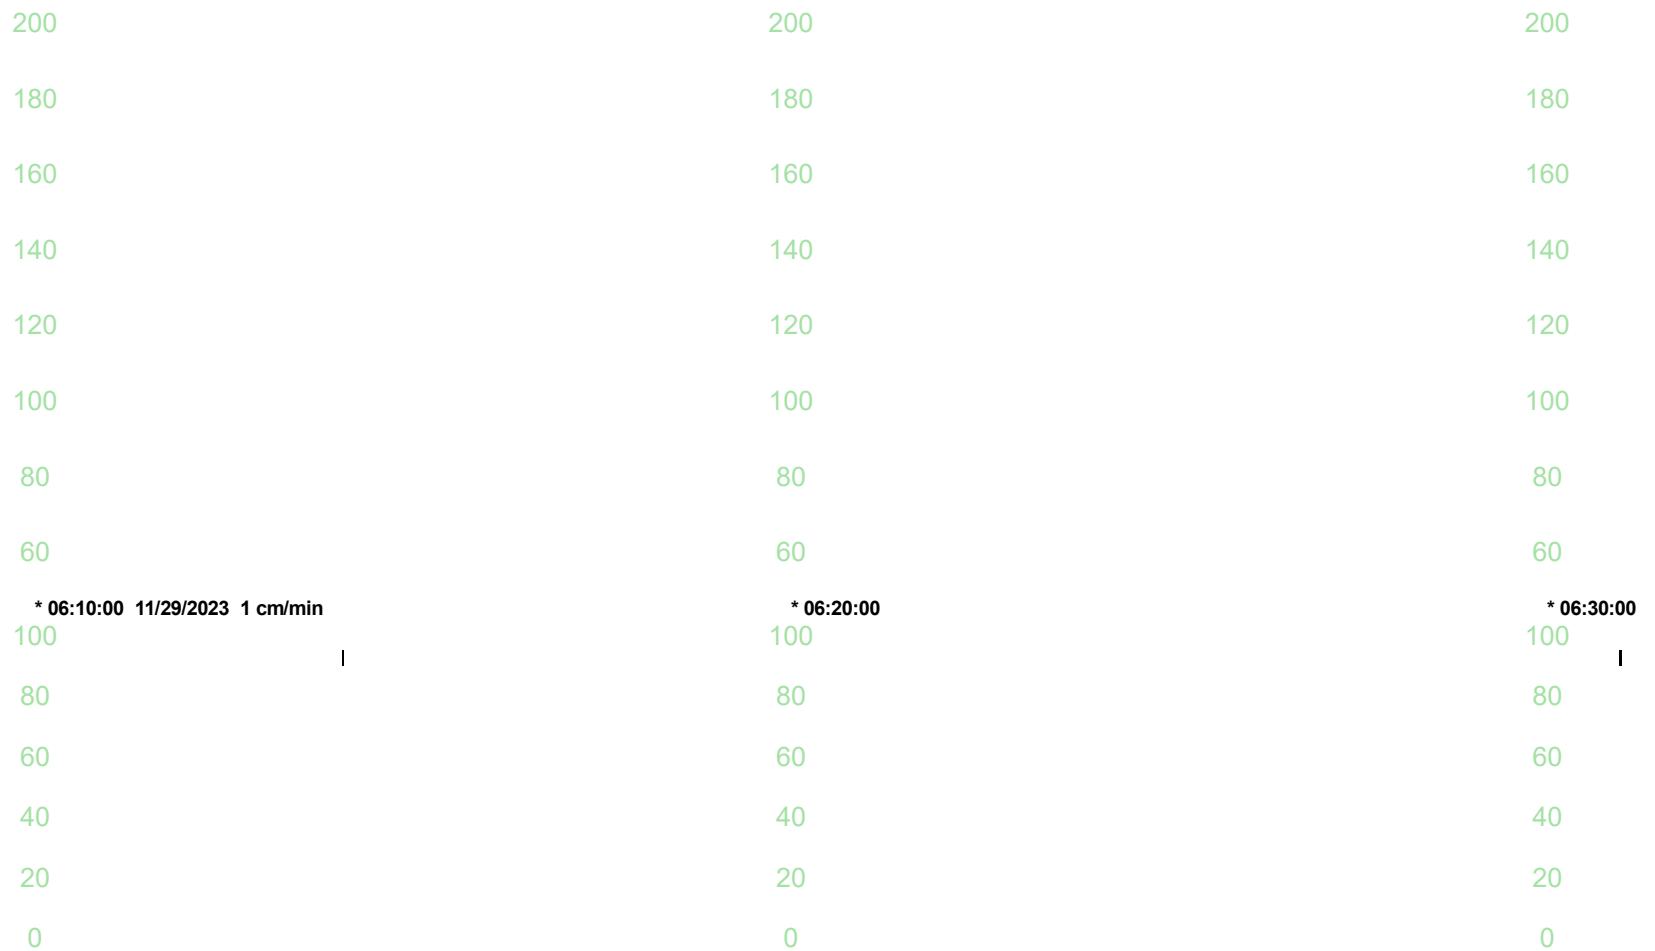

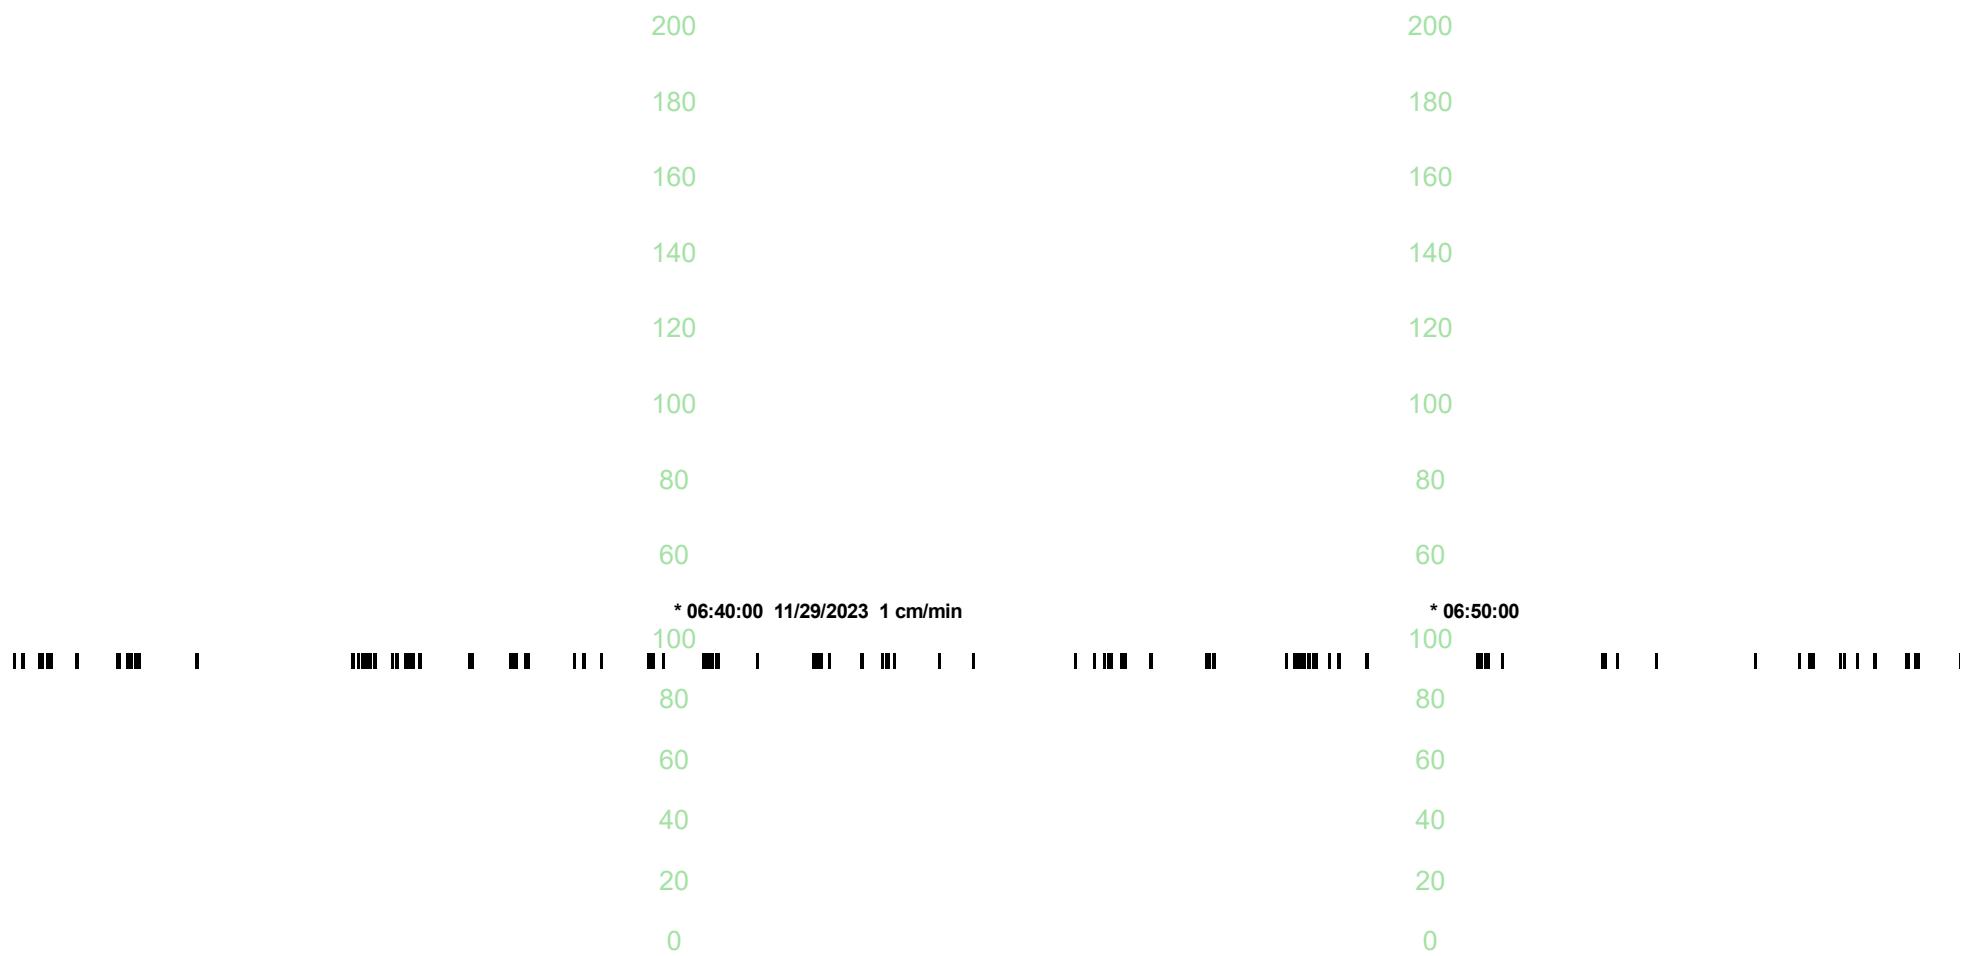


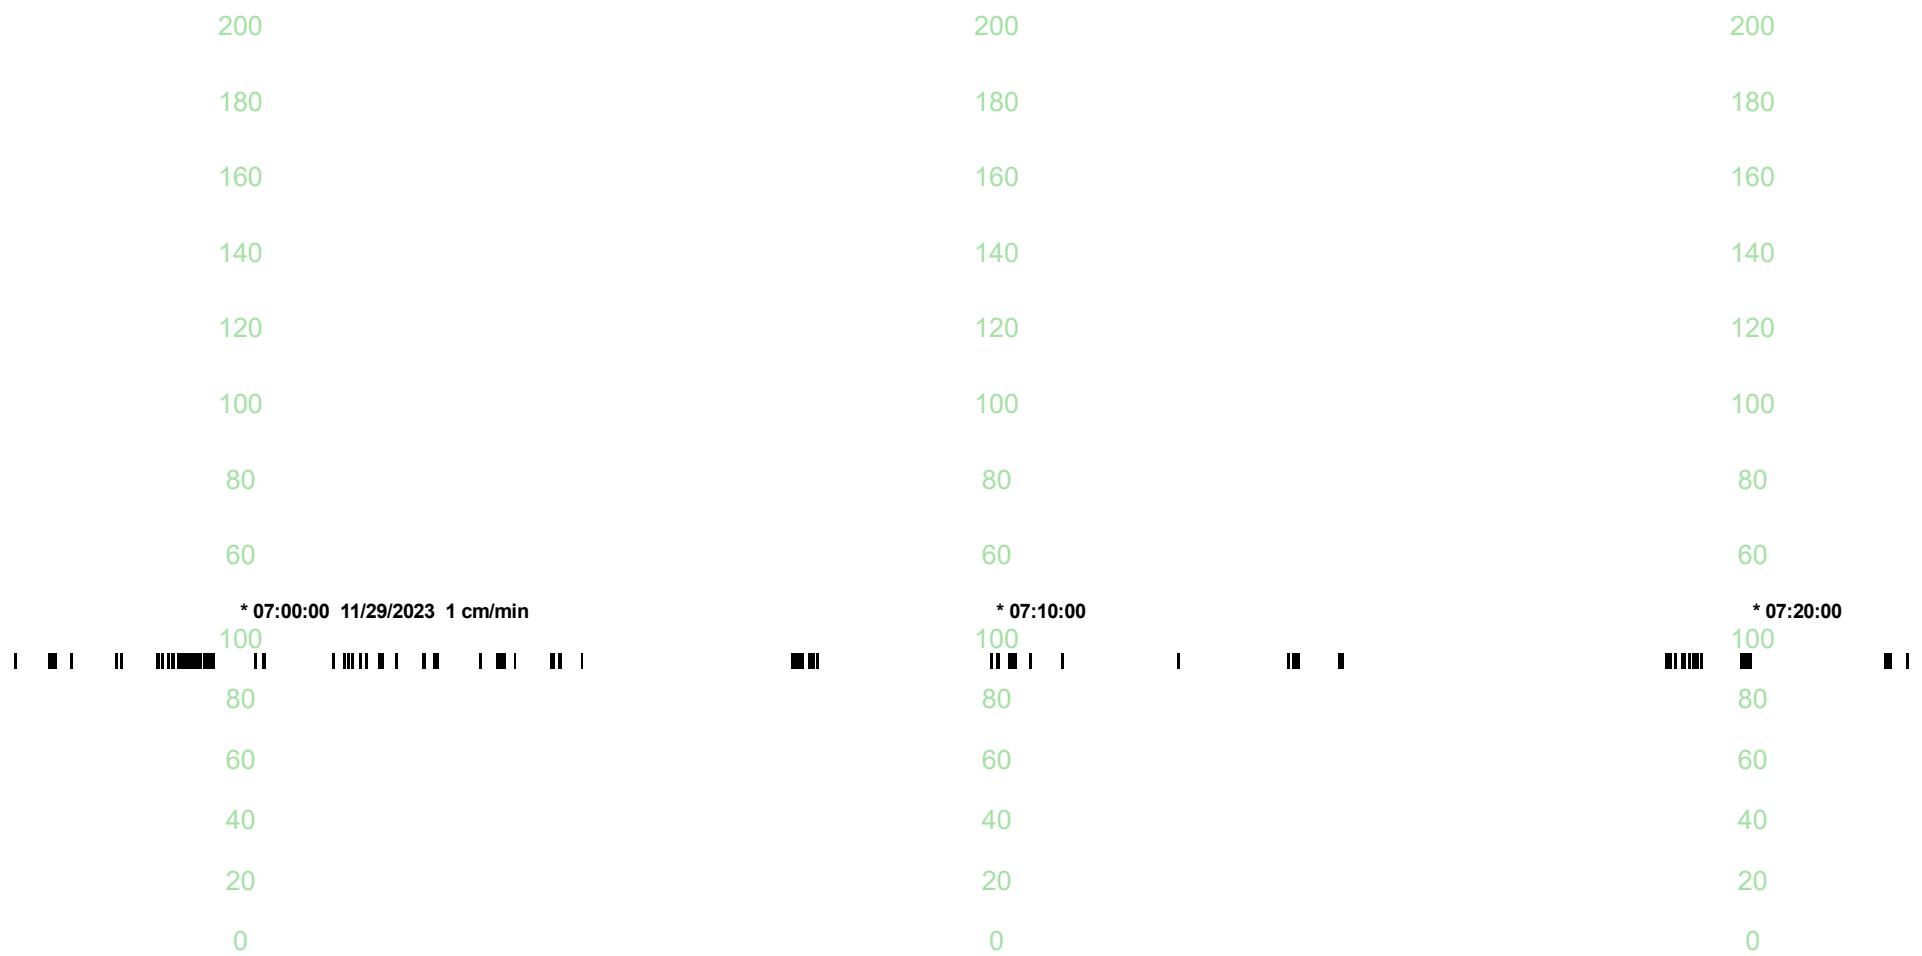

Estado del monitor: En espera  
Modo FCF1: no transductor  
Modo Toco : no transductor  
Estado del registrador: Desactivado  
Estado de la telemetría: Desactivado


\*FCF1: BRADICARDIA


Alarma con acuse de recibo

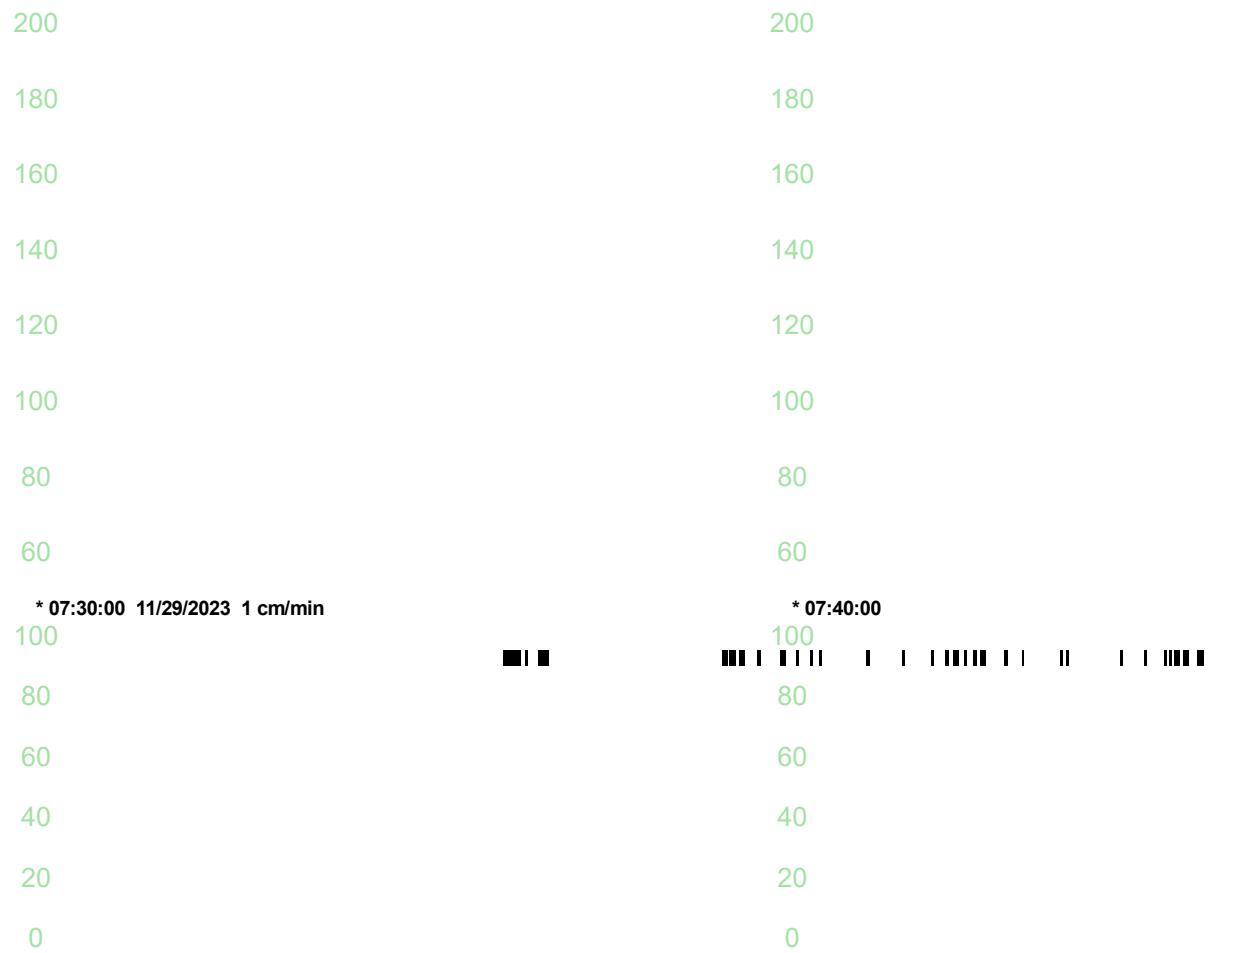


Estado del monitor: Activado  
Estado del registrador: Activado  
Estado de la telemetría: Activado  
Modo FCF1: US  
Estado del FMP: Activado  
Modo Toco: exterior


\* FCF1: PERDIDA SEÑAL  
Alarma con acuse de recibo

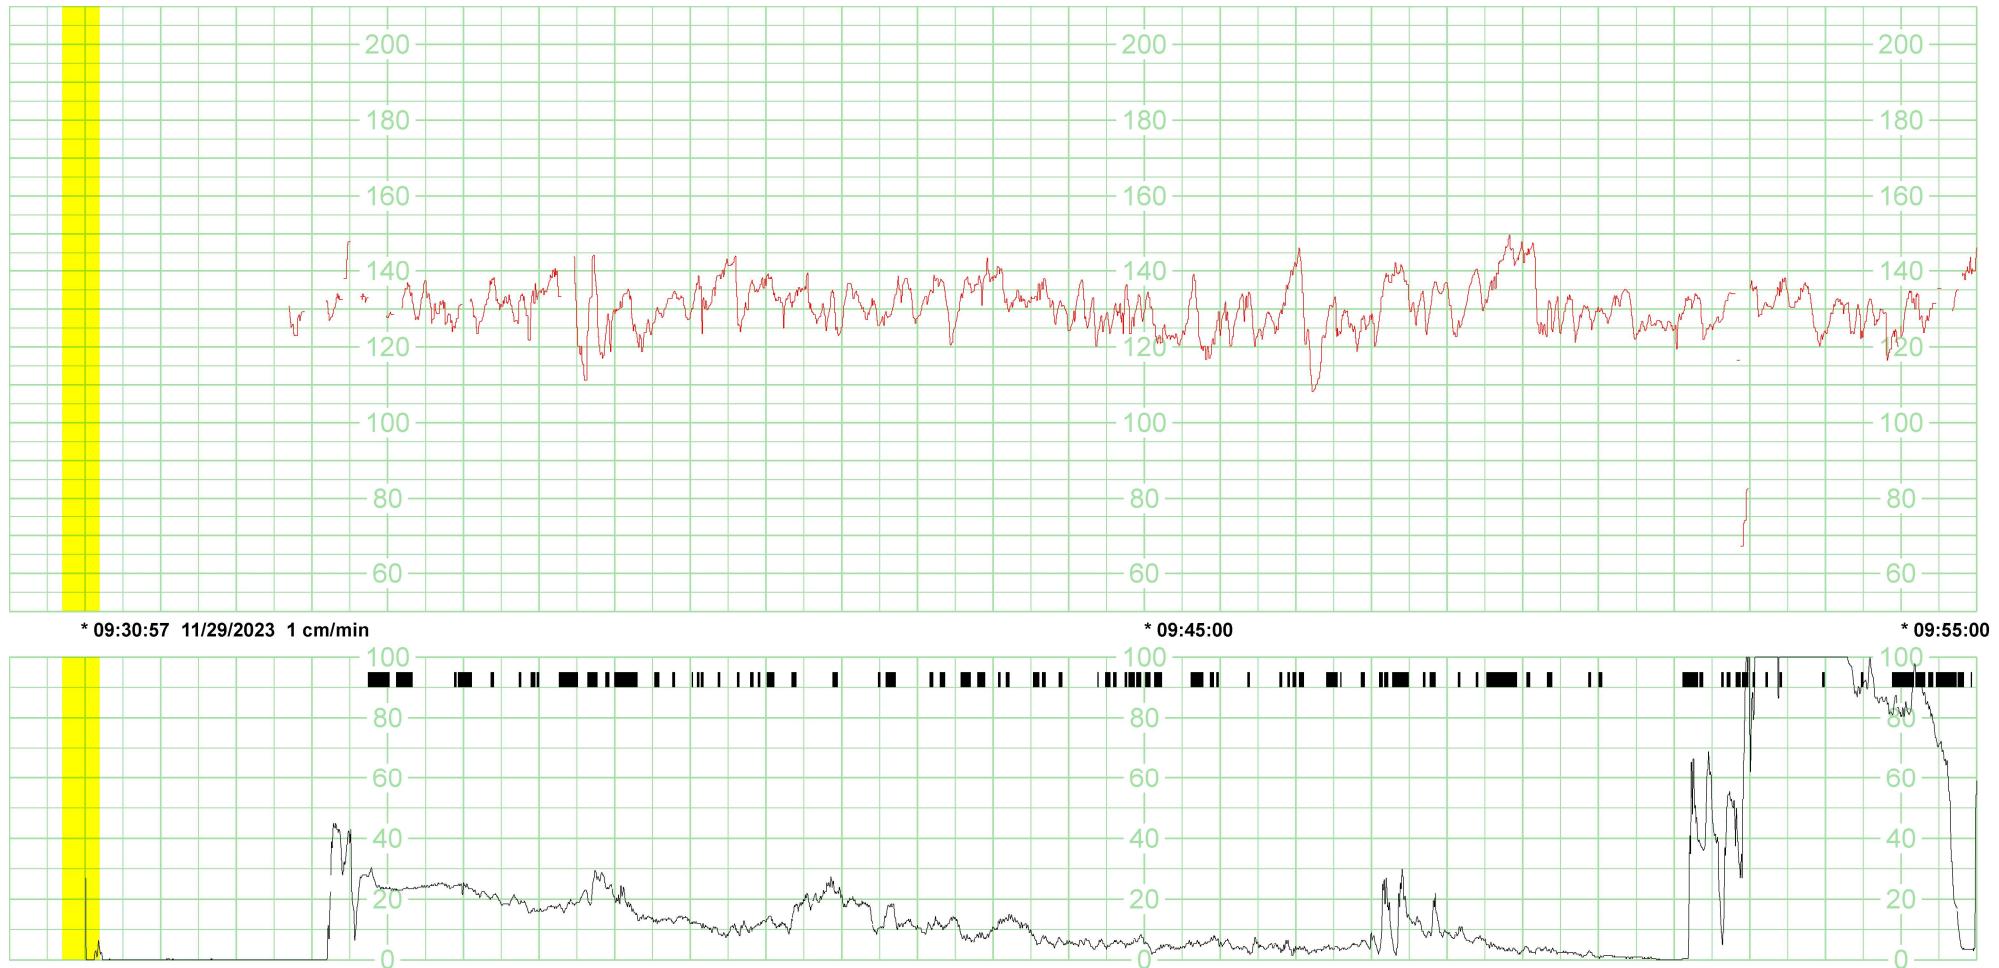


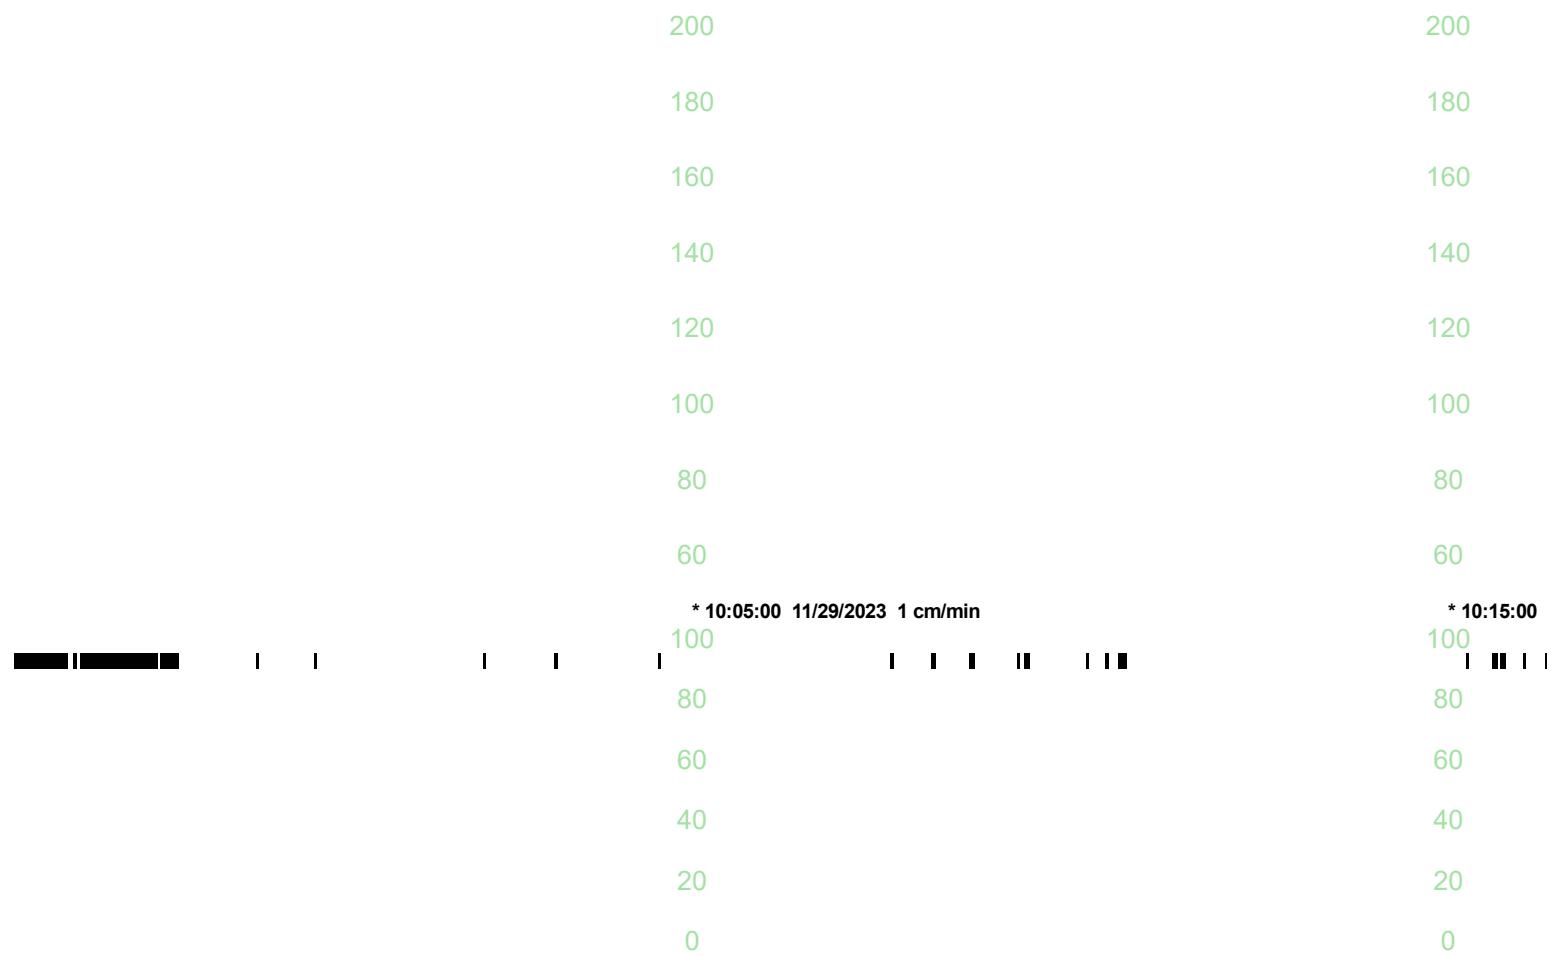

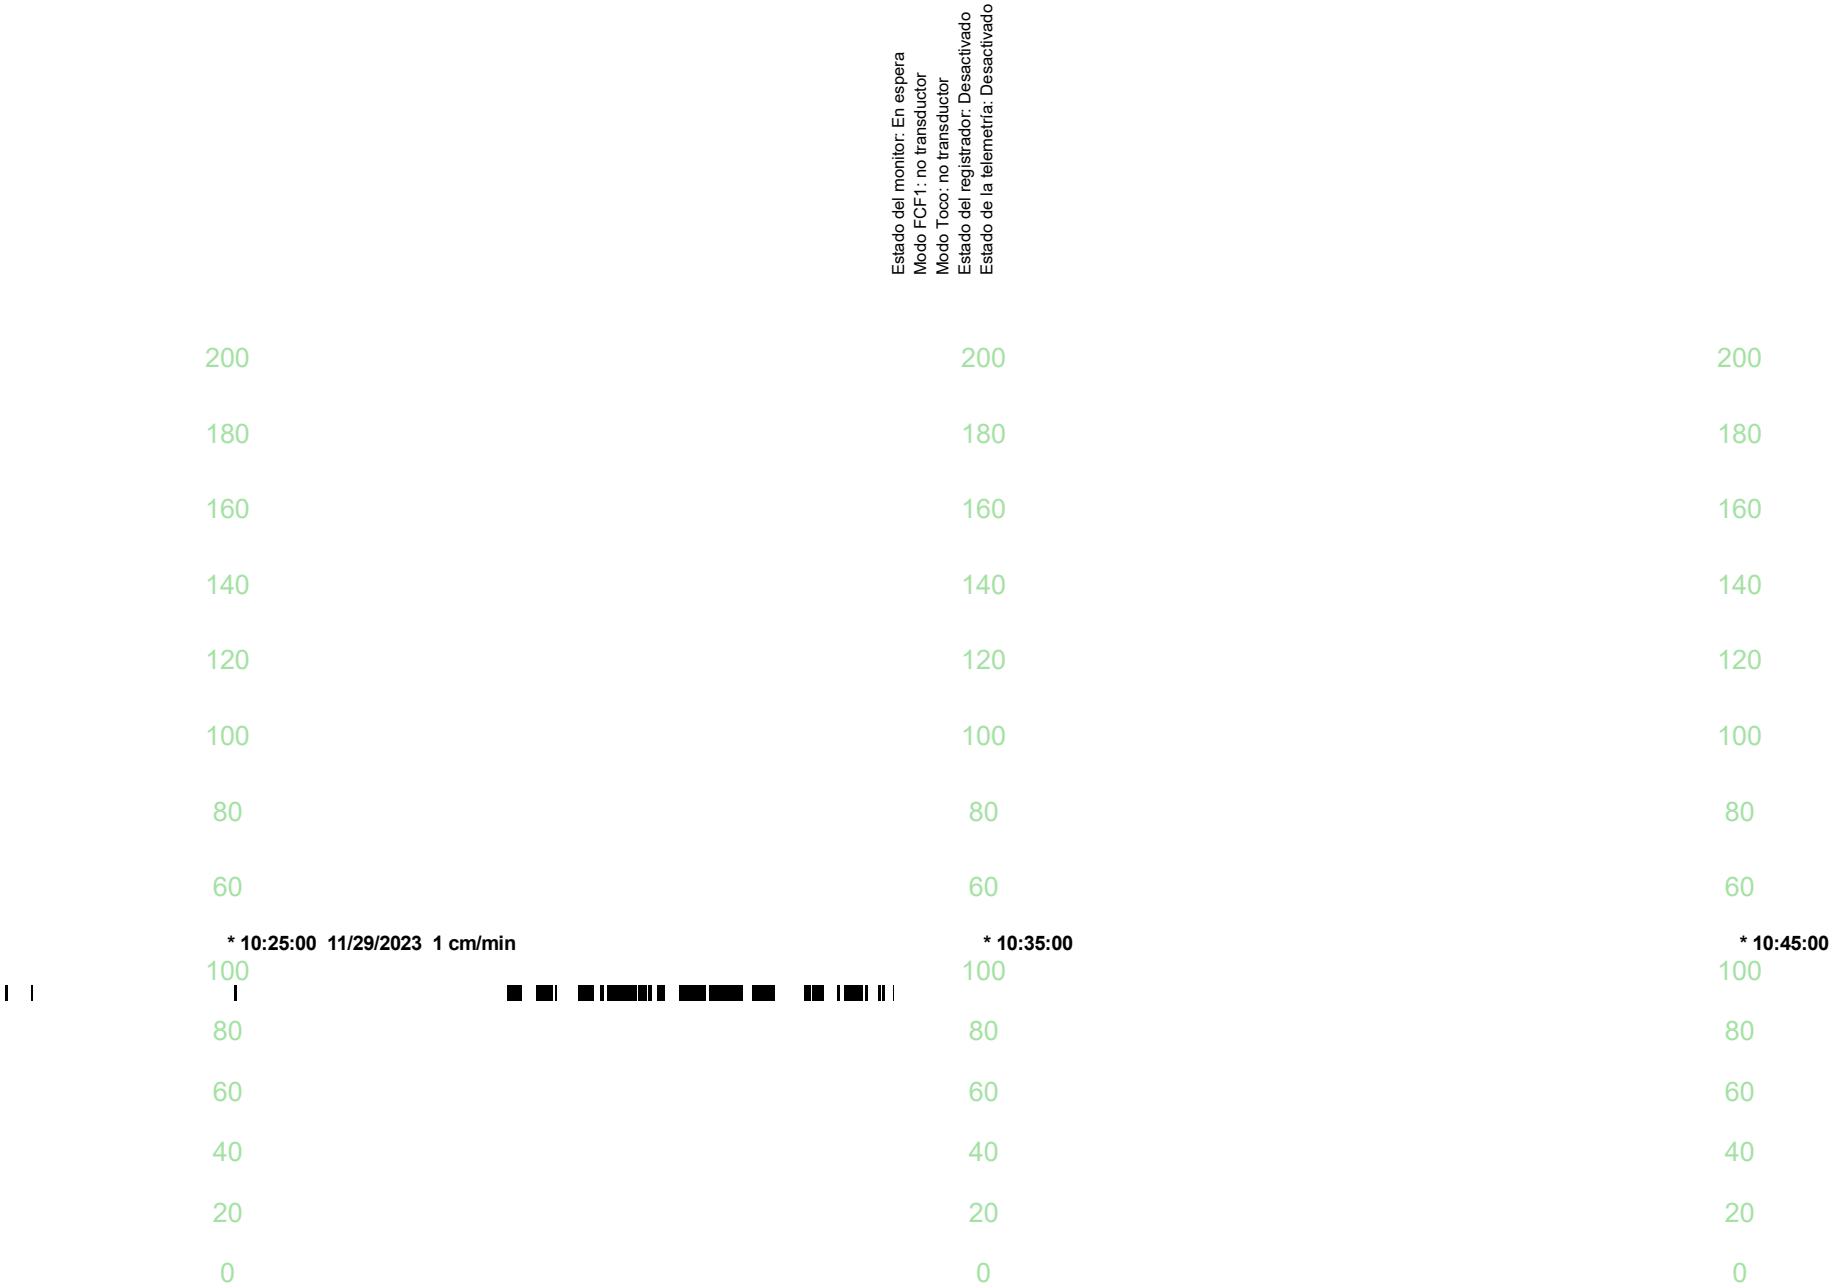


Estado del registrador: Activado  
Estado de la telemetría: Activado  
Modo FCF: US  
Estado del FMP: Activado  
Modo Toco: externo

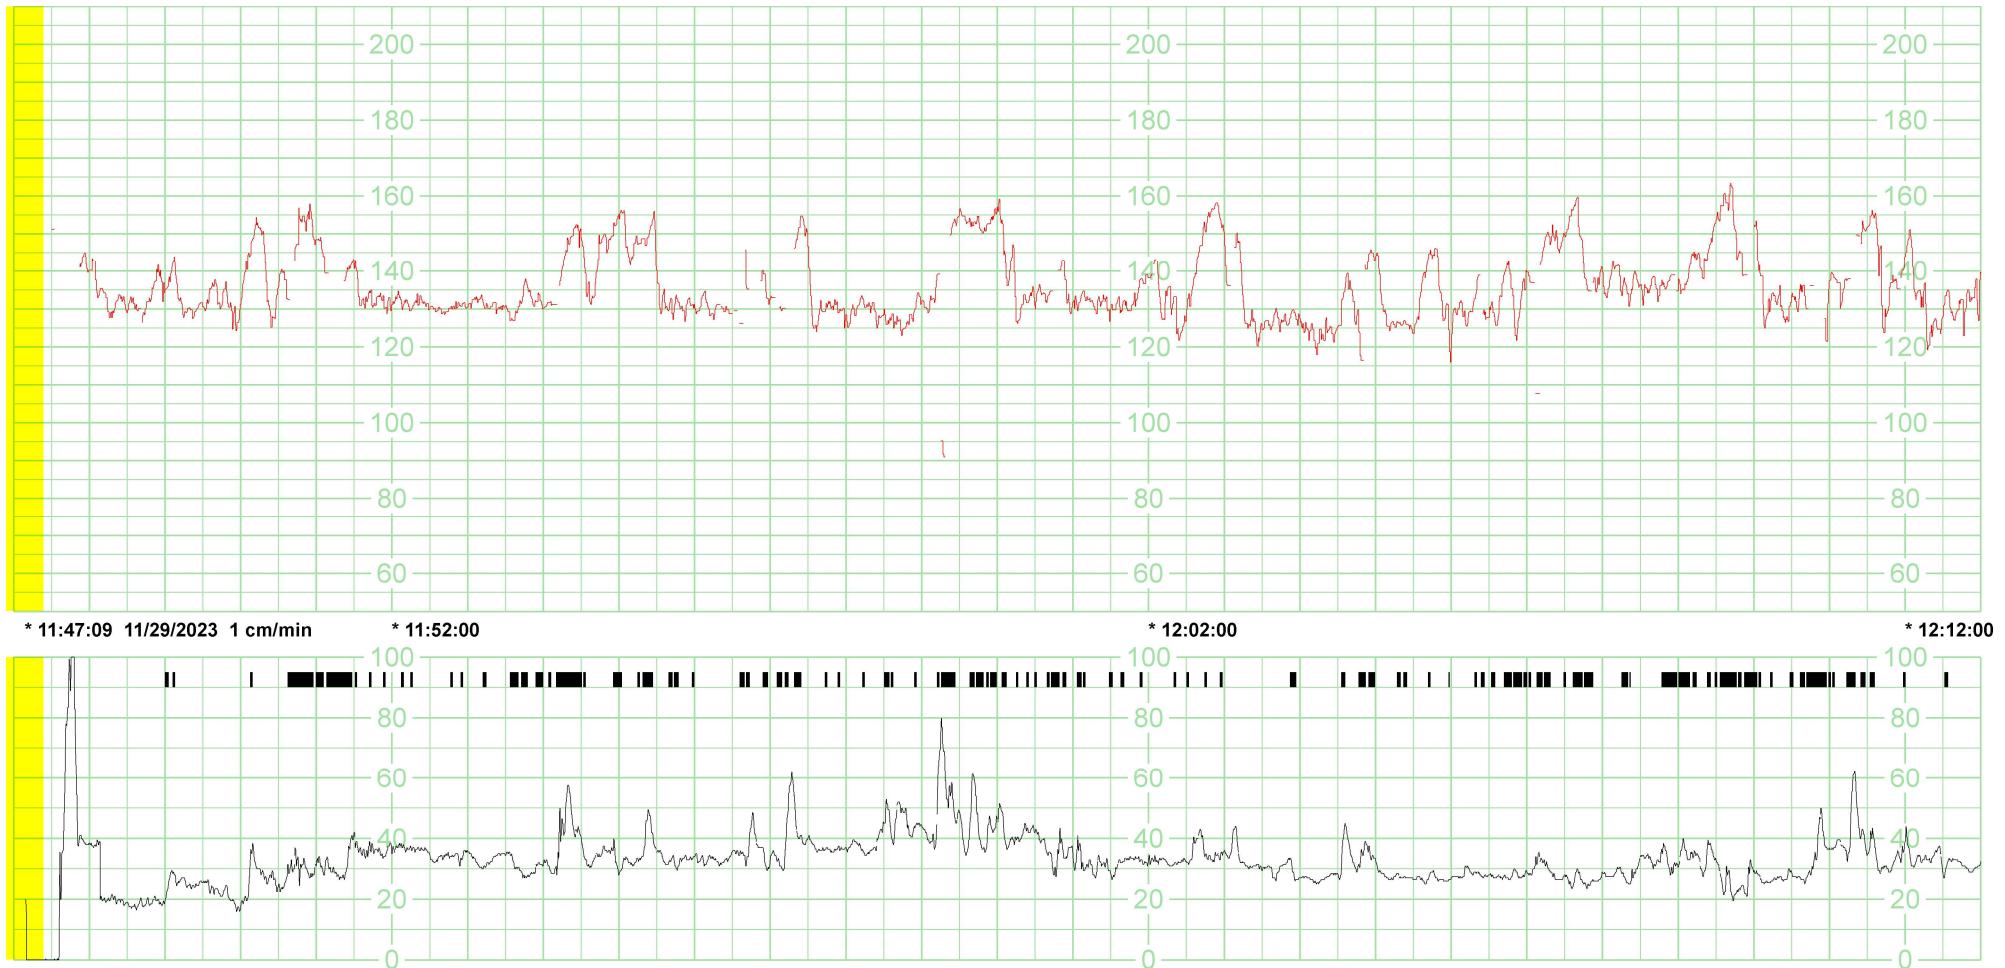

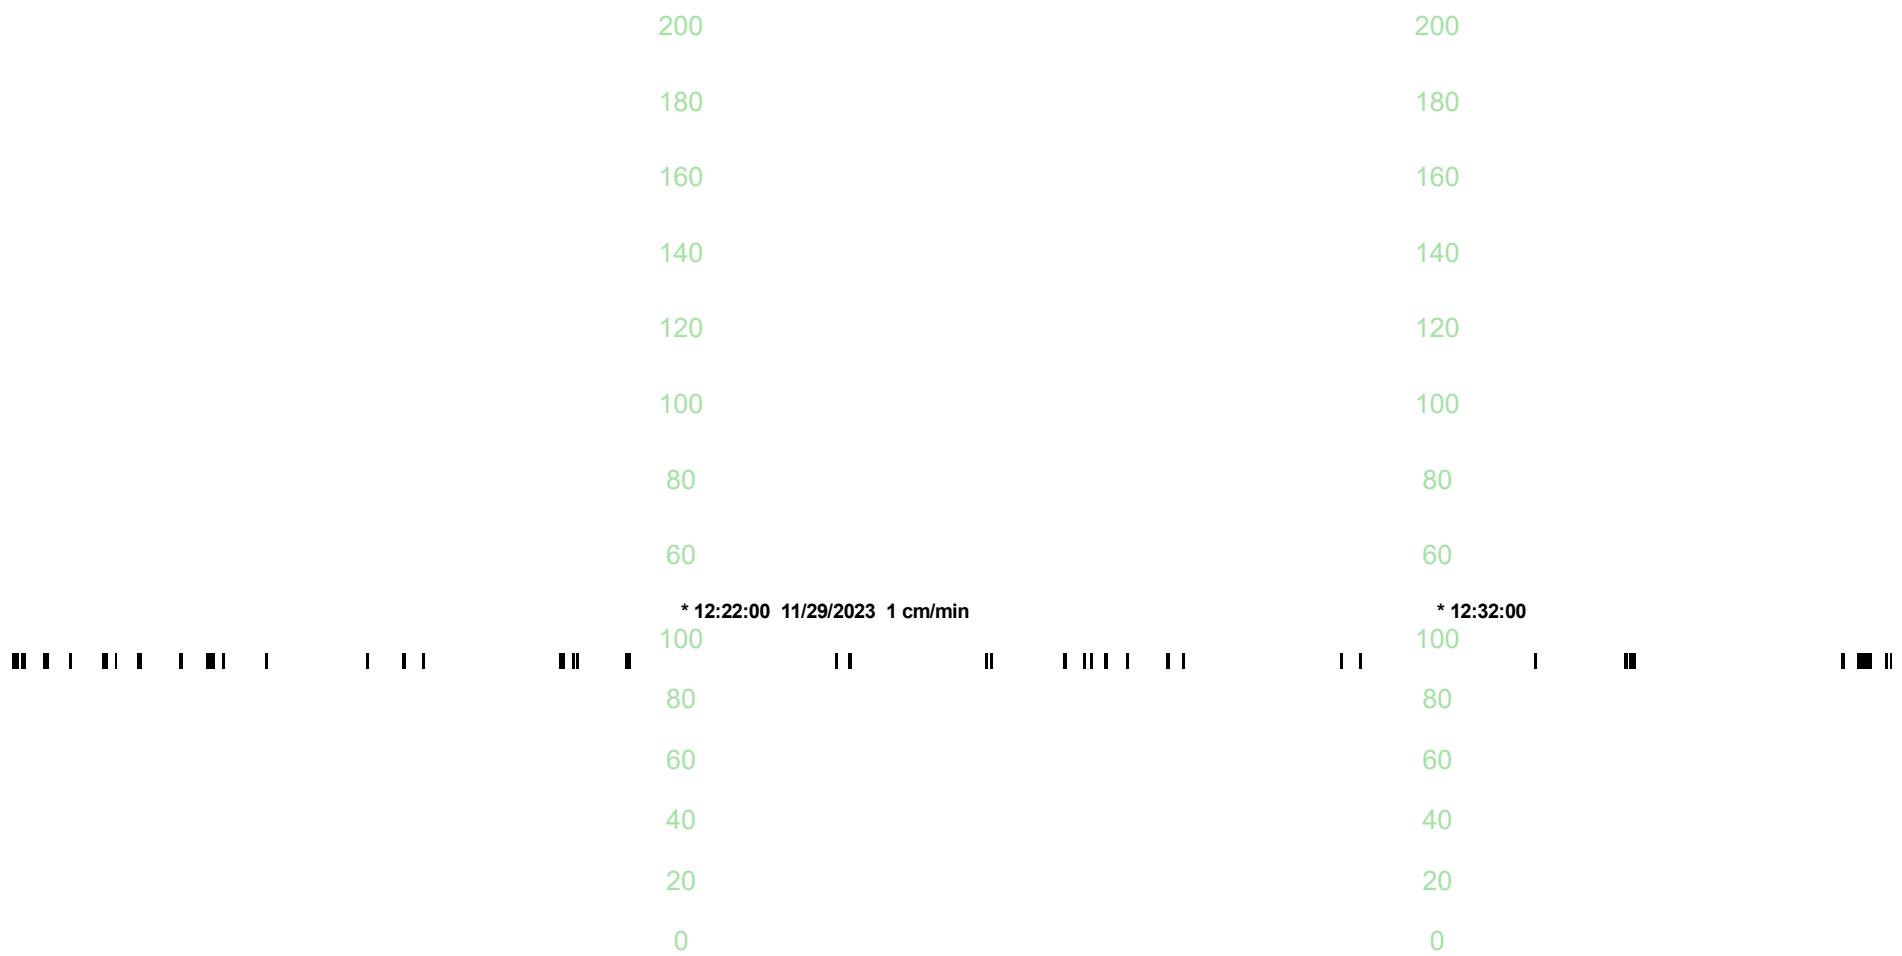

\* FCF1: PERDIDA SEÑAL

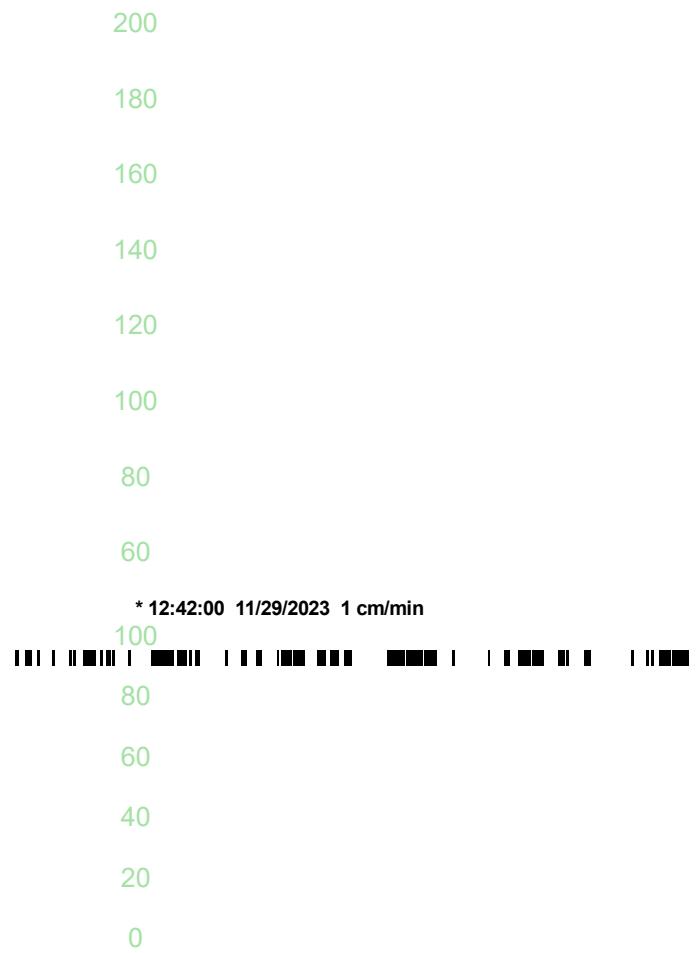


\*\* FCF1: PERDIDA SEÑAL


\* FCF1: PERDIDA SEÑAL


\*\* FCF1: PERDIDA SEÑAL

Alarma con acuse de recibo


\* FCF1: PERDIDA SEÑAL

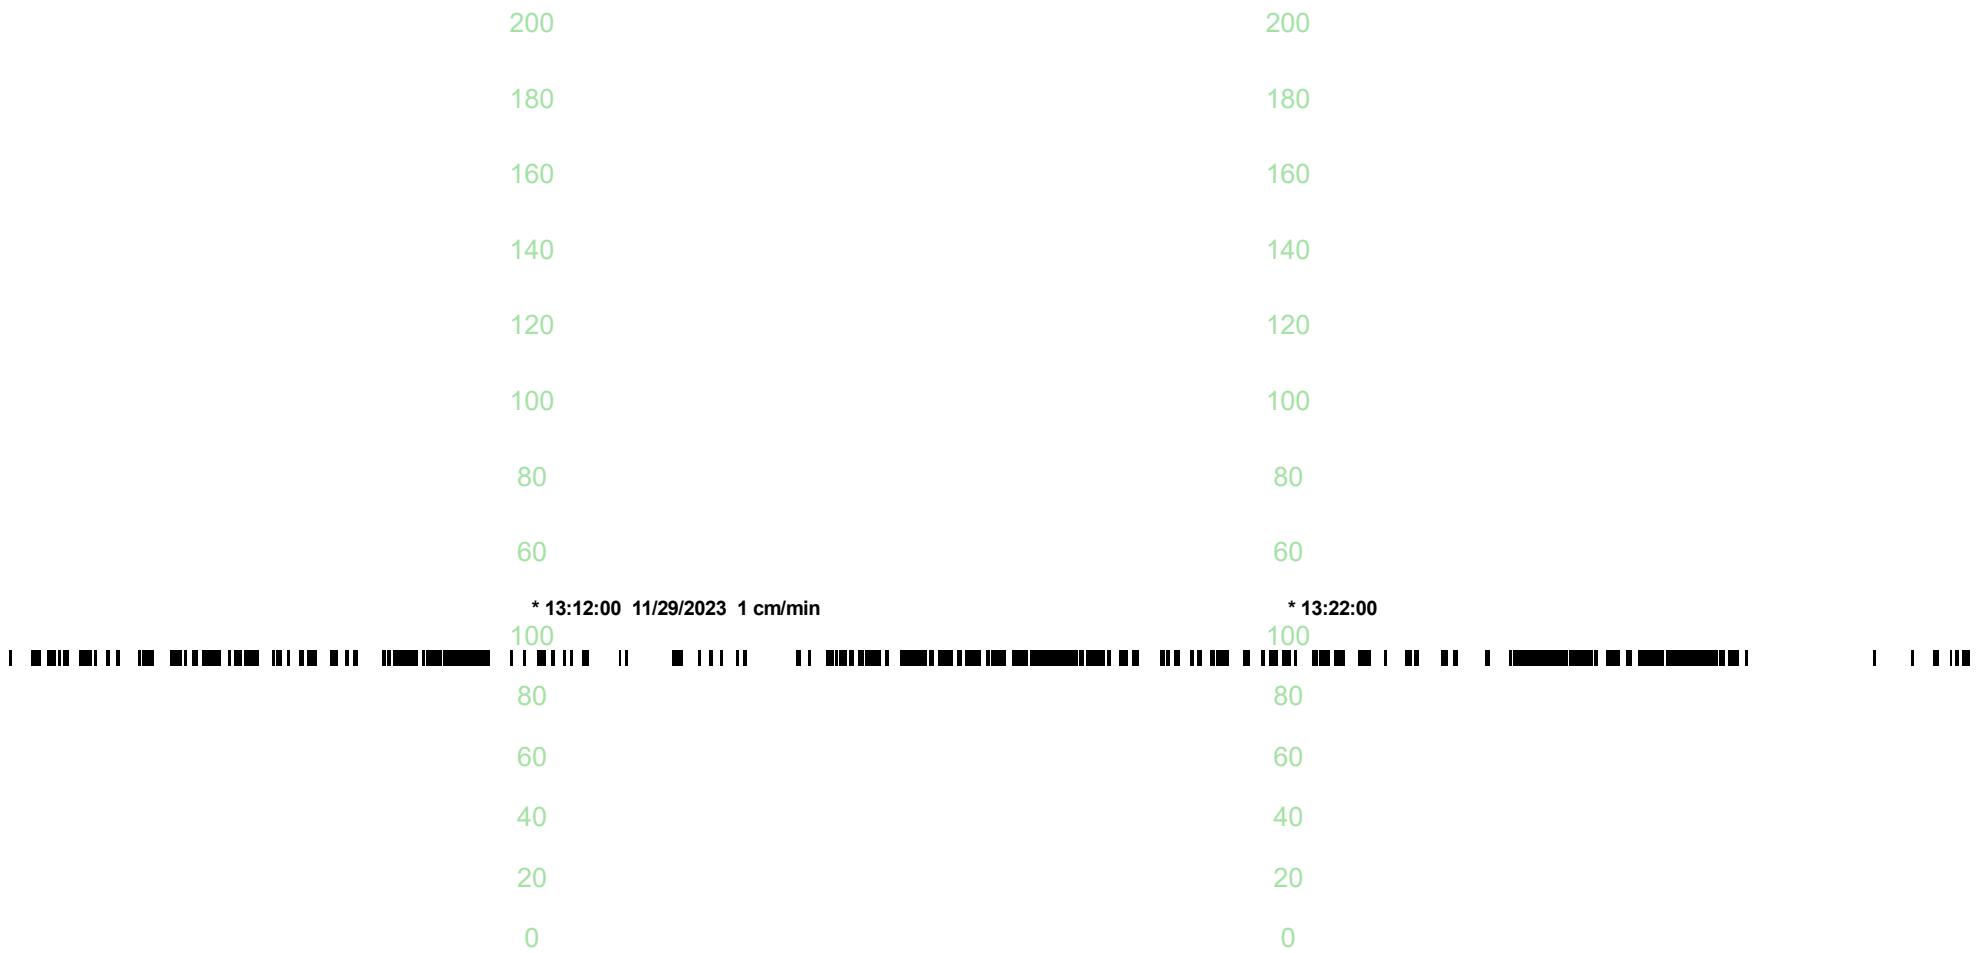


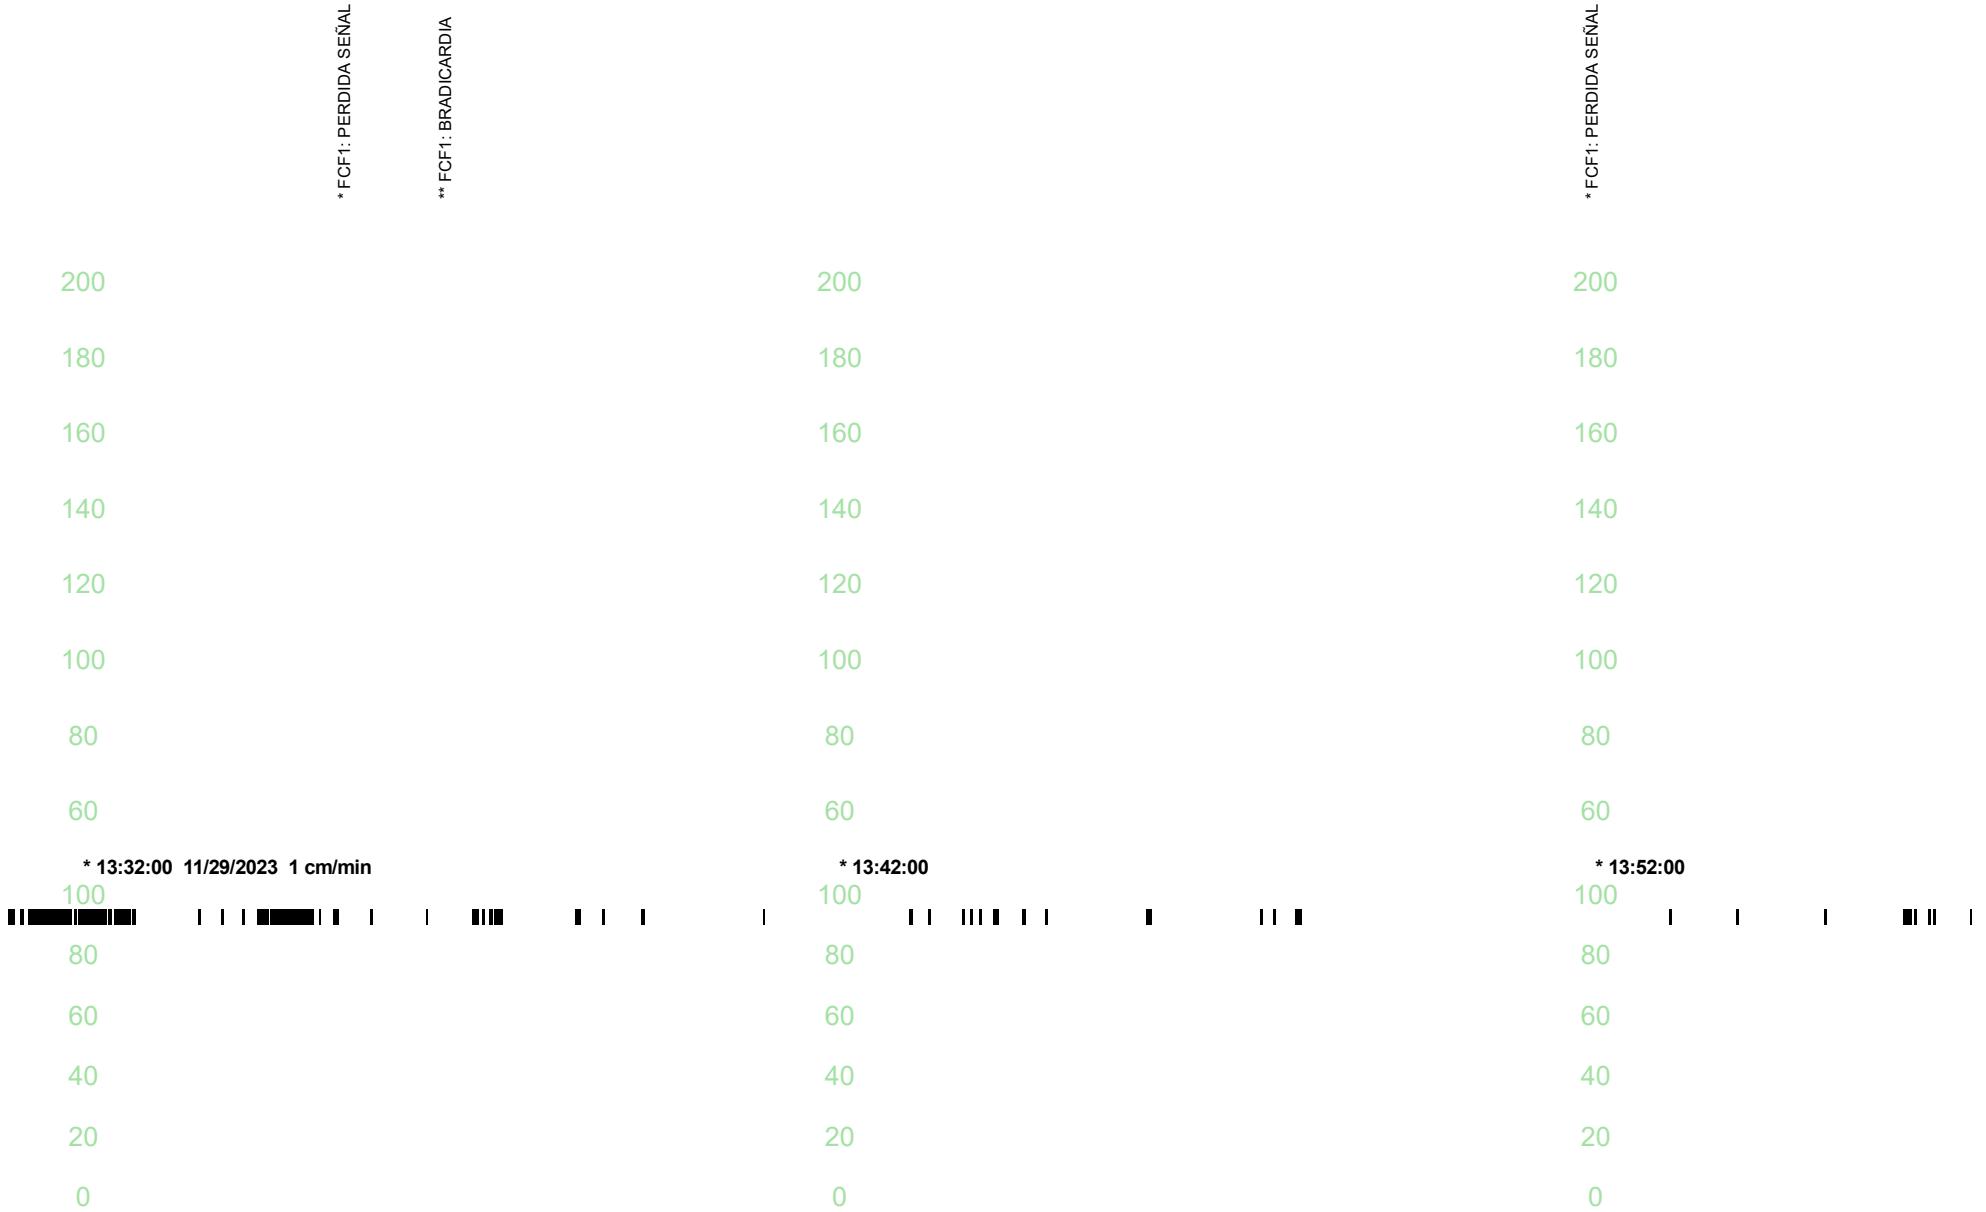


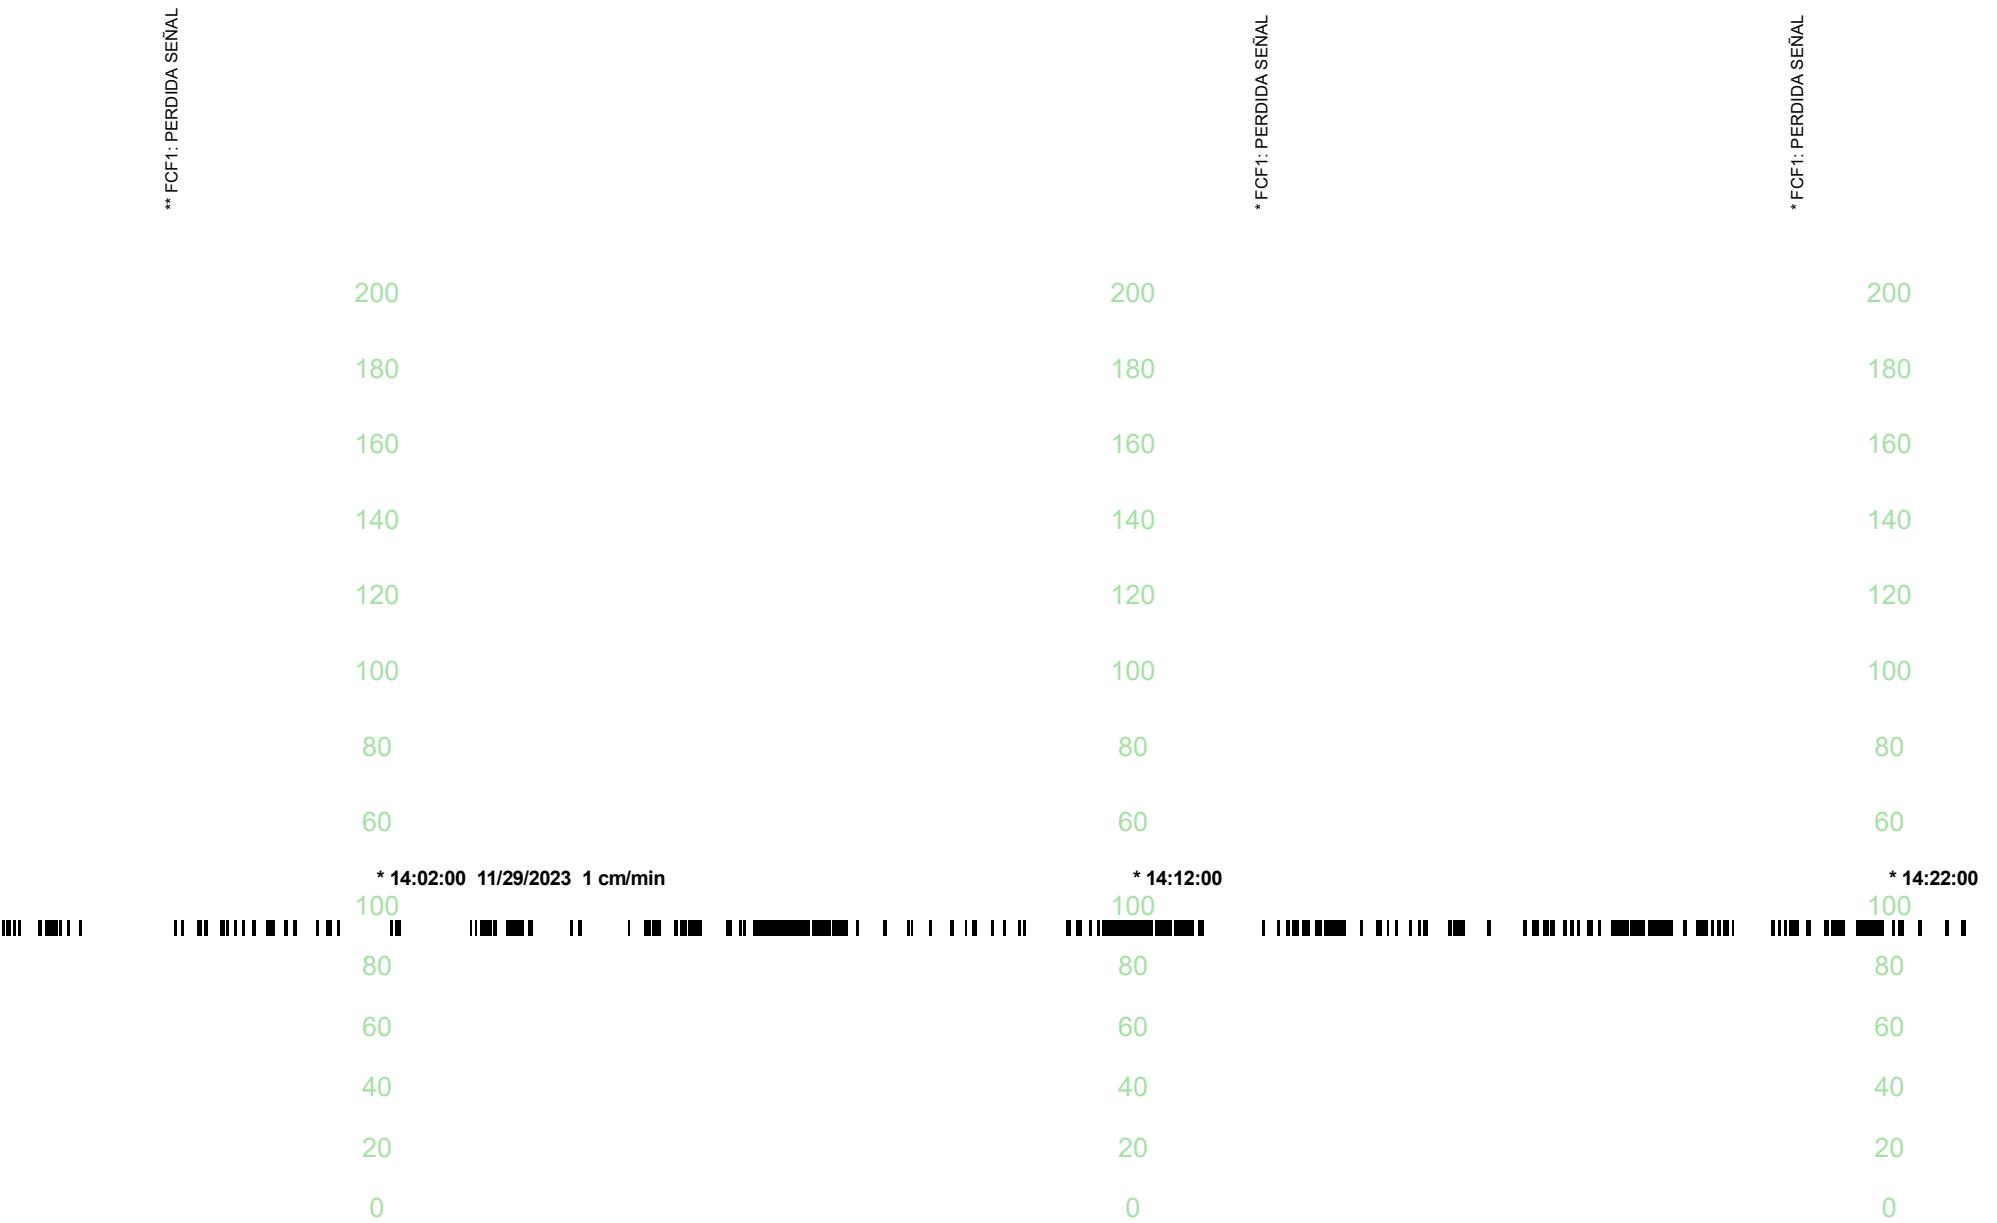

\* FCF1: PERDIDA SEÑAL

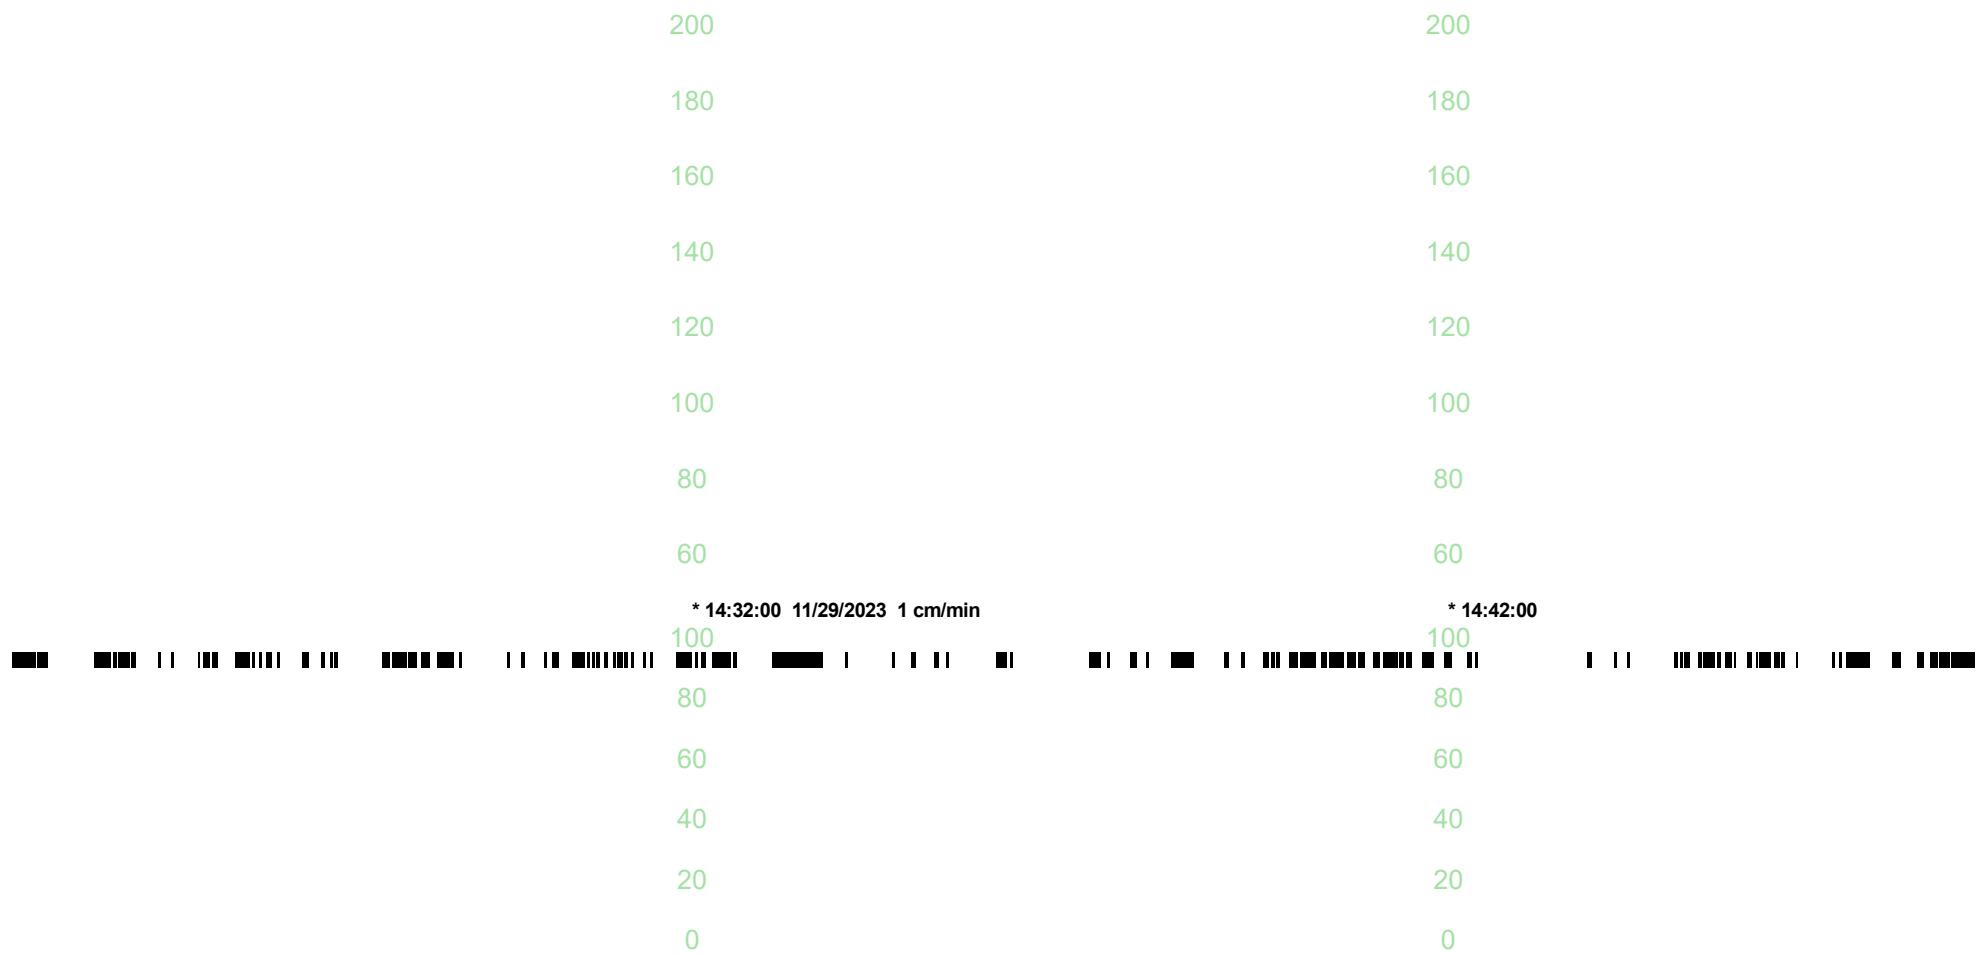


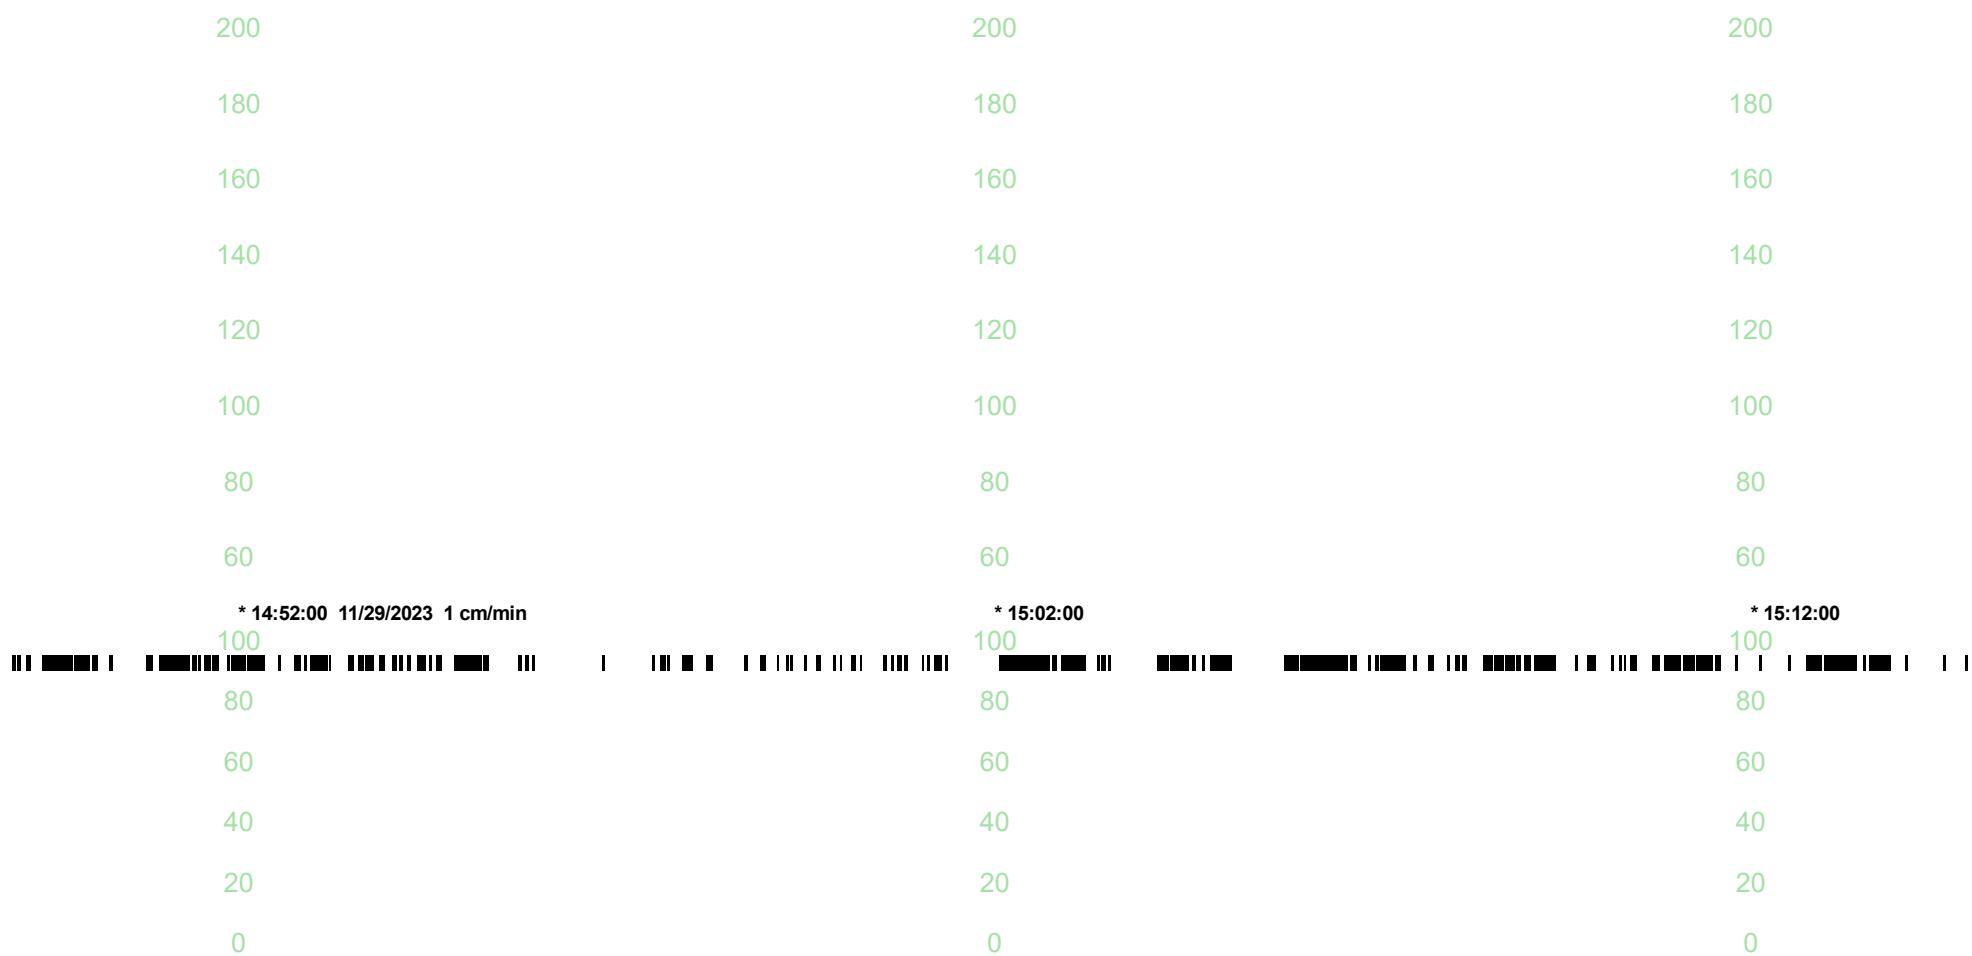


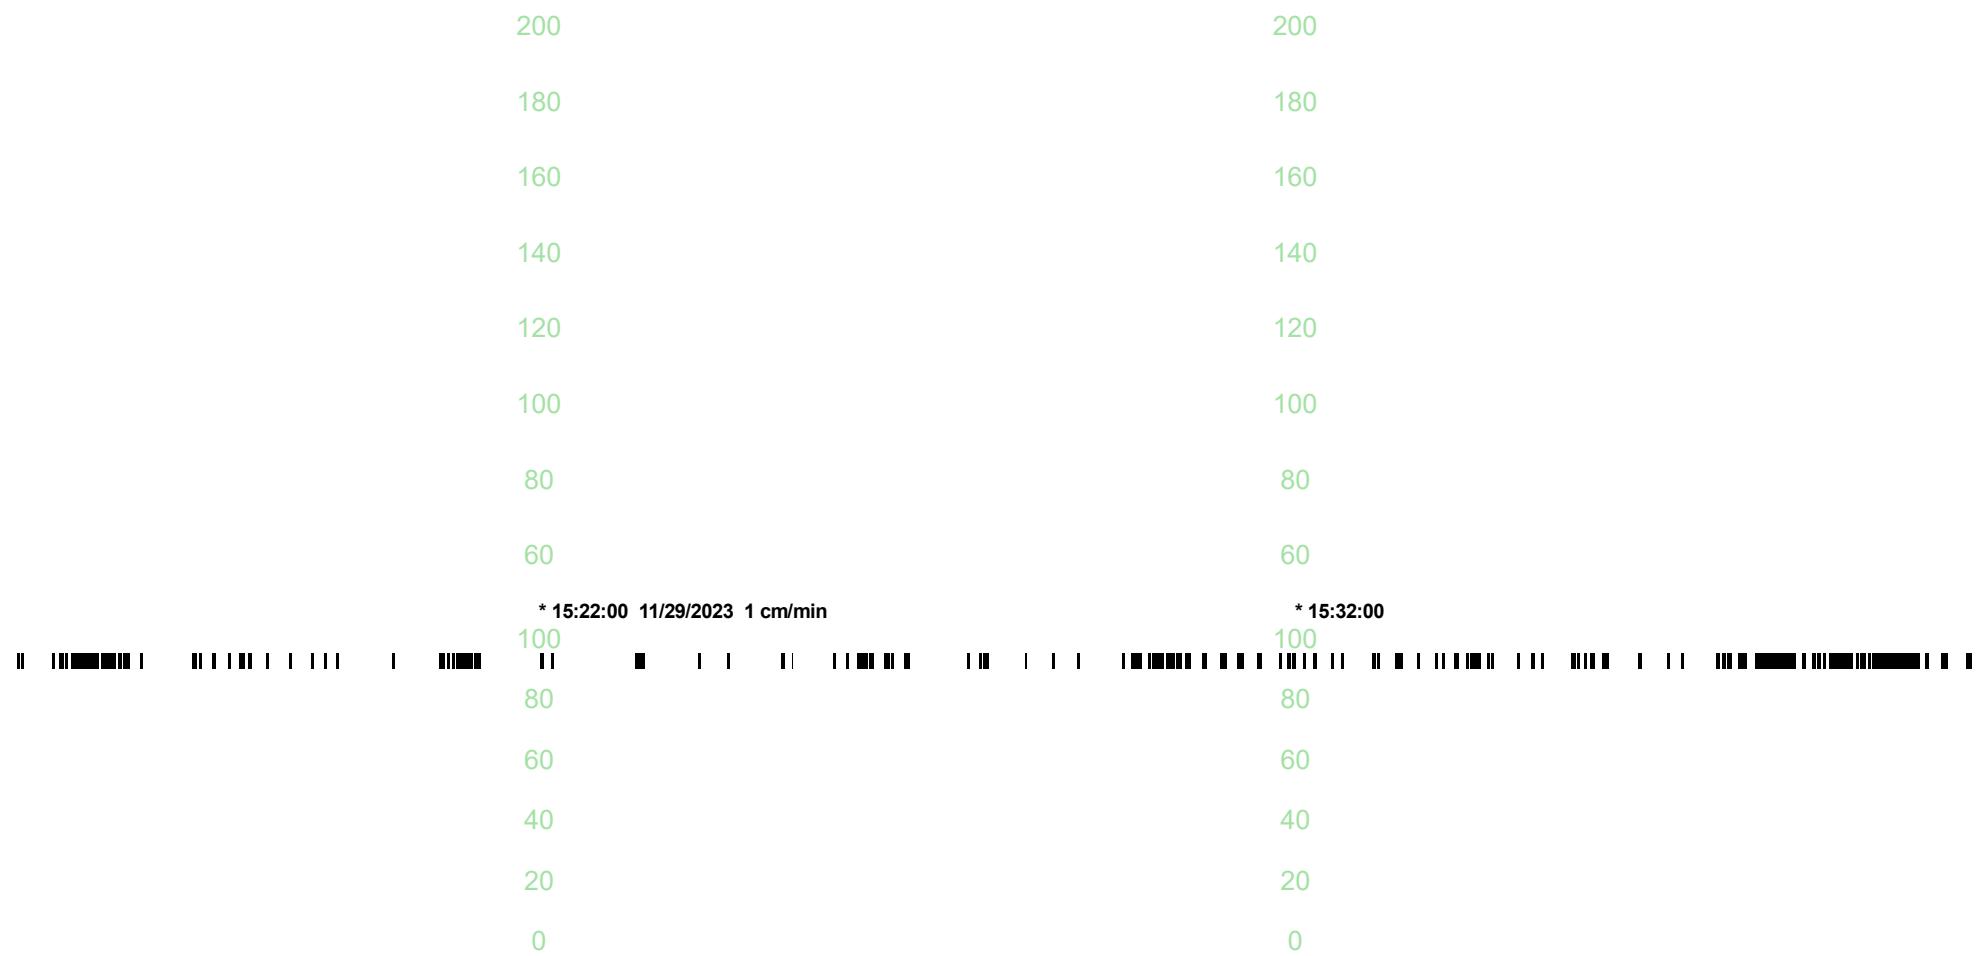



\* FIN DEL PAPEL  
Estado del papel: Sin papel  
Estado del registrador: Desactivado


Estado del papel: Papel disponible

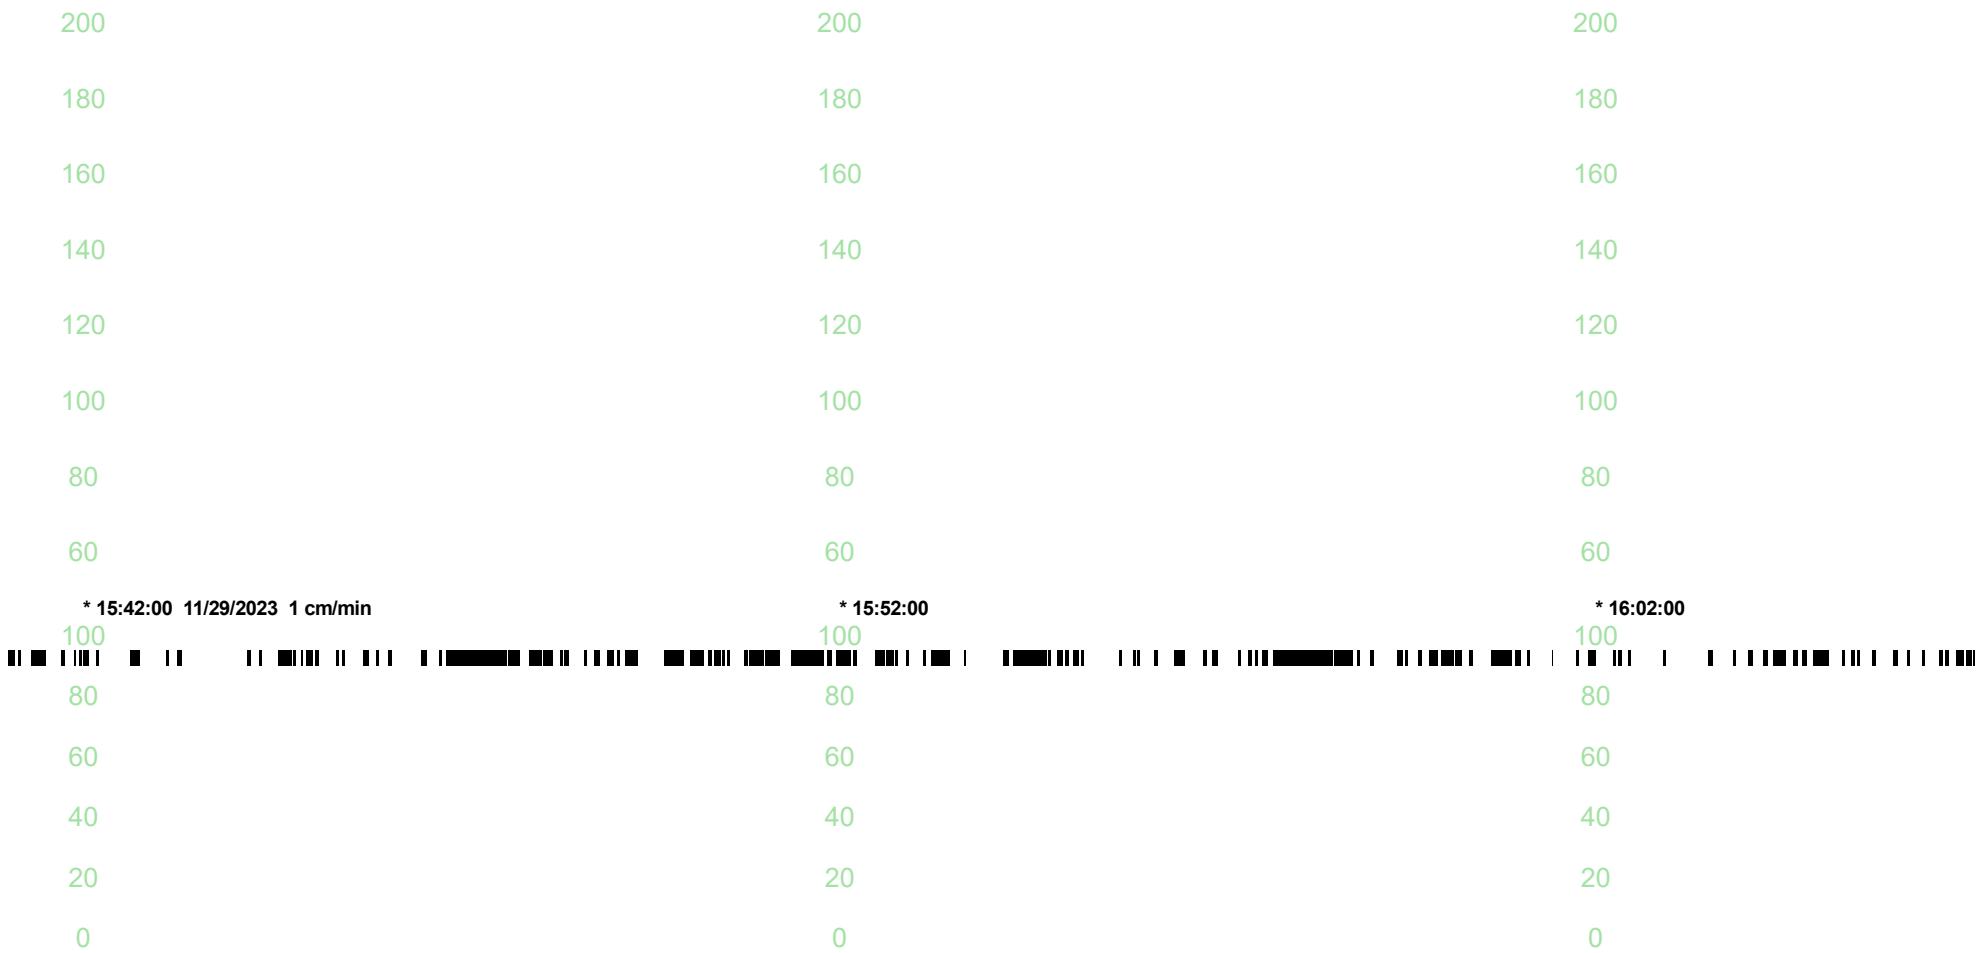


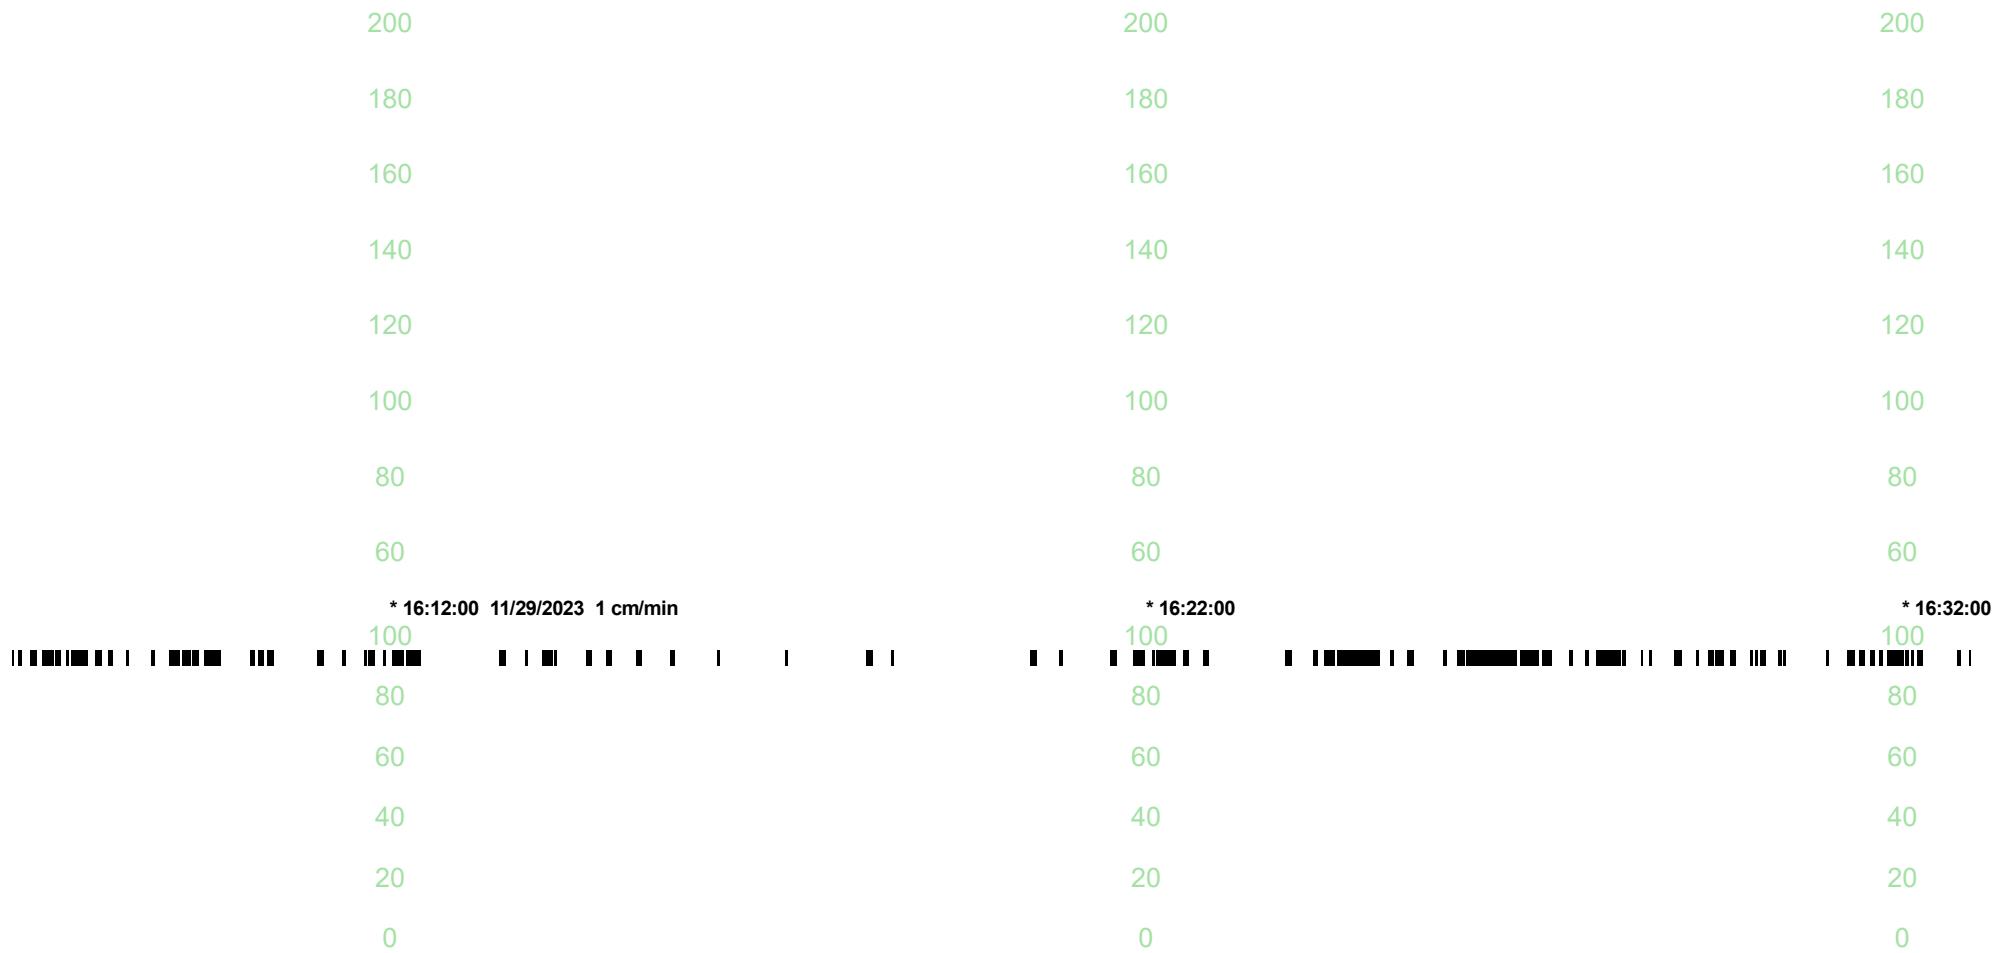


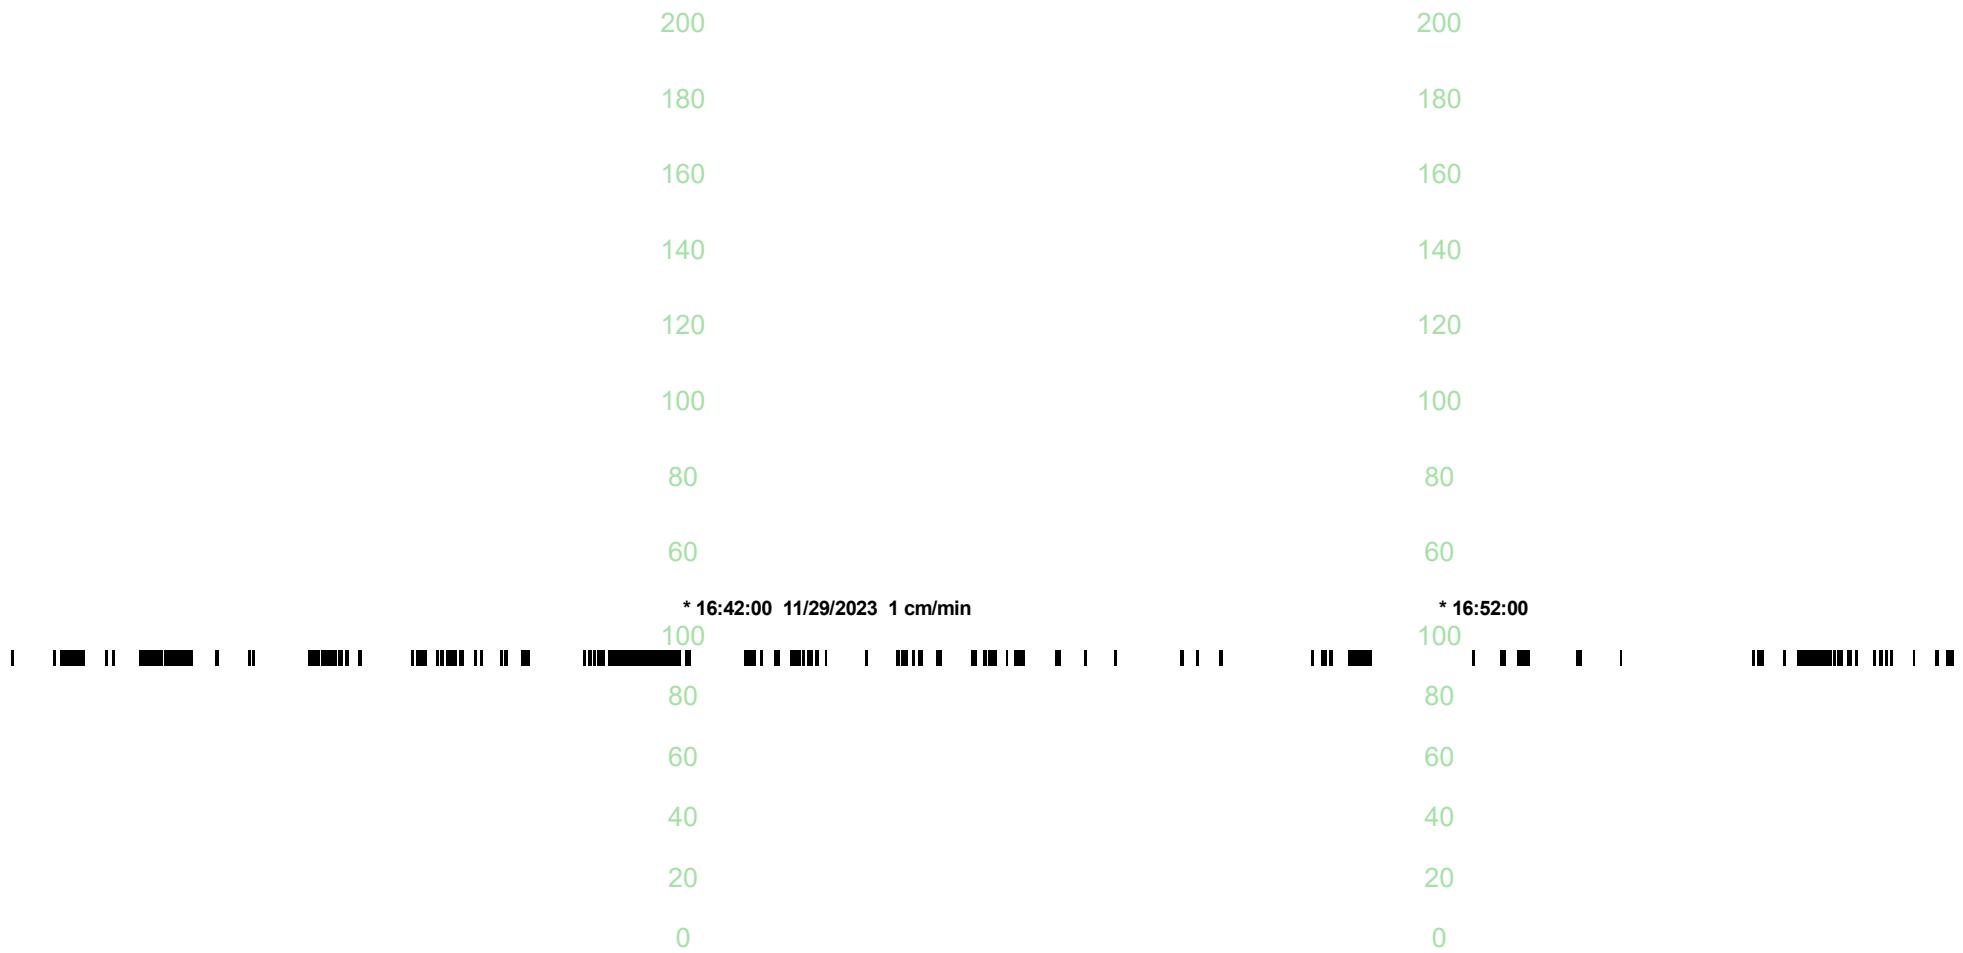


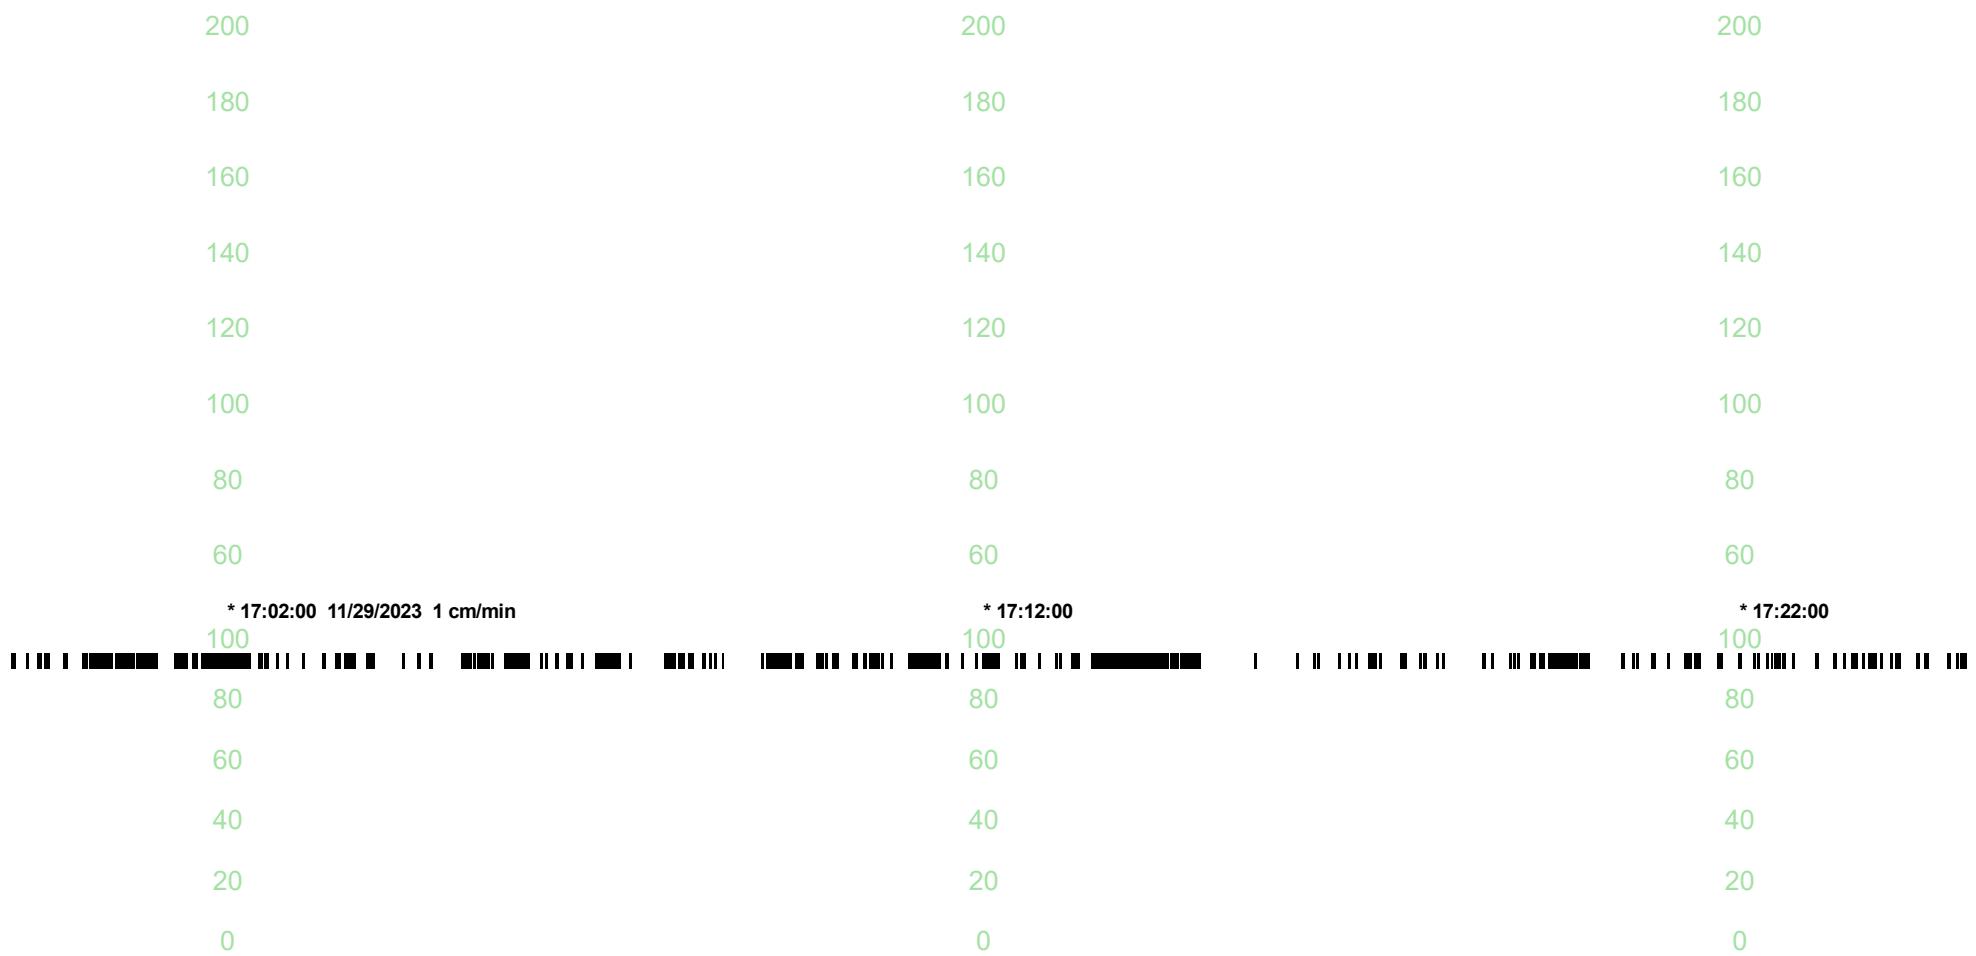


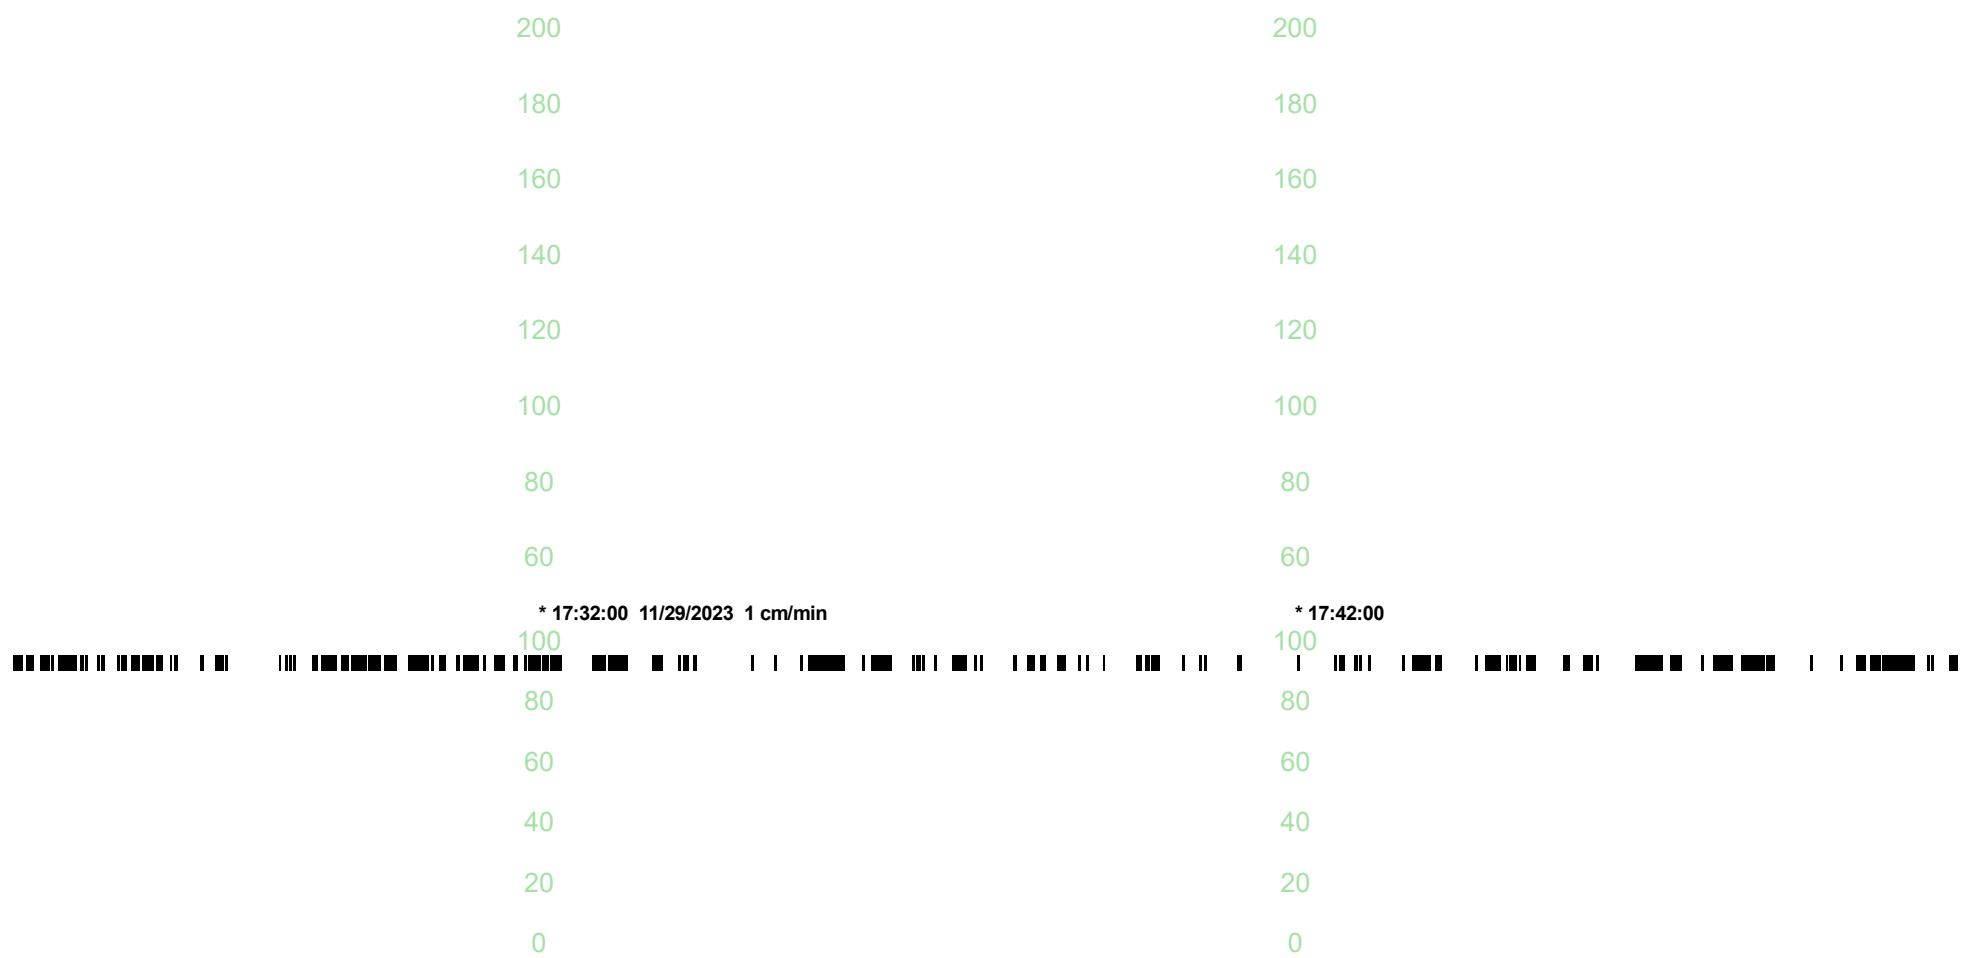

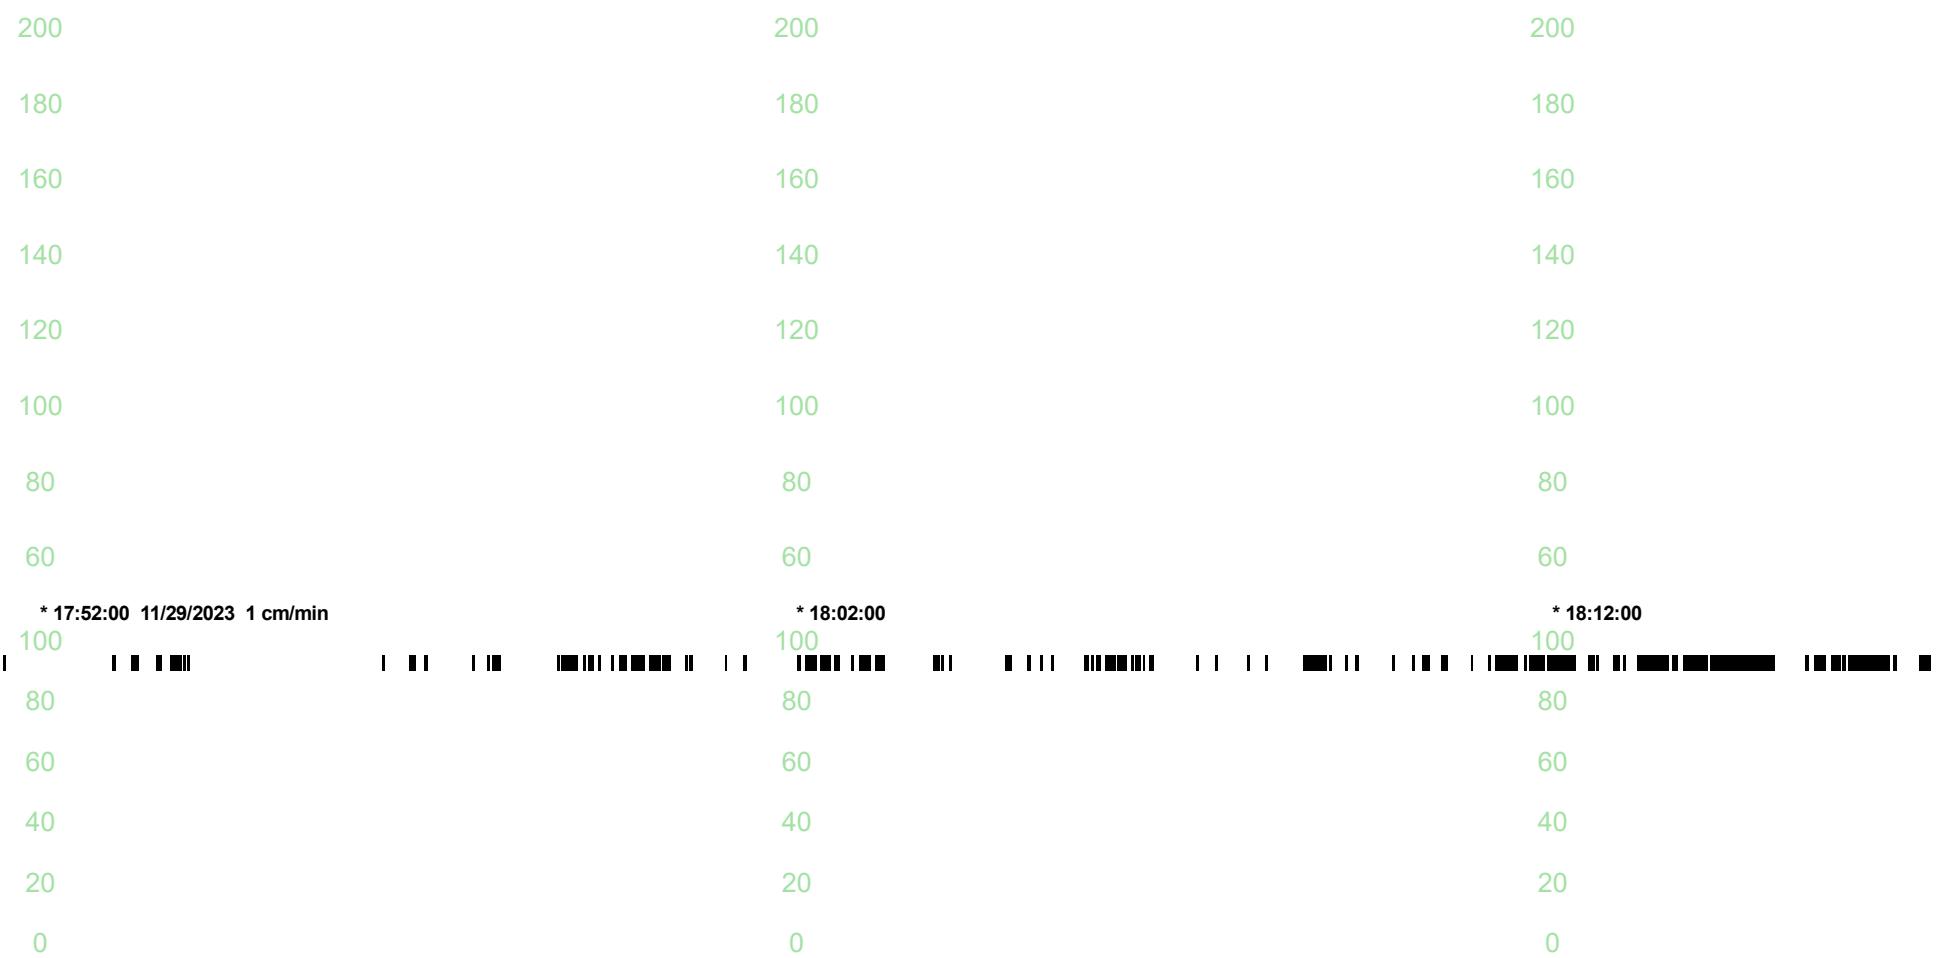

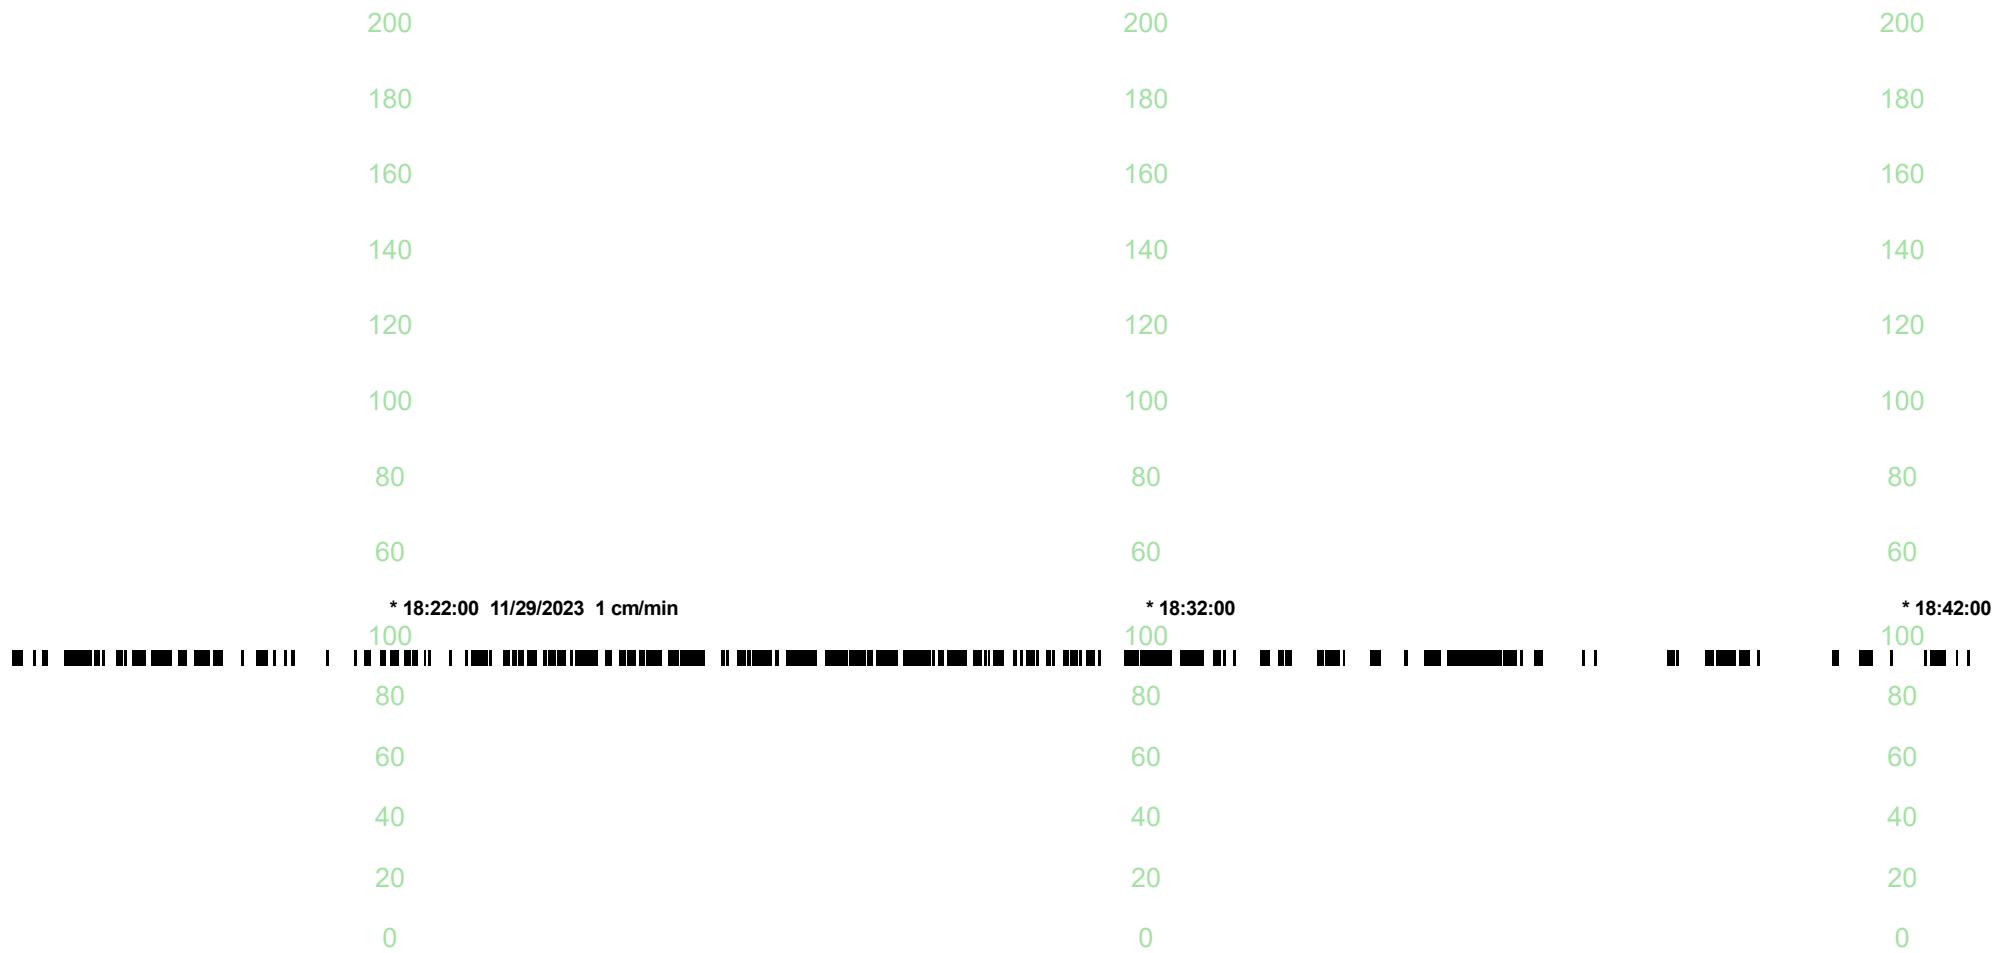

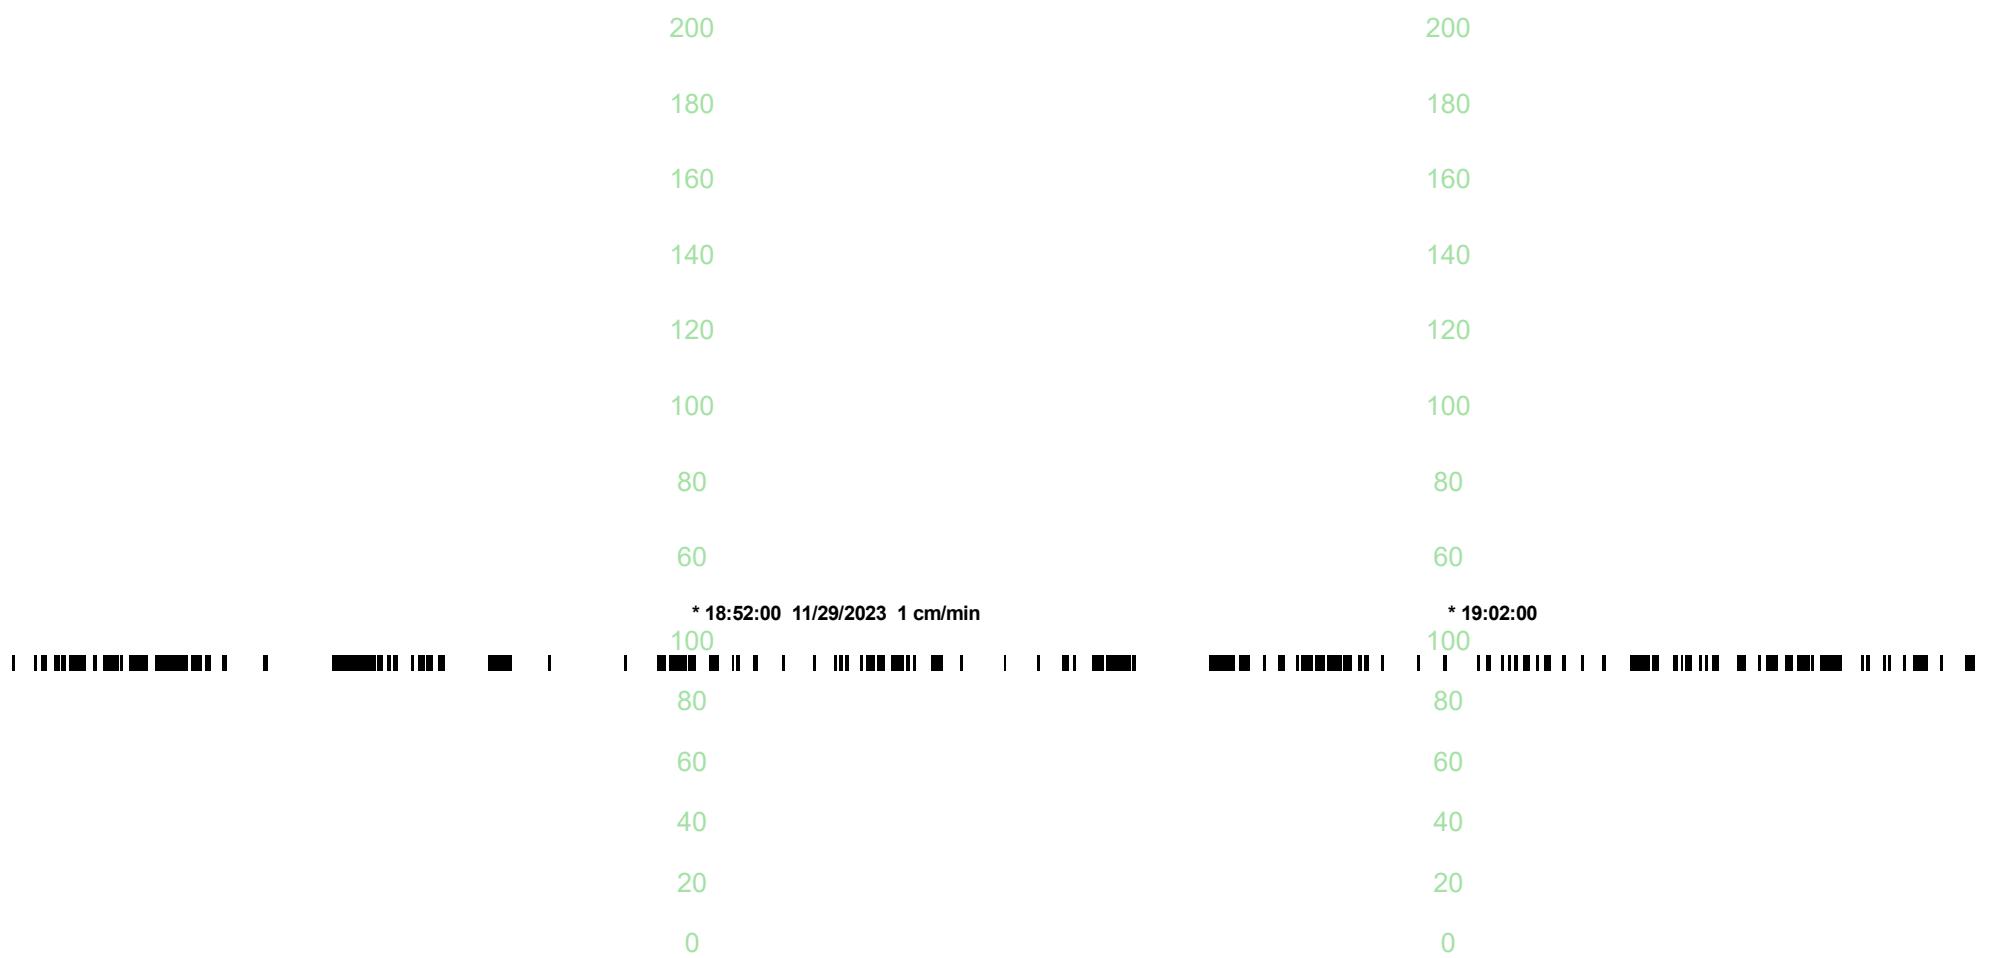

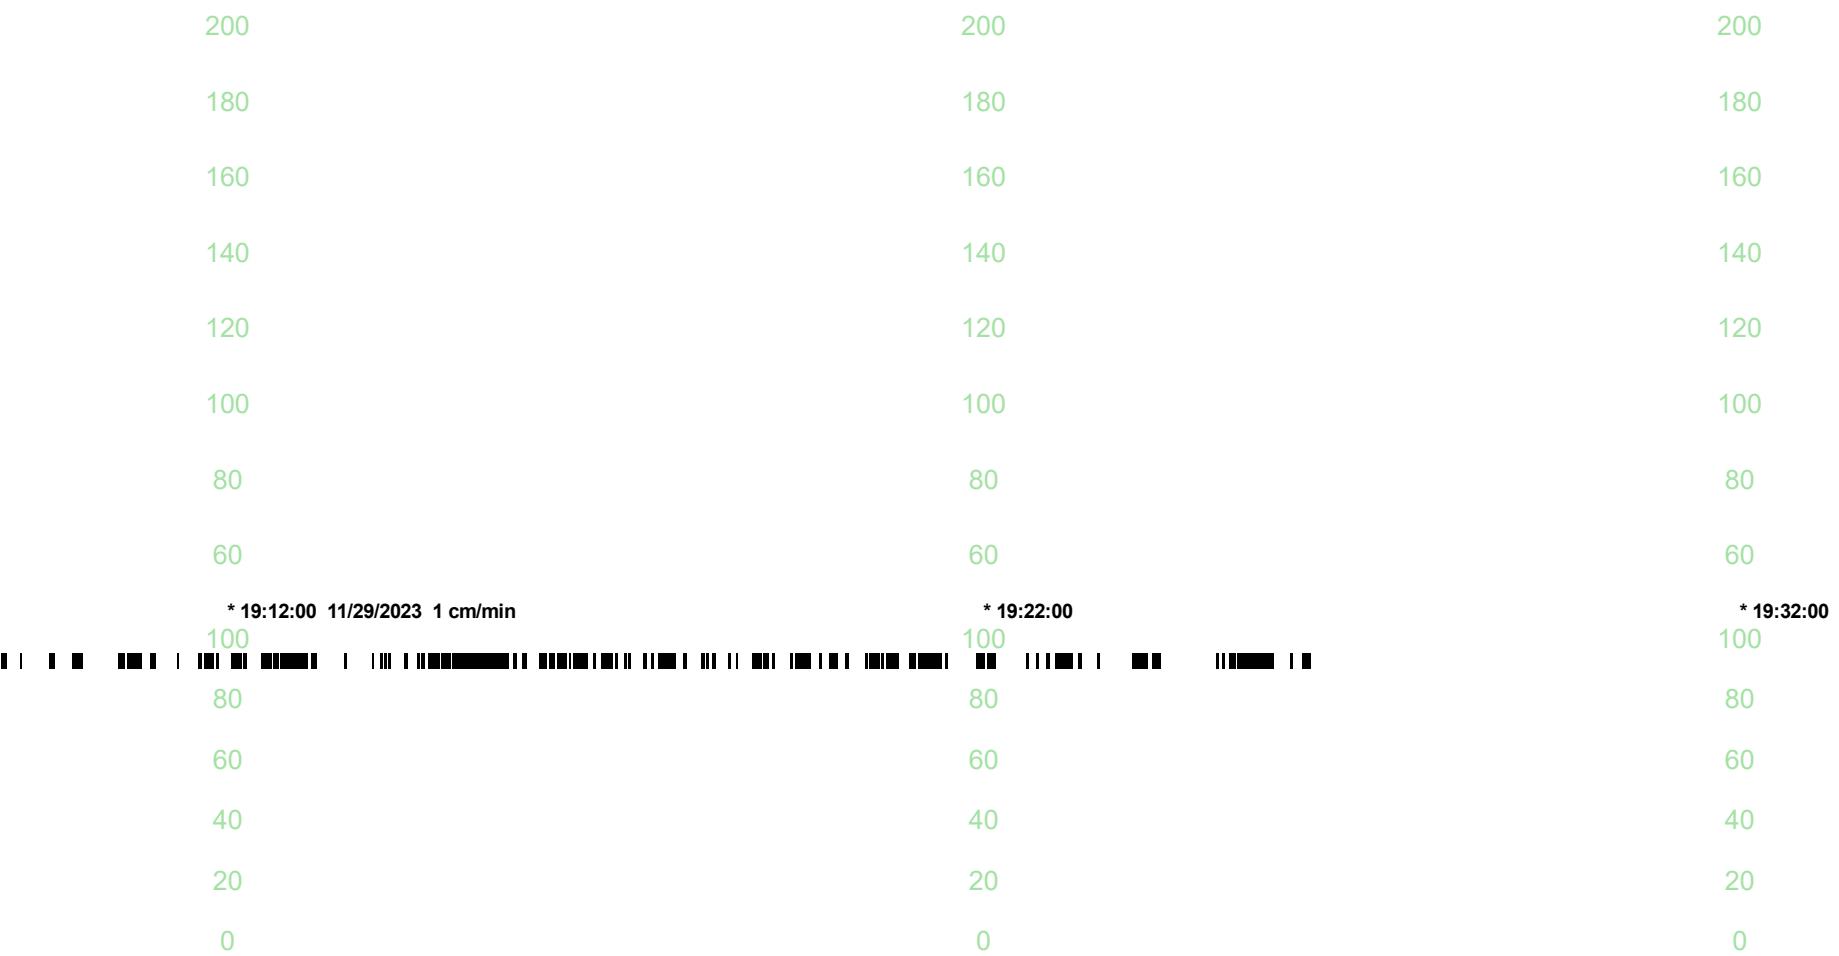

\* FCF1: PERDIDA SEÑAL.  
Estado de la telemetría: Desactivado  
Modo FCF1: no transductor  
Modo Toco: no transductor  
Estado del monitor: En espera  
Estado del registrador: Desactivado


Alarma con acuse de recibo







Estado del monitor: Activado  
Estado del registrador: Activado  
Modo FCF1: US  
Estado del FMP: Activado  
Modo Toco: externo


\* FCF1: PERDIDA SEÑAL.

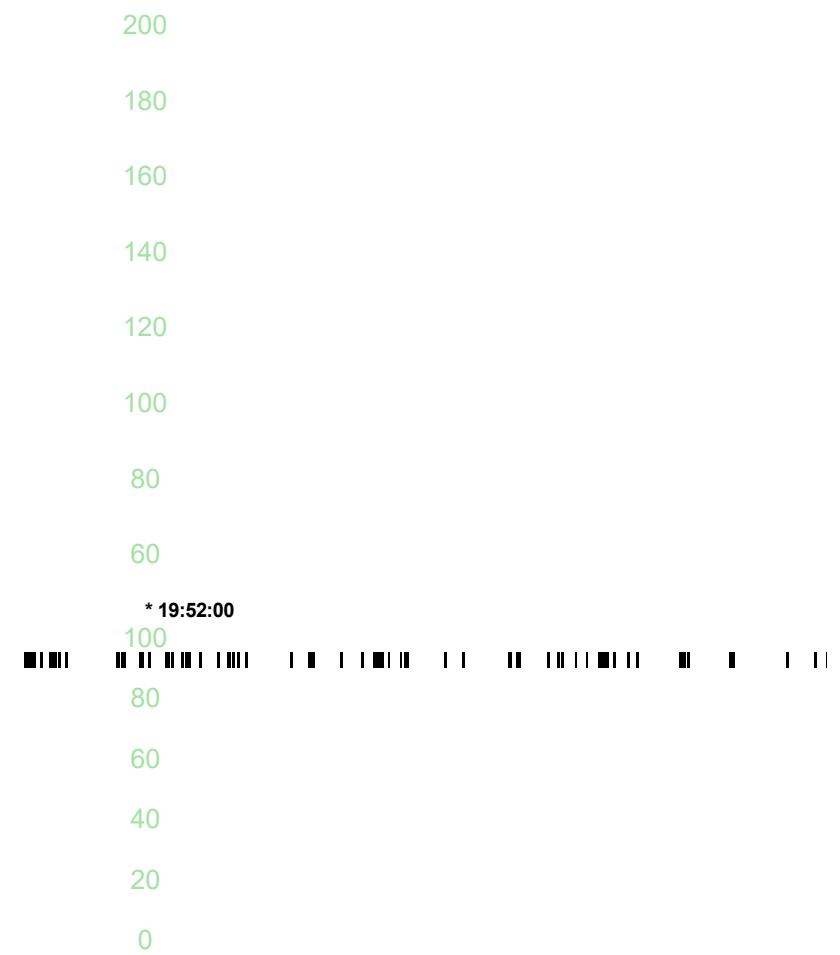

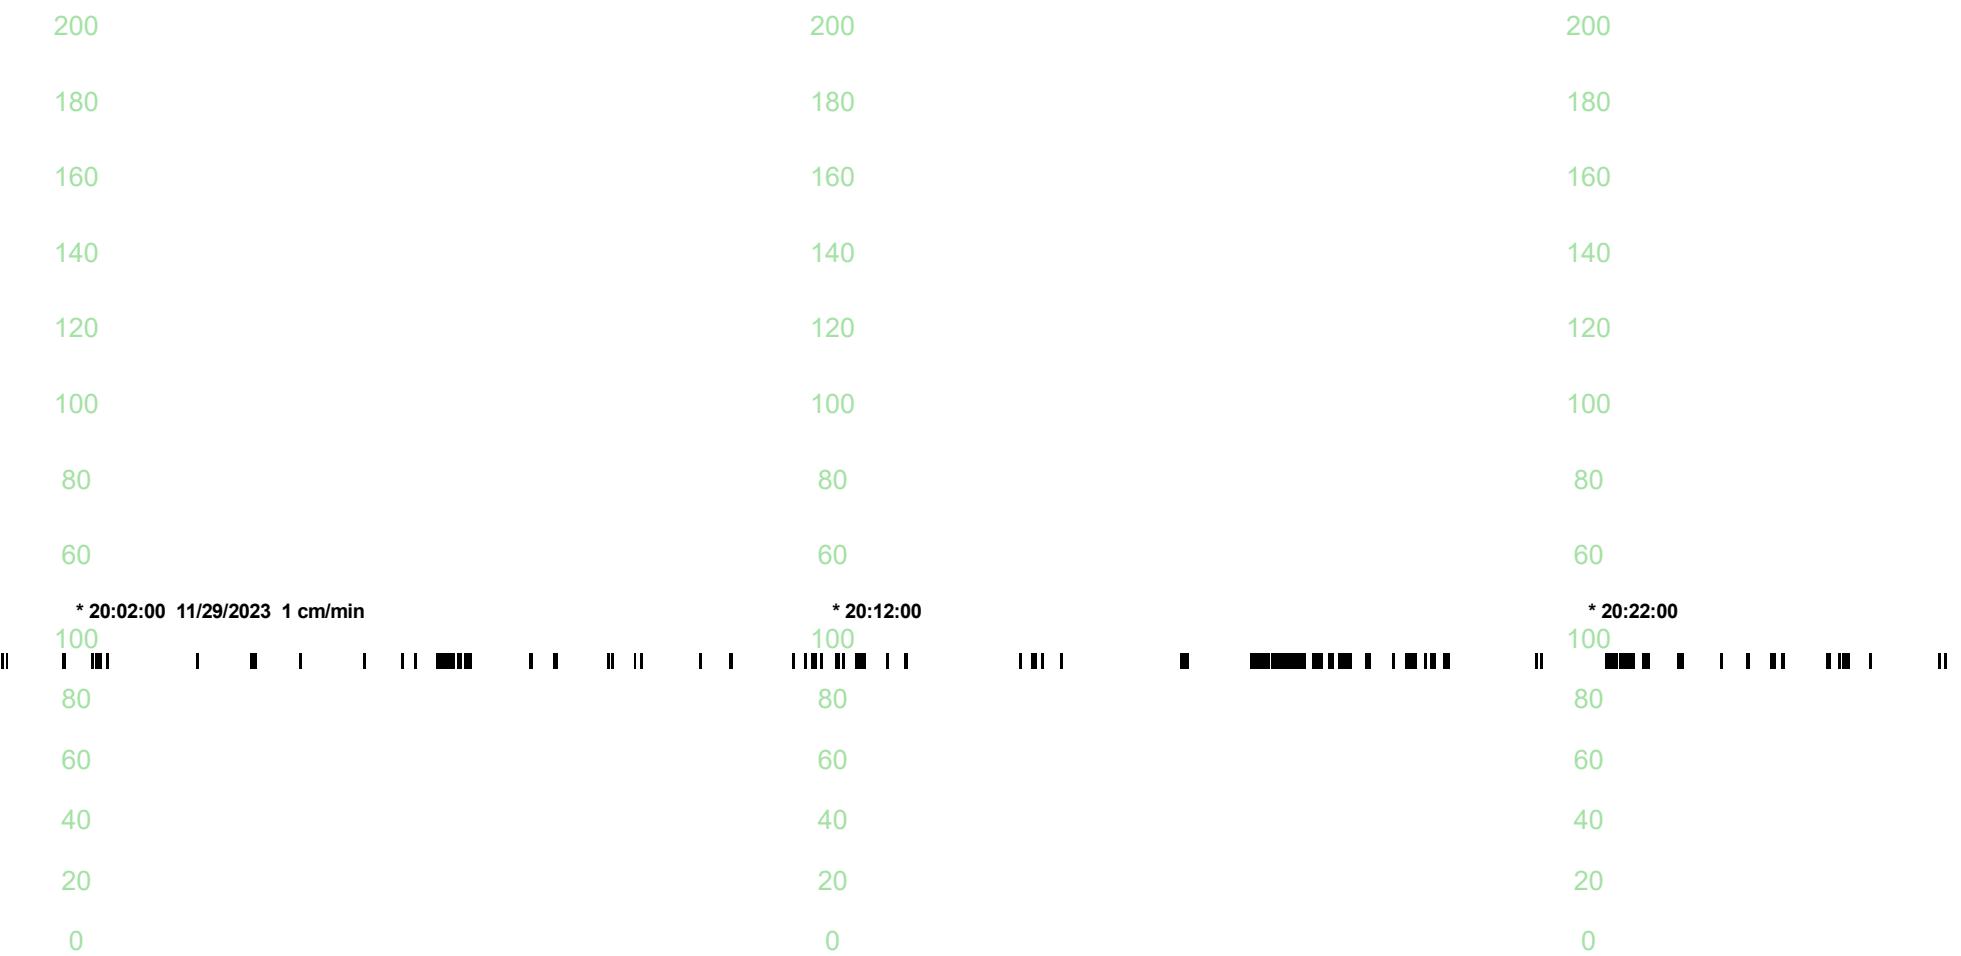


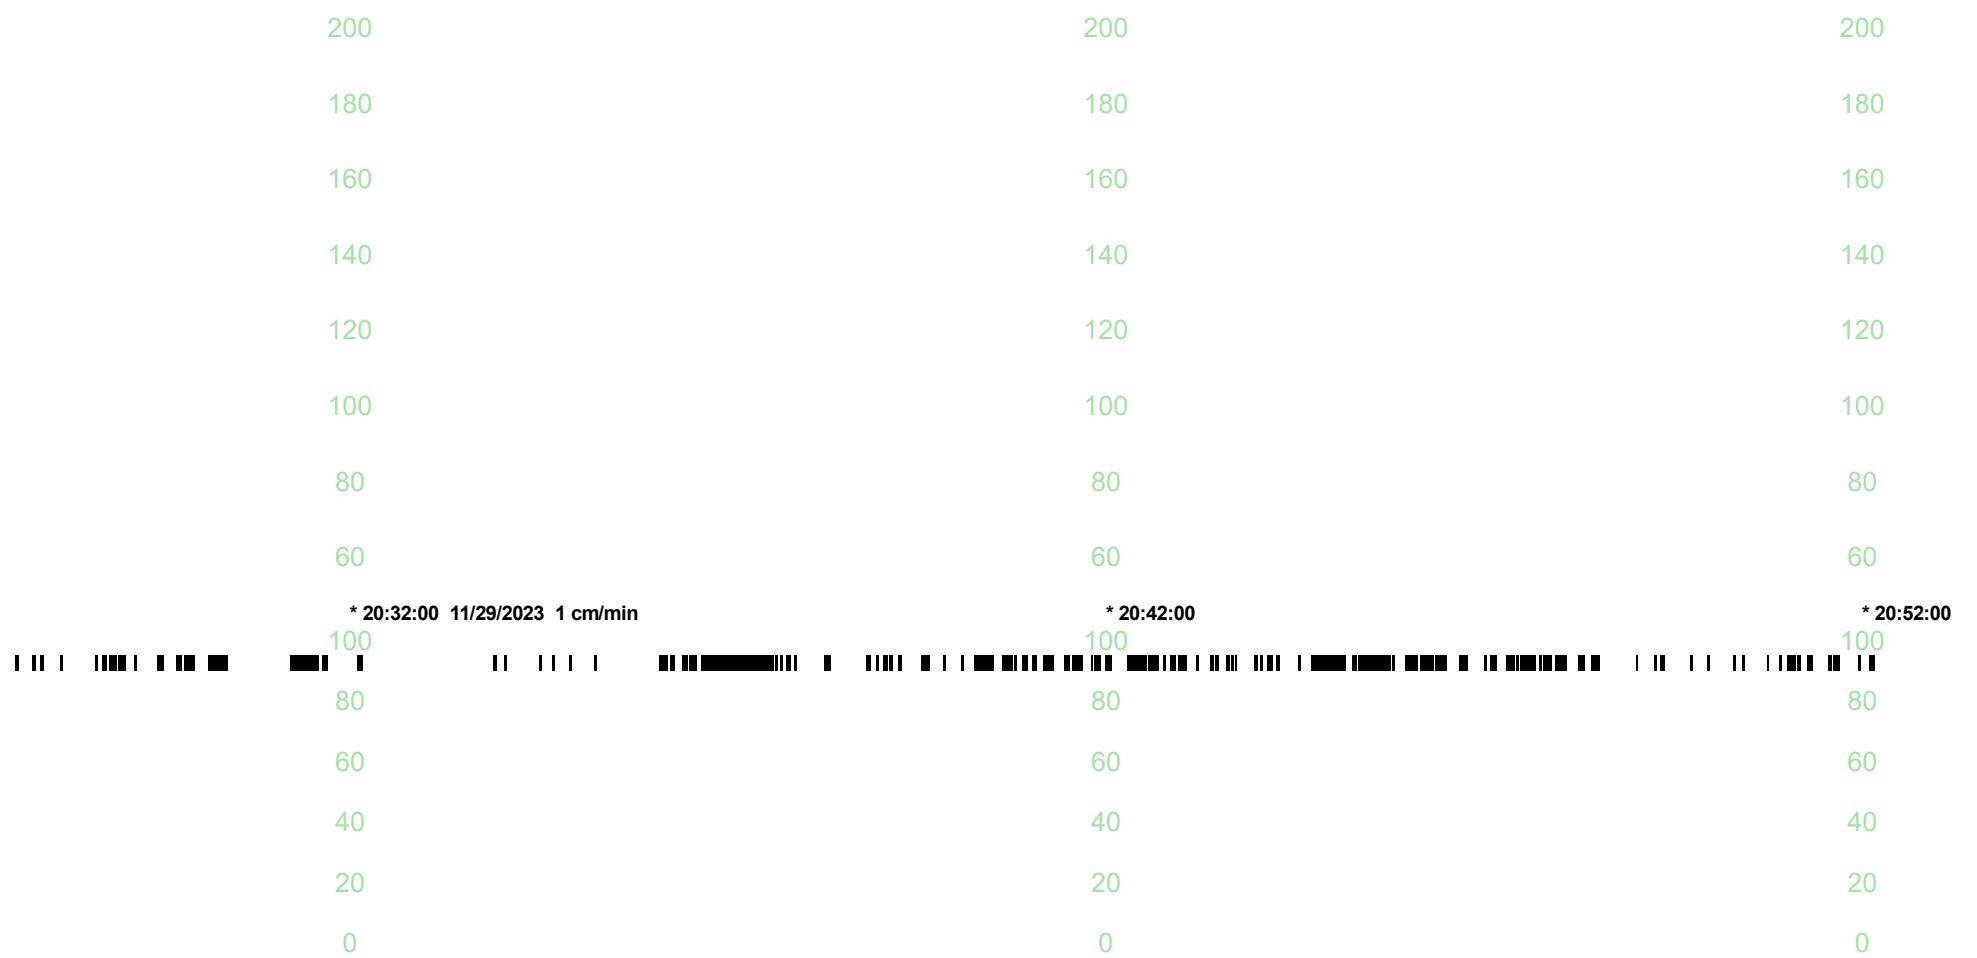

\* FCF1: PERDIDA SEÑAL.

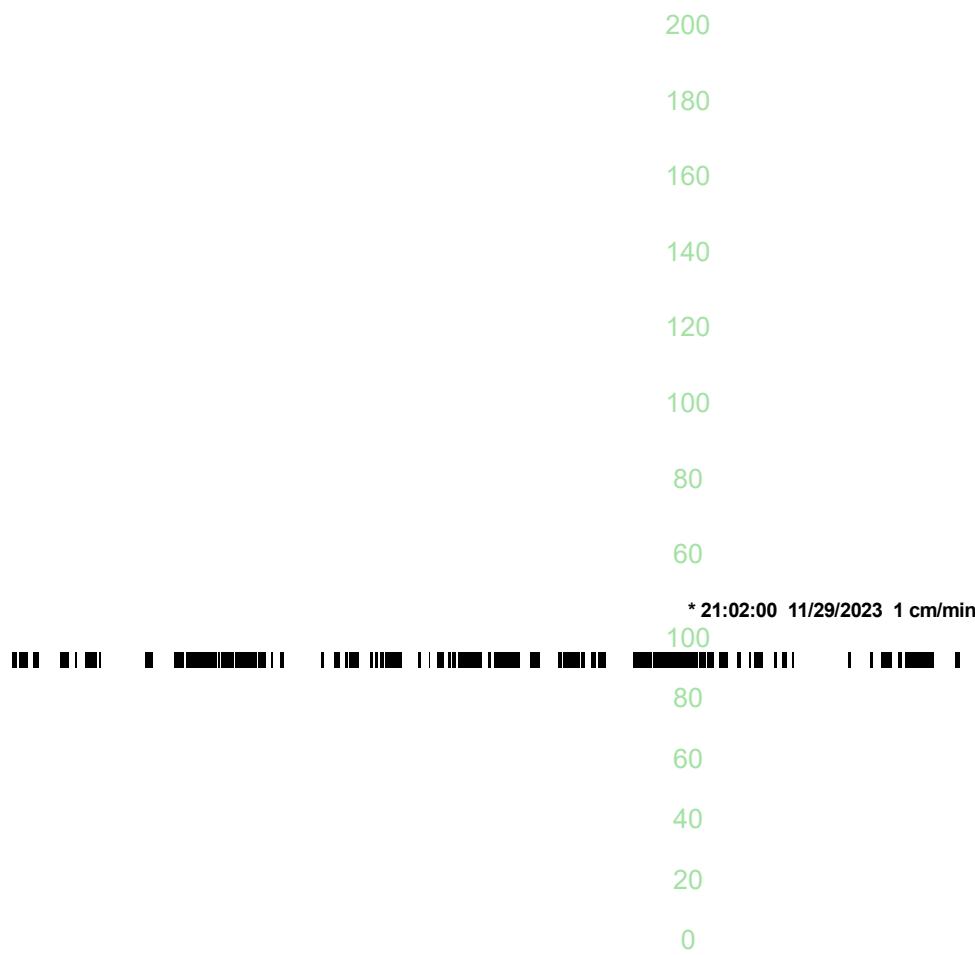


Alarma con acuse de recibo

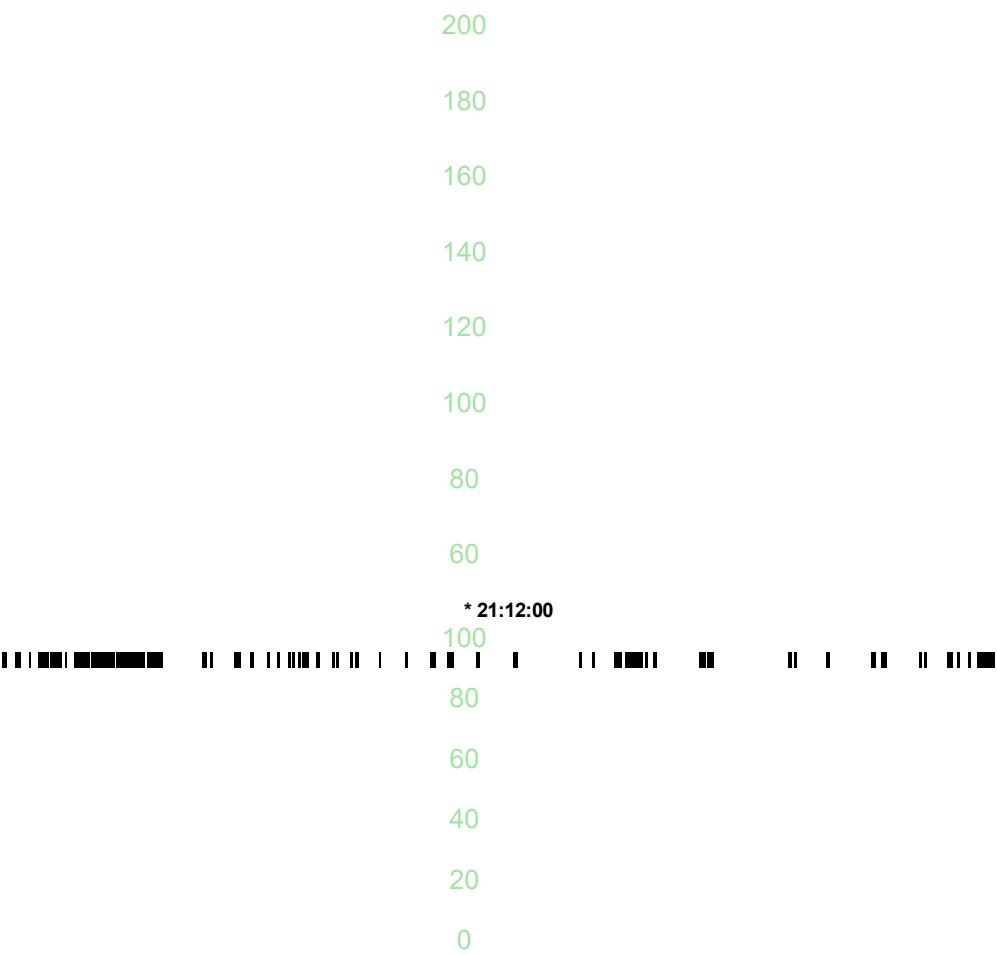

\* FCF1: PERDIDA SEÑAL



\* FCF1: PERDIDA SEÑAL

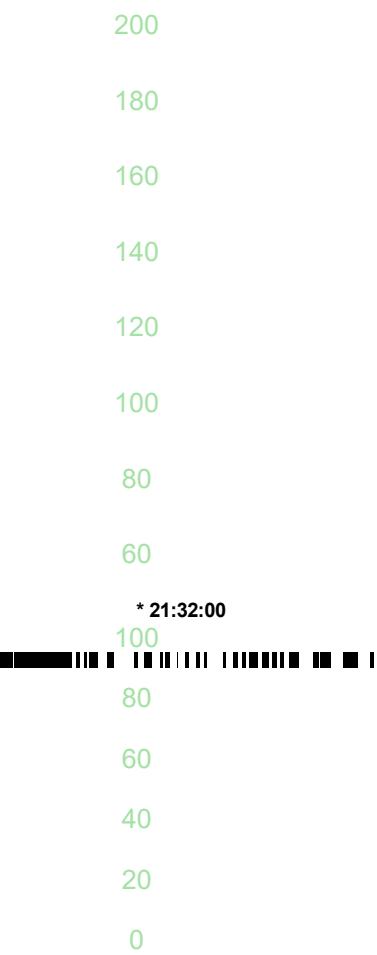

\*\* FCF1: PERDIDA SEÑAL



Alarma con acuse de recibo

Estado del monitor: Desactivado  
Estado del monitor: Activado  
ID del Monitor: M2703A

\* FCF1: PERDIDA SEÑAL  
Alarma con acuse de recibo  
Estado del monitor: En espera  
Modo FCF1: no transductor  
Modo Toco: no transductor  
Estado del registrador: Desactivado

