


Admisión en 'Día-5'
 Estado del monitor: Activado
 ID del Monitor: M2703A
 Estado del registrador: Desactivado
 Modo FCF1: no transductor
 Modo FCF2: no transductor
 Modo FCF3: no transductor
 Modo FCM: no transductor
 Modo Toco: externo
 Estado de la telemetría: Activado
 Modo FCF1: US
 Estado del FMP: Activado
 Modo FCF1: no transductor
 Modo Toco: no transductor
 Modo FCF1: US
 Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA PACIENTE
 Estado del registrador: Activado
 Modo Toco: externo

Modo FCM: Pulso Toco

* FCF1: PERDIDA SEÑAL
 Alarma con acuse de recibo

Estado del monitor: En espera
 Modo FCF1: no transductor
 Modo Toco: no transductor
 Estado del registrador: Desactivado

Estado de la telemetría: Desactivado

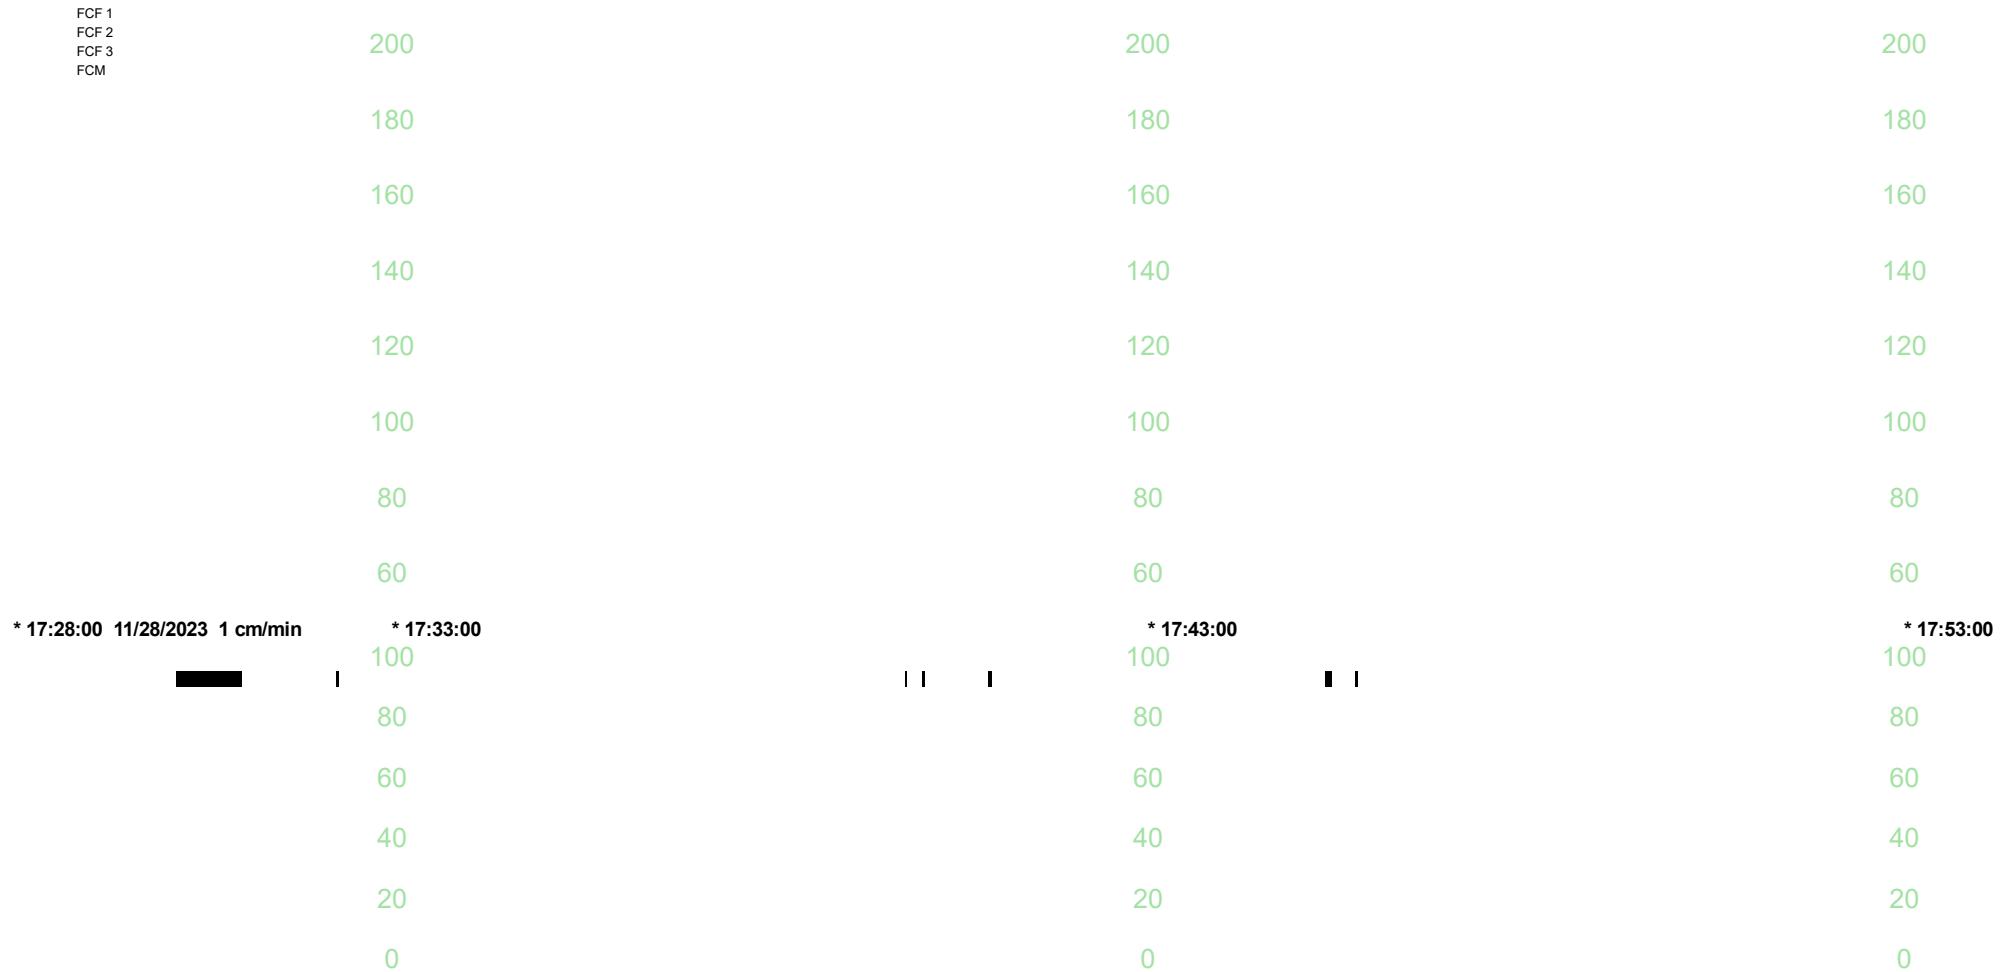


Estado del monitor: Activado
Estado de la telemetría: Activado
Estado del registrador: Activado
Estado de la telemetría: Desactivado
Estado de la telemetría: Activado
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SENAL
Alarma con acuse de recibo

Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Estado del registrador: Activado
Estado del monitor: En espera
Estado del FMP: Activado
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

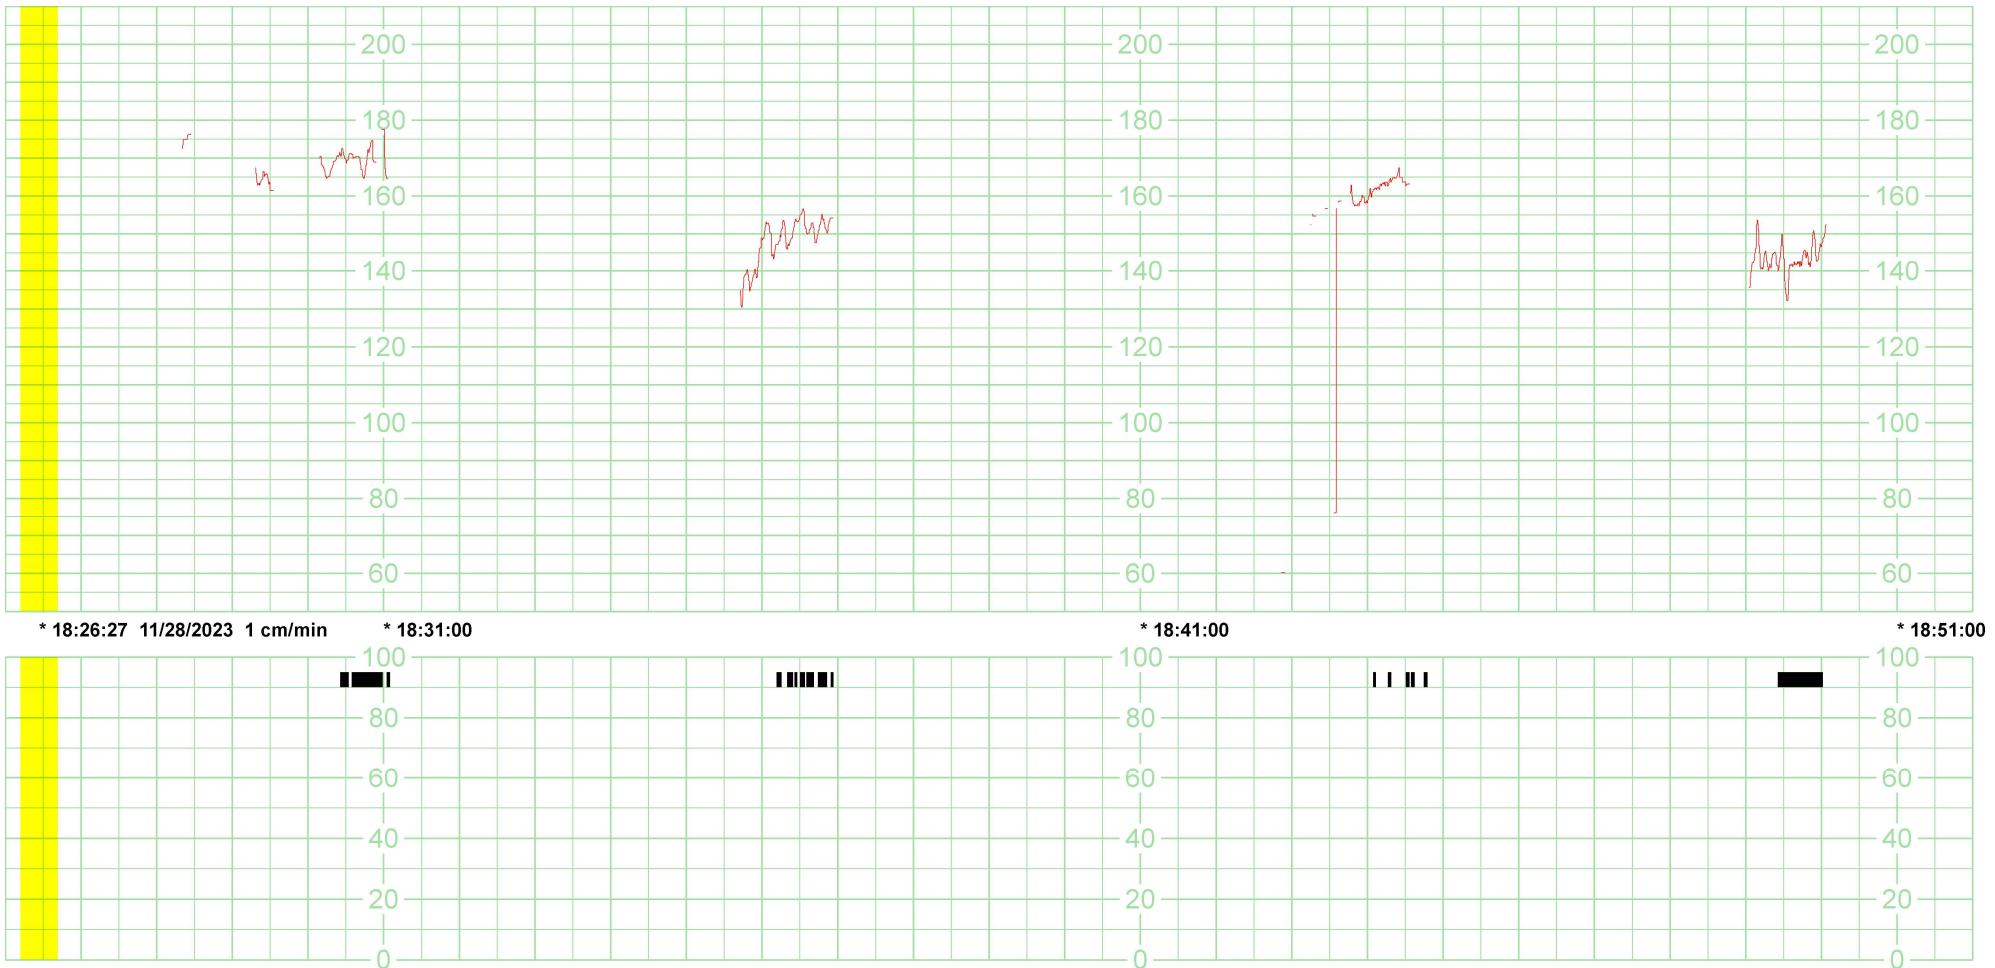


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado

Estado del monitor: En espera
* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Alarma con acuse de recibo

Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCF: US
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado

* FCF1: PERDIDA SEÑAL
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado
Alarma con acuse de recibo
Estado del monitor: Activado
Modo FCF1: US
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

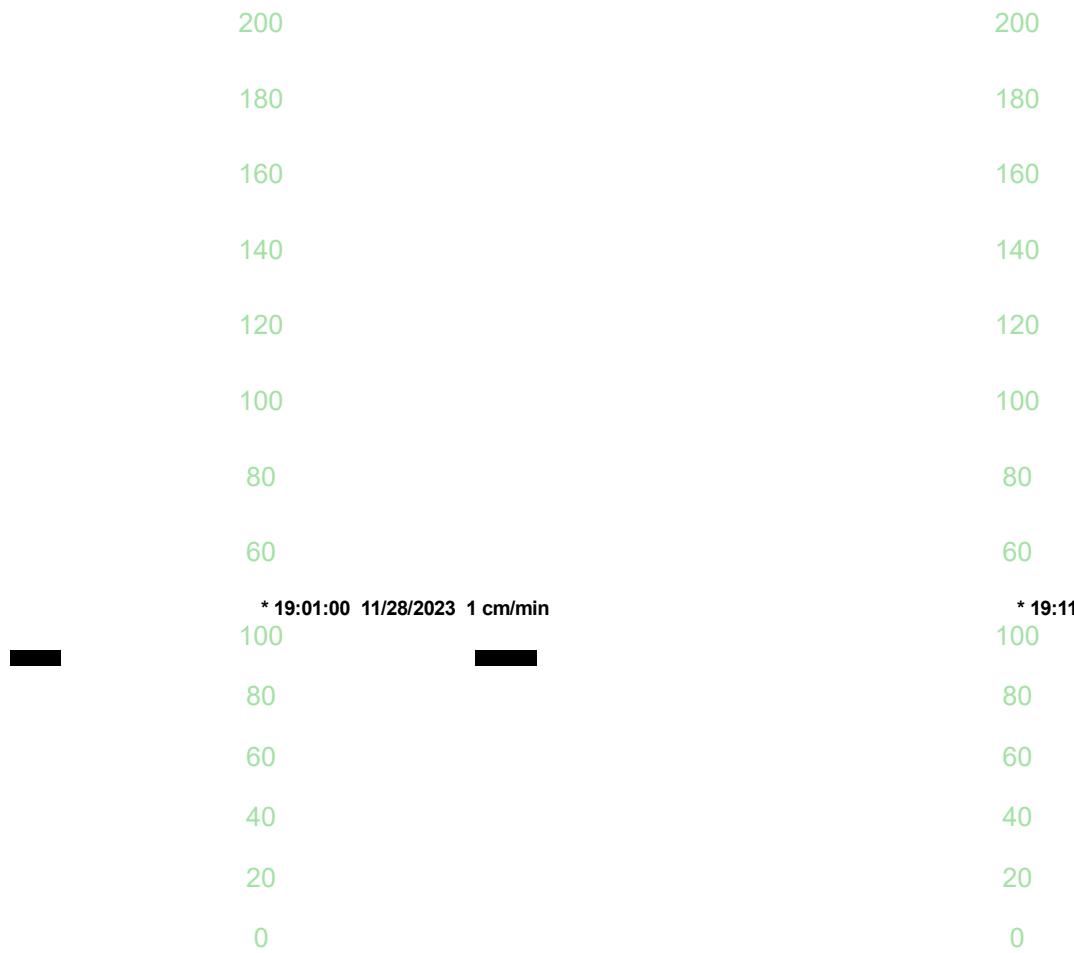




Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo
Modo FCM: SpO2
* FCF1:PERDIDA SEÑAL

** FCF1: PERDIDA SEÑAL
Alarma con acuse de recibo

** FCF1: PERDIDA SEÑAL

Alarma con acuse de recibo

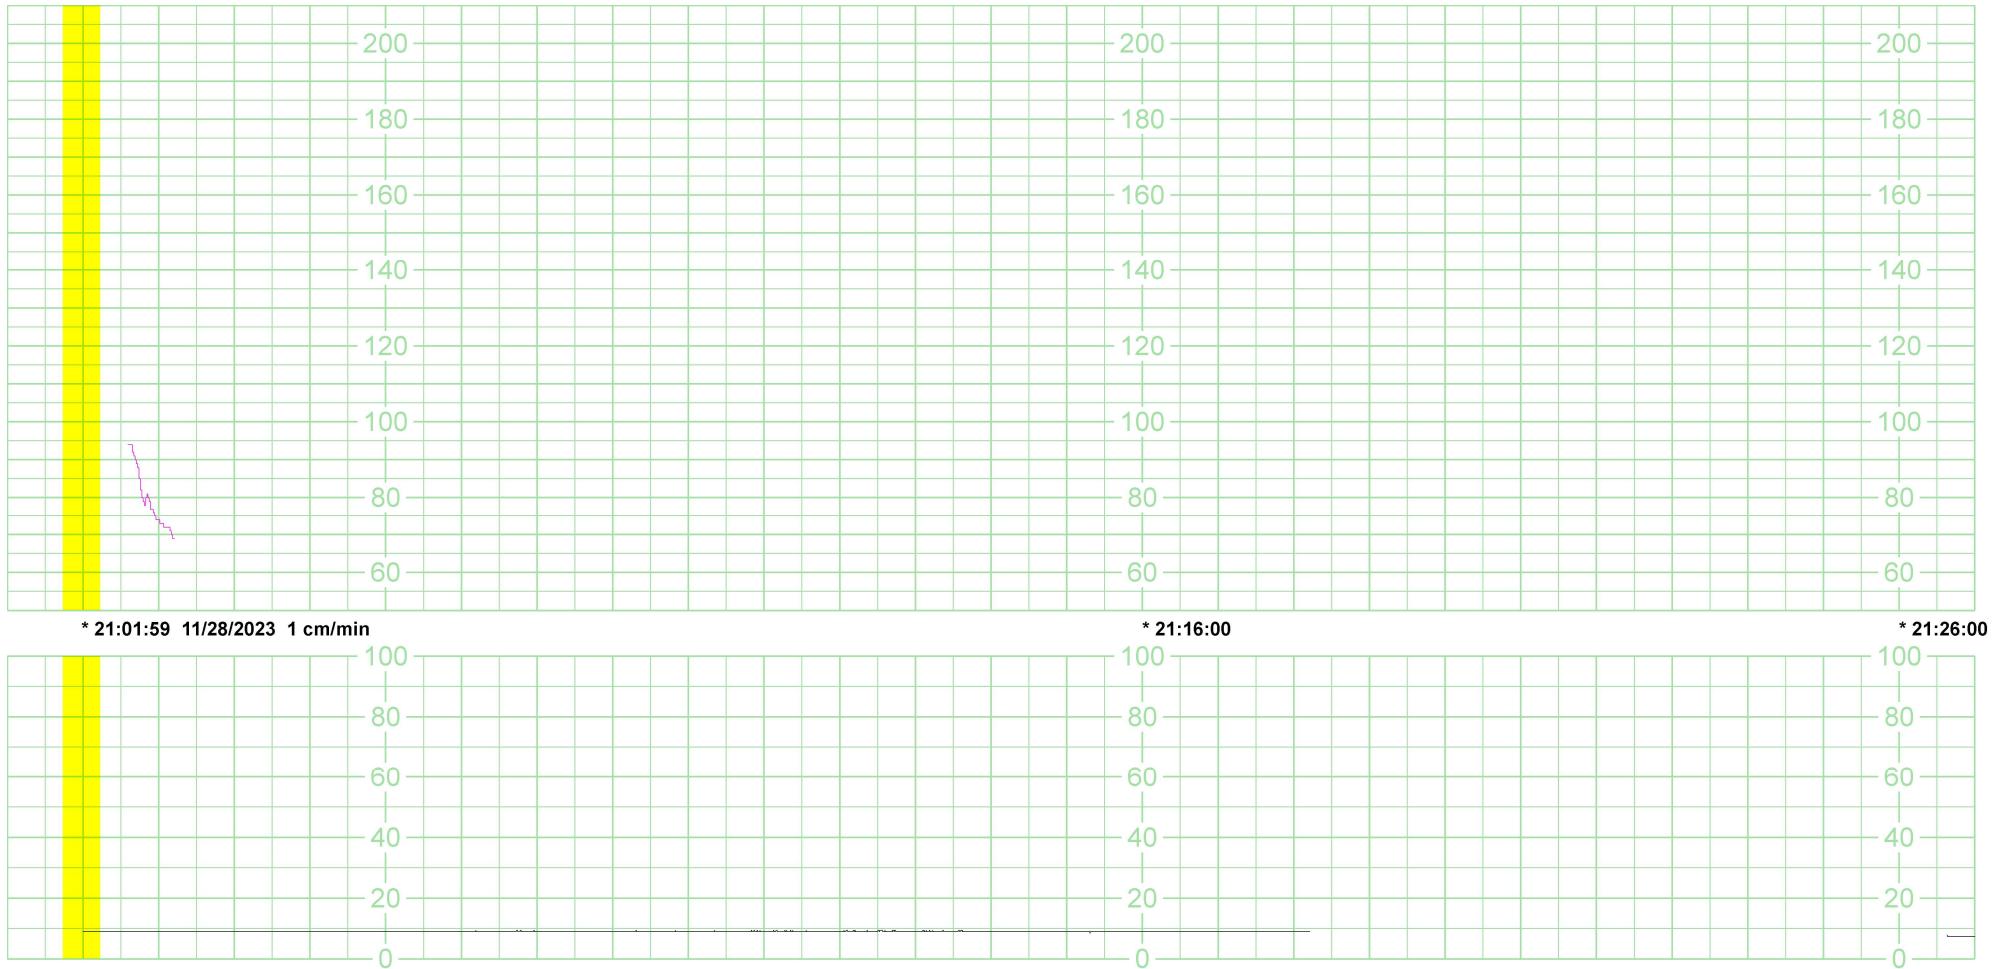


Estado del monitor: Desactivado
Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A


Alarma con acuse de recibo
Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco : no transductor
Estado del registrador: Desactivado

** FCF1: PERDIDA SEÑAL

* FCF1: TAQUICARDIA

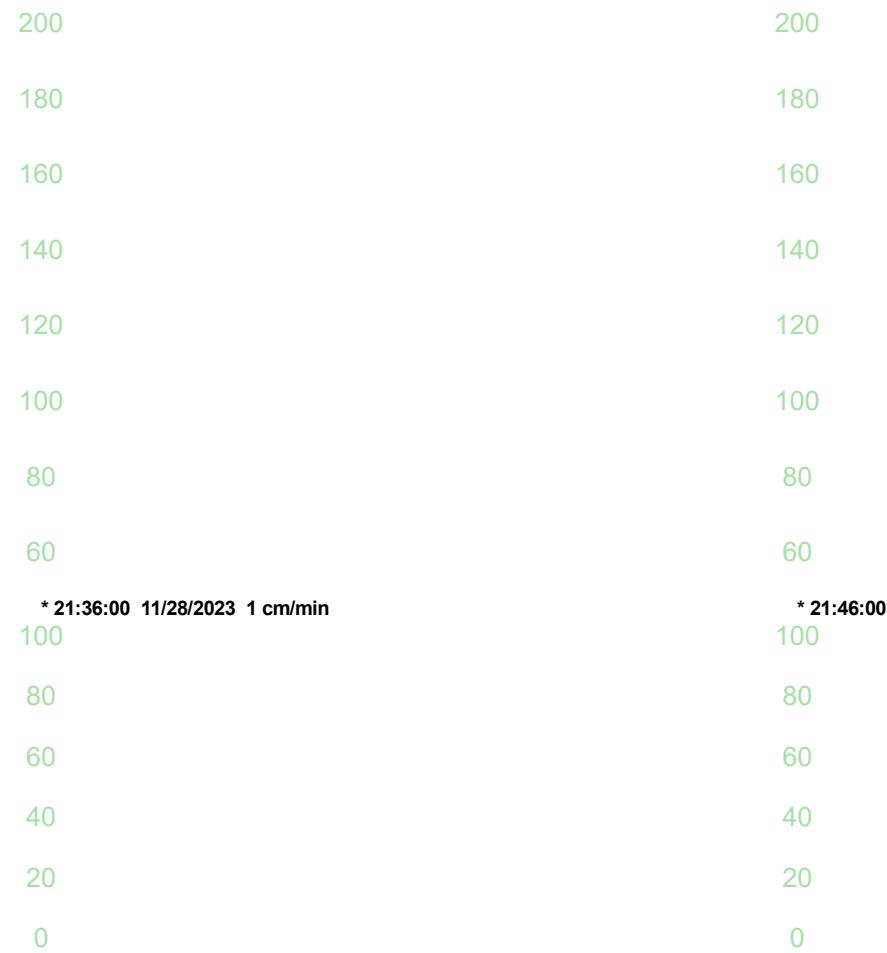


Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado

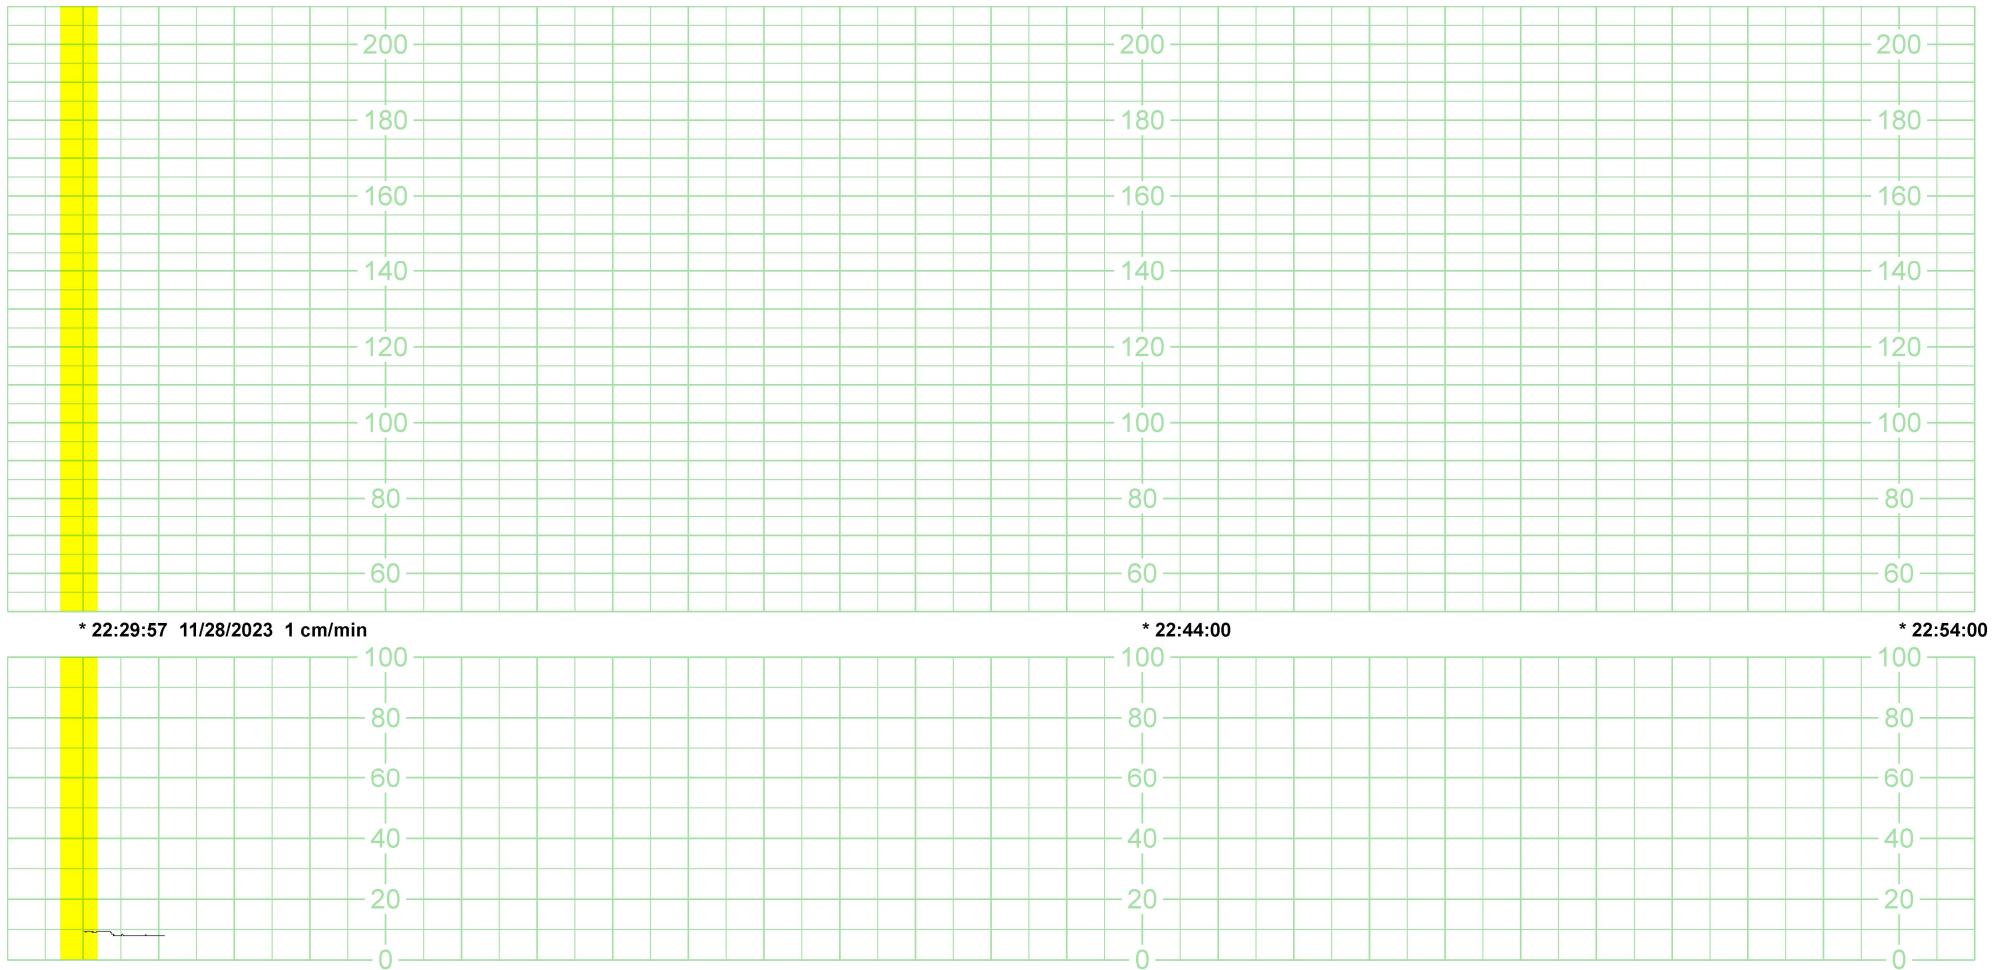

Estado del monitor: Activado
Modo FCF: US
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
Estado del FMP: Activado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL


* FCF1: TAQUICARDIA
Estado del monitor: En espera
Modo FCF: no transductor
Modo Toco: no transductor
Estado del registrador: Desactivado


Alarma con acuse de recibo

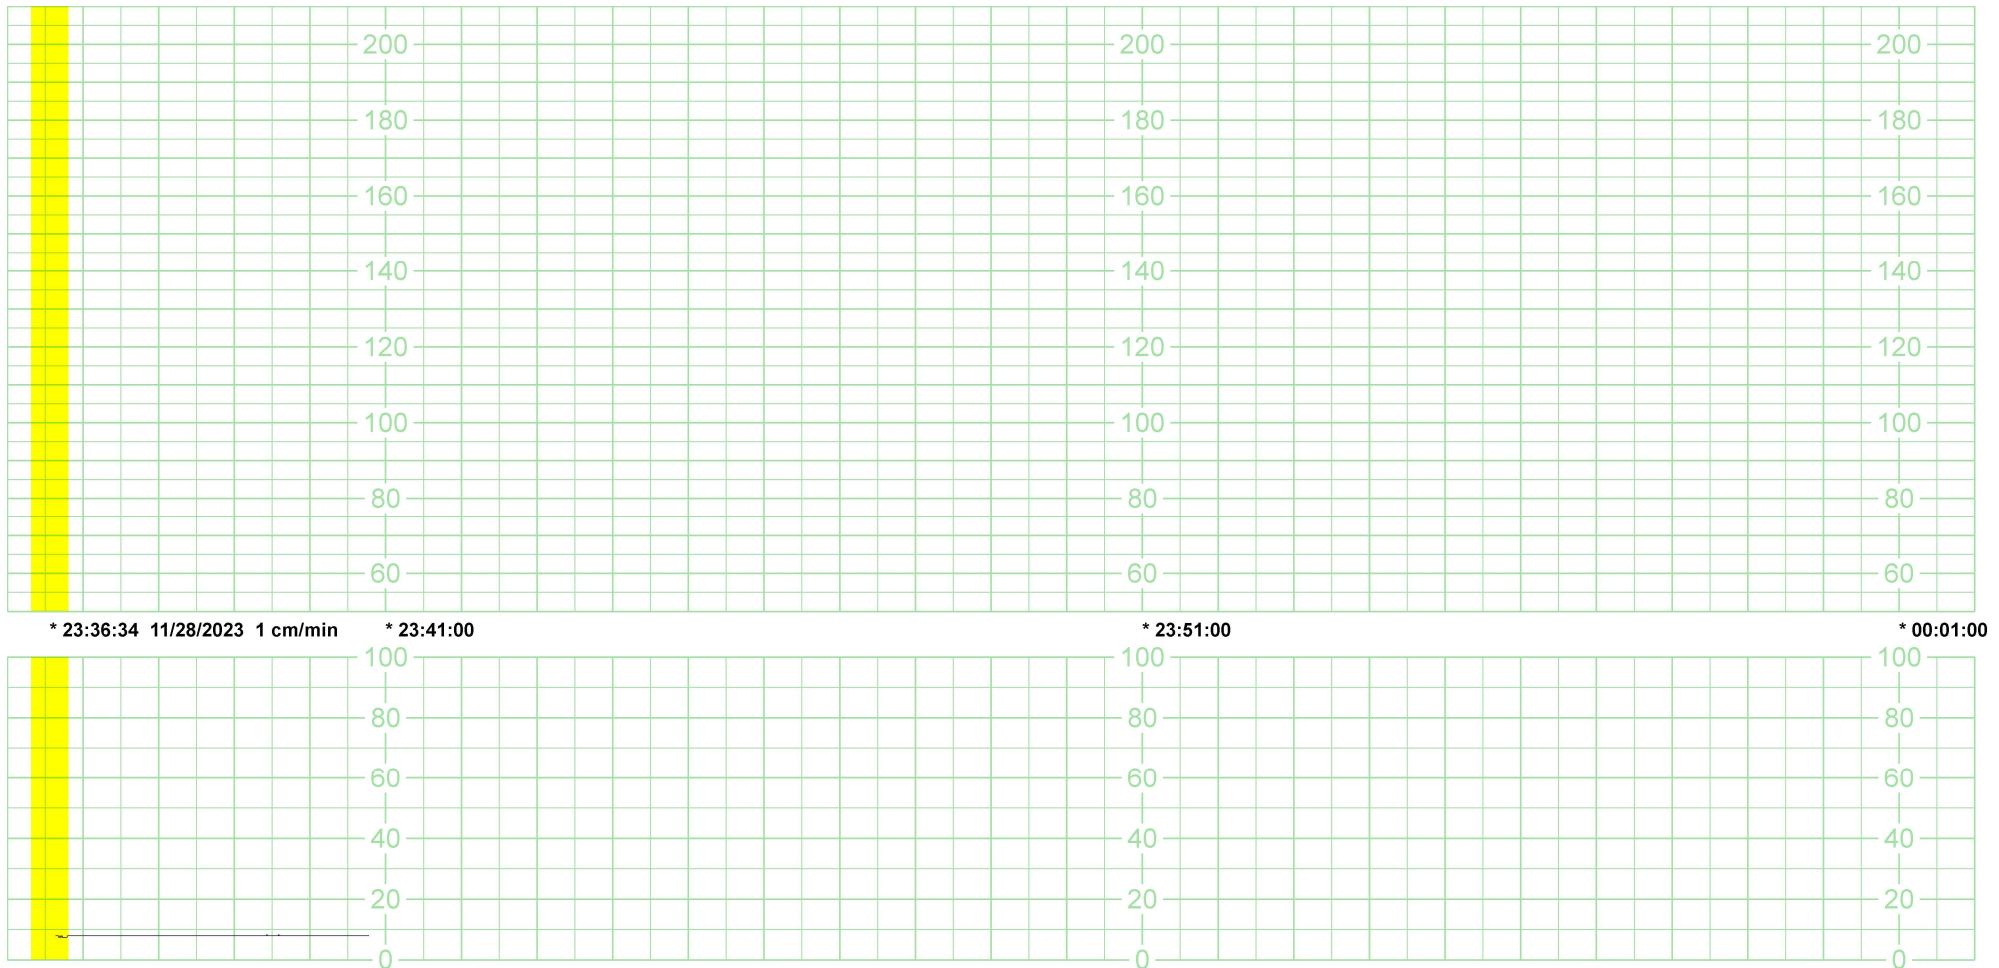


Estado del monitor: Desactivado


Estado del monitor: Activado
ID del Monitor: M2703A
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: US
Modo FCF2: no transductor
Modo FCF3: no transductor
Modo FCM: SpO2
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo
Estado del registrador: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA
PACIENTE
Estado del registrador: Desactivado
* FCF1: PERDIDA SEÑAL.
Estado del registrador: Activado
Alarma con acuse de recibo

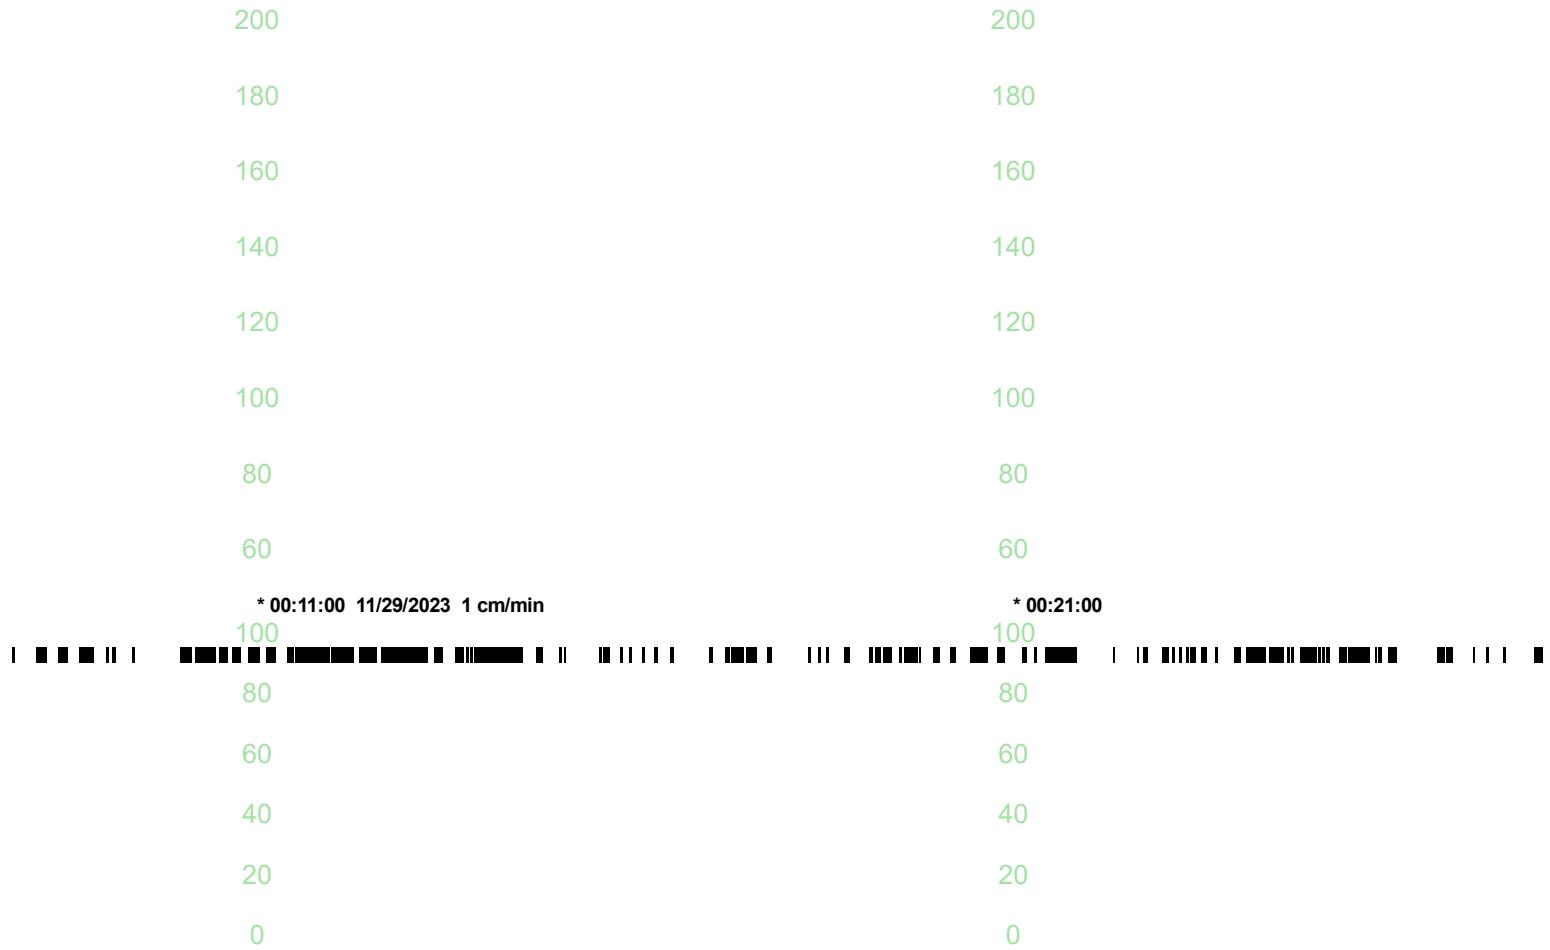

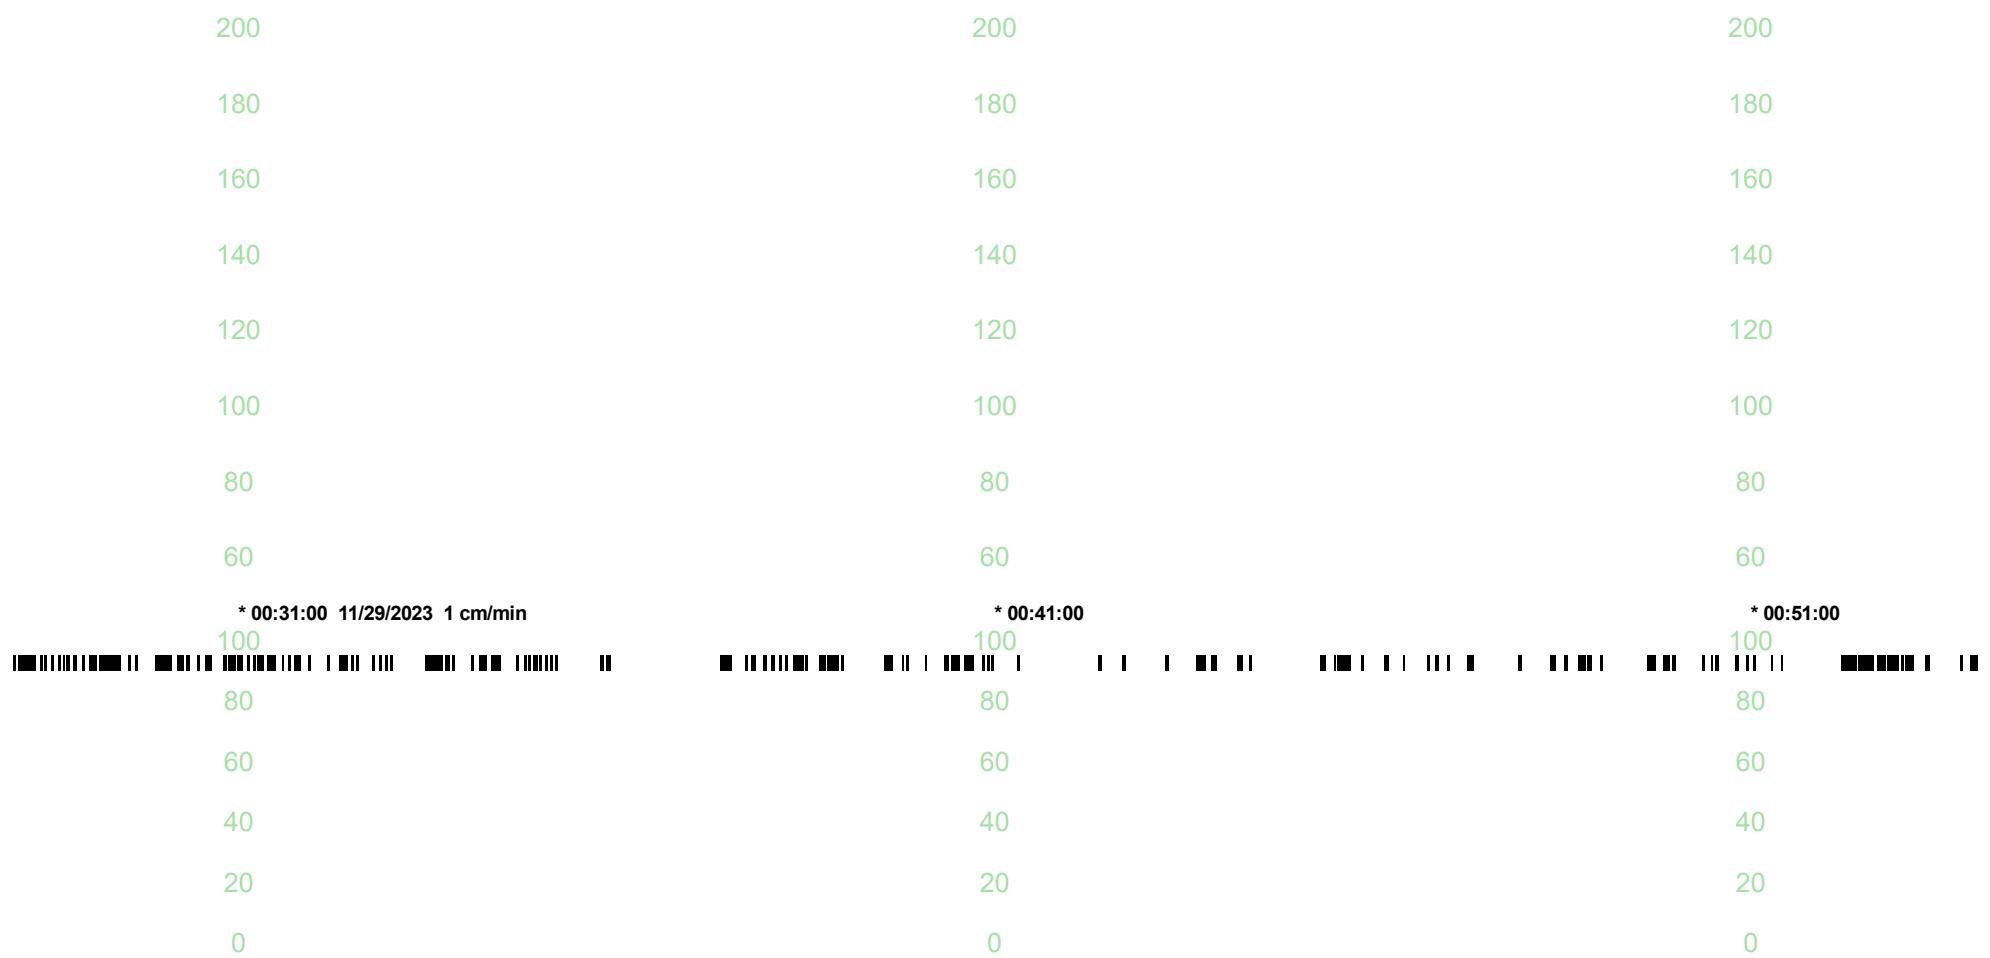

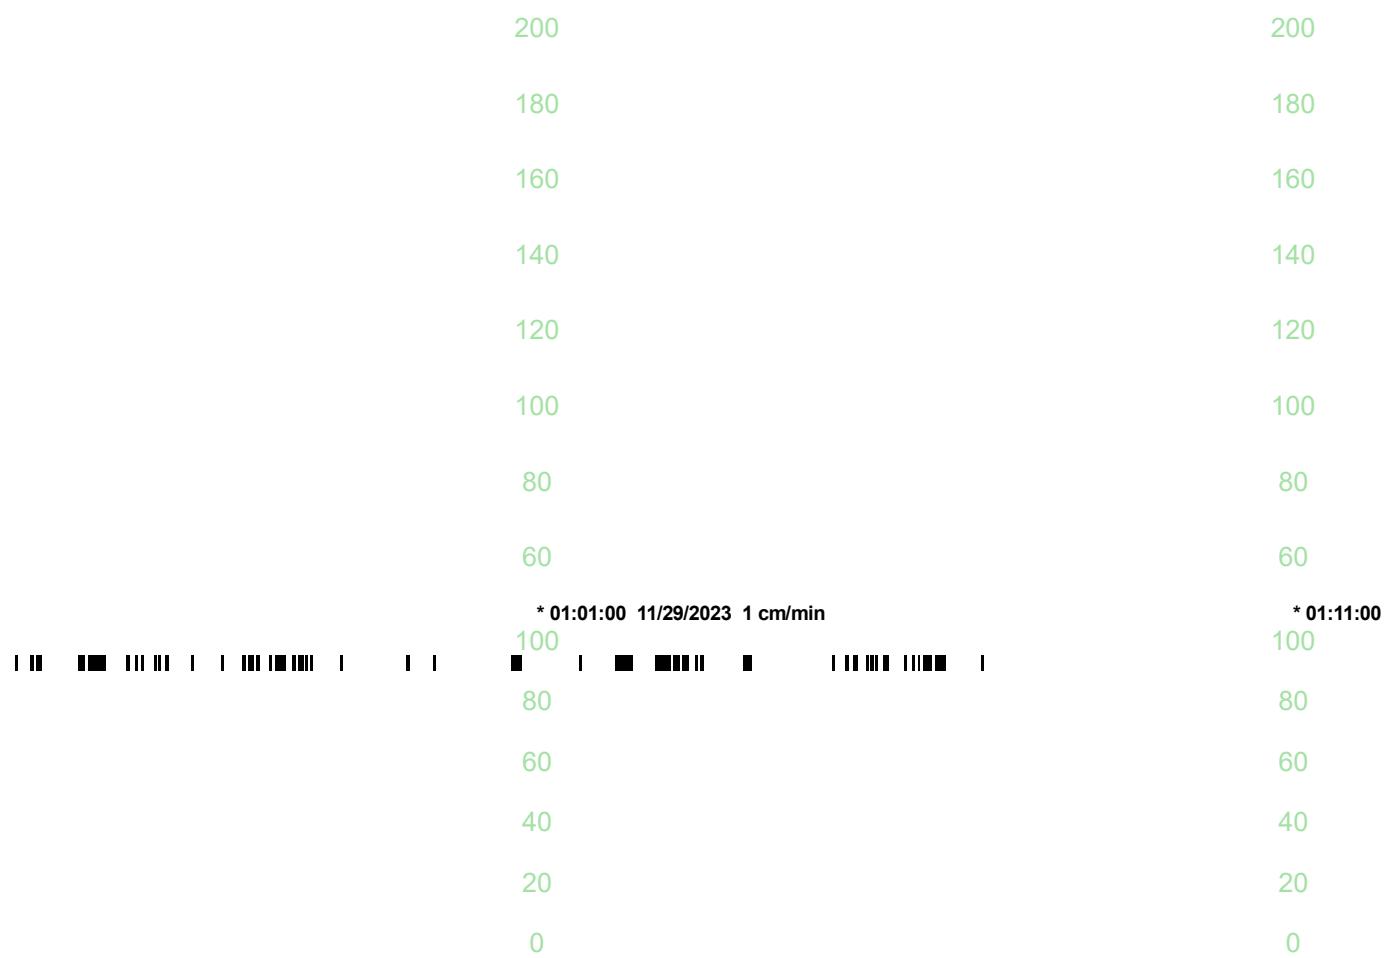



Estado del monitor: Activado
 ID del Monitor: M2703A
 Estado del registrador: Desactivado
 Modo FCF1: no transductor
 Modo FCF2: no transductor
 Modo FCF3: no transductor
 Modo FCM: no transductor
 Modo Toco: no transductor
 Modo Toco: externo
 Modo FCF1: US
 Estado del FMP: Activado
AJUSTES DE ALARMAS PARA PACIENTE
 Modo Toco: no transductor
 Modo FCF1: no transductor
 Estado de la telemetría: Activado
 Modo Toco: externo
 Estado del monitor: En espera
 Estado del monitor: Activado
 Modo Toco: no transductor
 Modo Toco: externo
 Modo FCM: Pulso Toco
 Modo Toco: no transductor
 Modo FCM: SpO2
 Modo FCF1: US
 Estado del FMP: Activado
 Modo Toco: externo
 * FCF1: PERDIDA SEÑAL
 Alarma con acuse de recibo
 ** FCF1: PERDIDA SEÑAL
 Alarma con acuse de recibo
 Estado del registrador: Activado

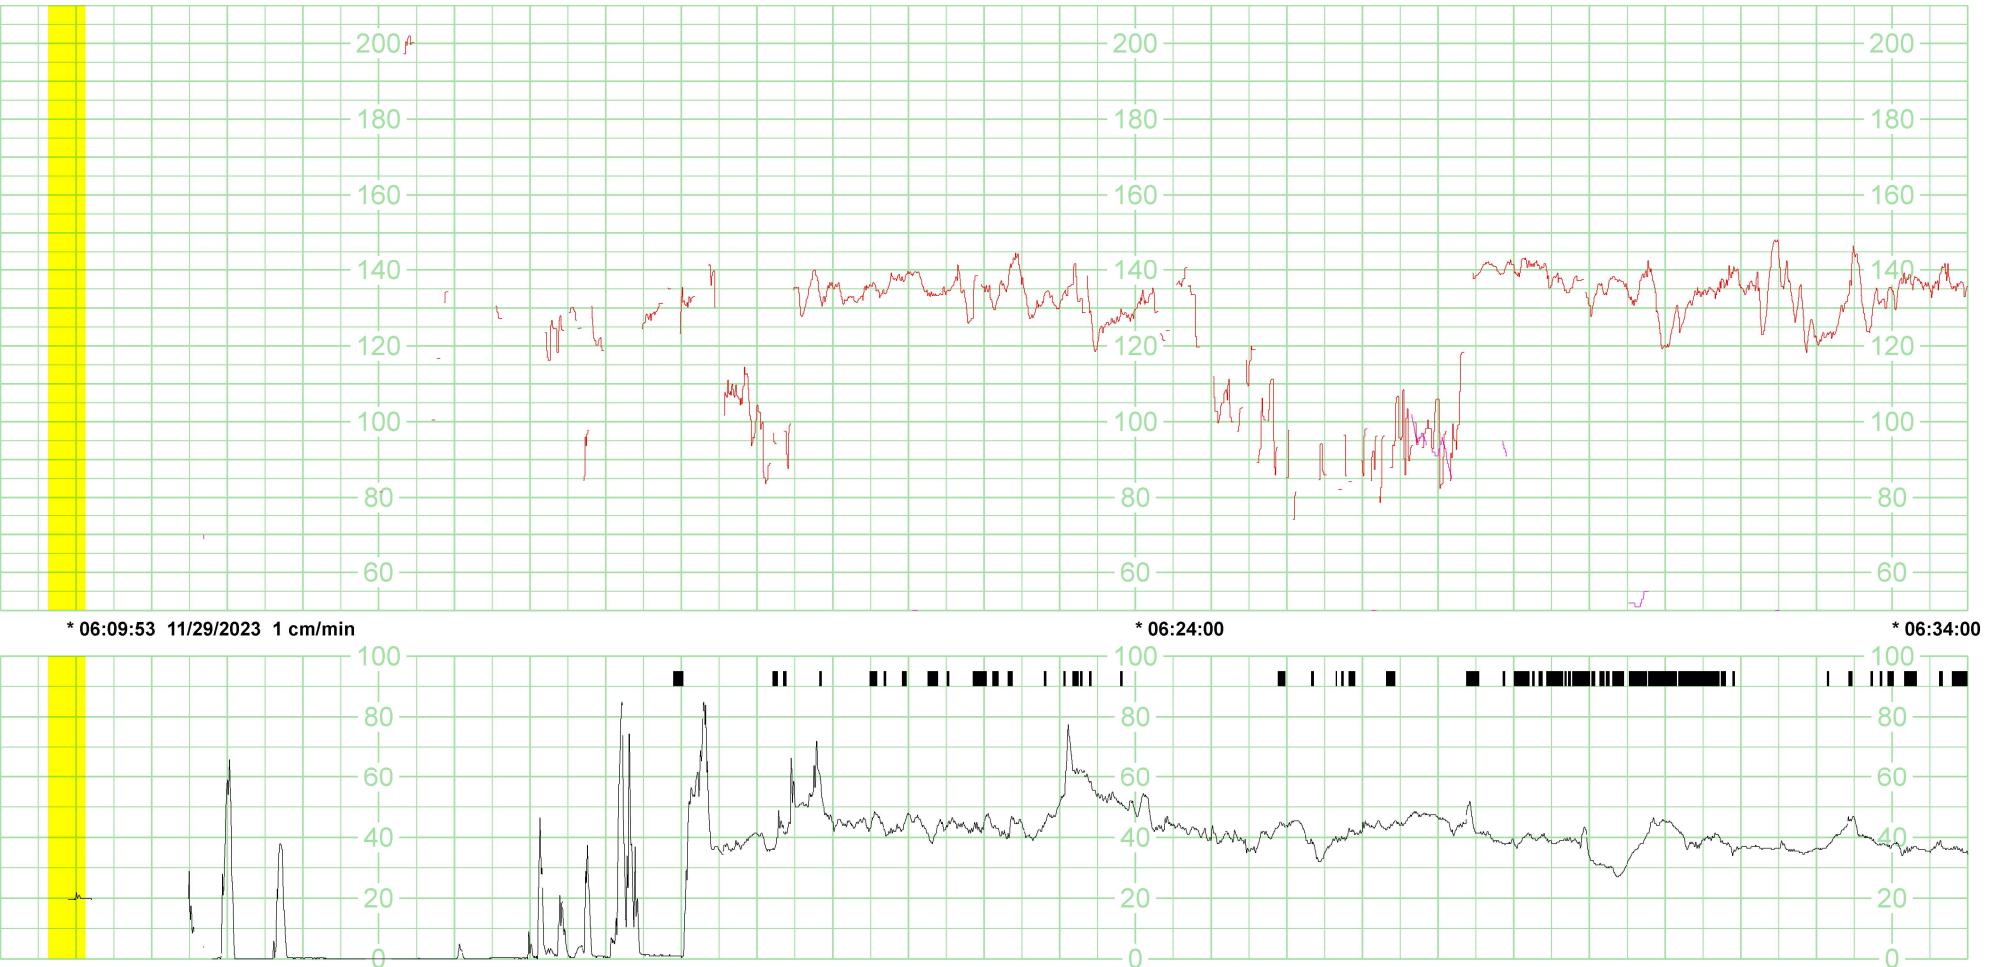

* FCF1: PERDIDA SEÑAL
 ** FCF1: BRADICARDIA
 Estado de coincidencia: Activado
 Alarma con acuse de recibo
 * COINCIDENCIA
 Alarma con acuse de recibo

Estado del monitor: En espera
Estado del registrador: Desactivado
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco : no transductor
Estado de la telemetría: Desactivado

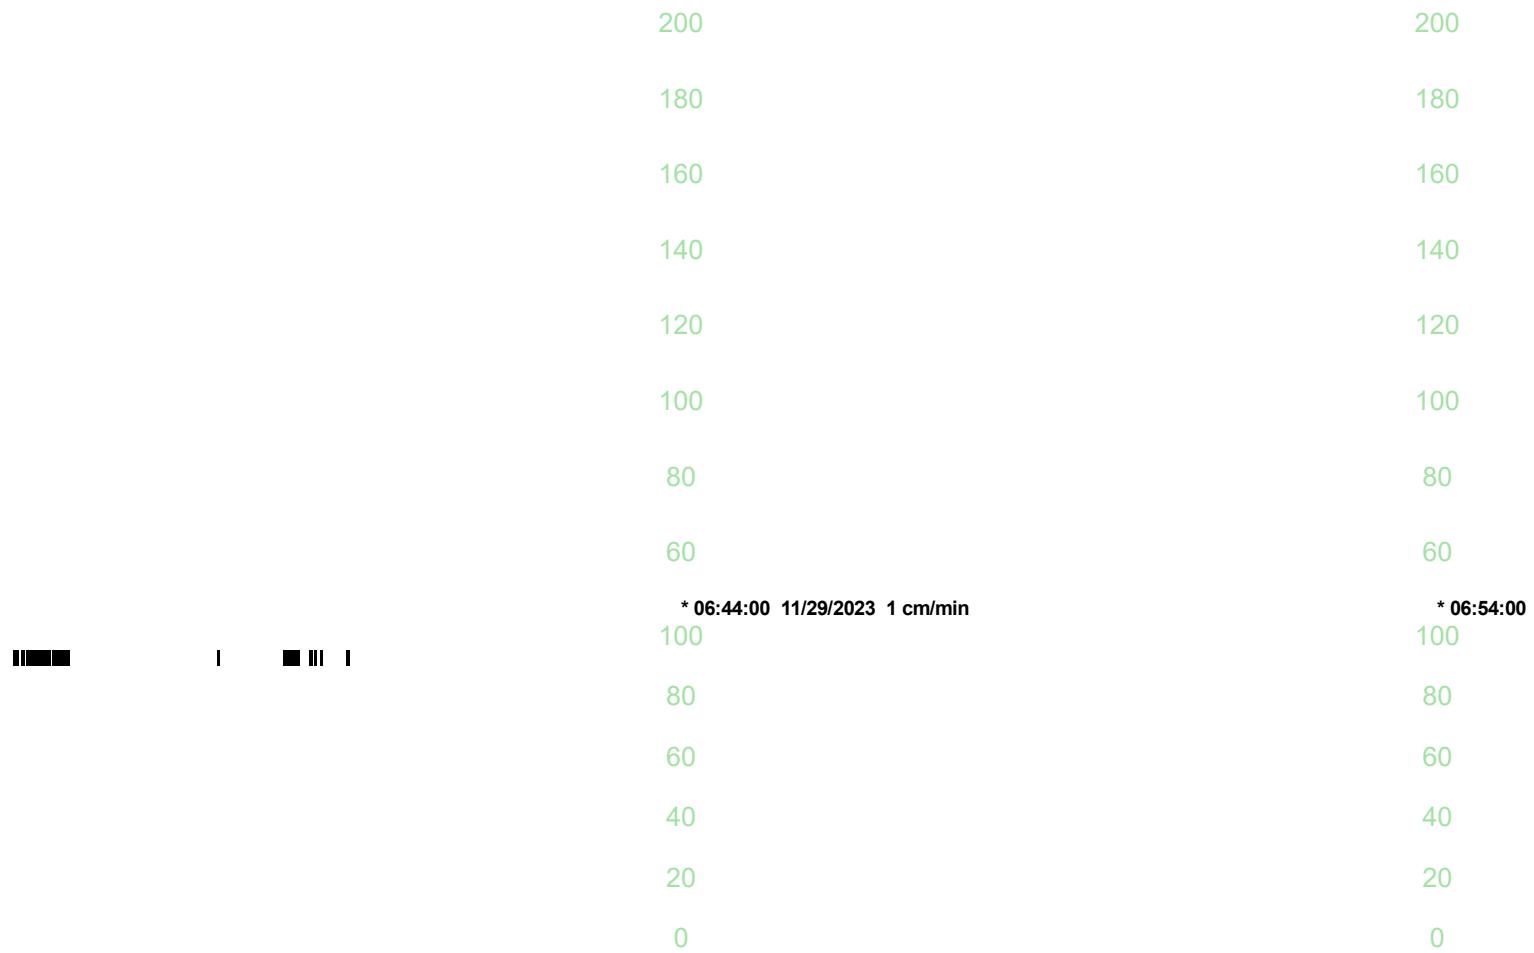

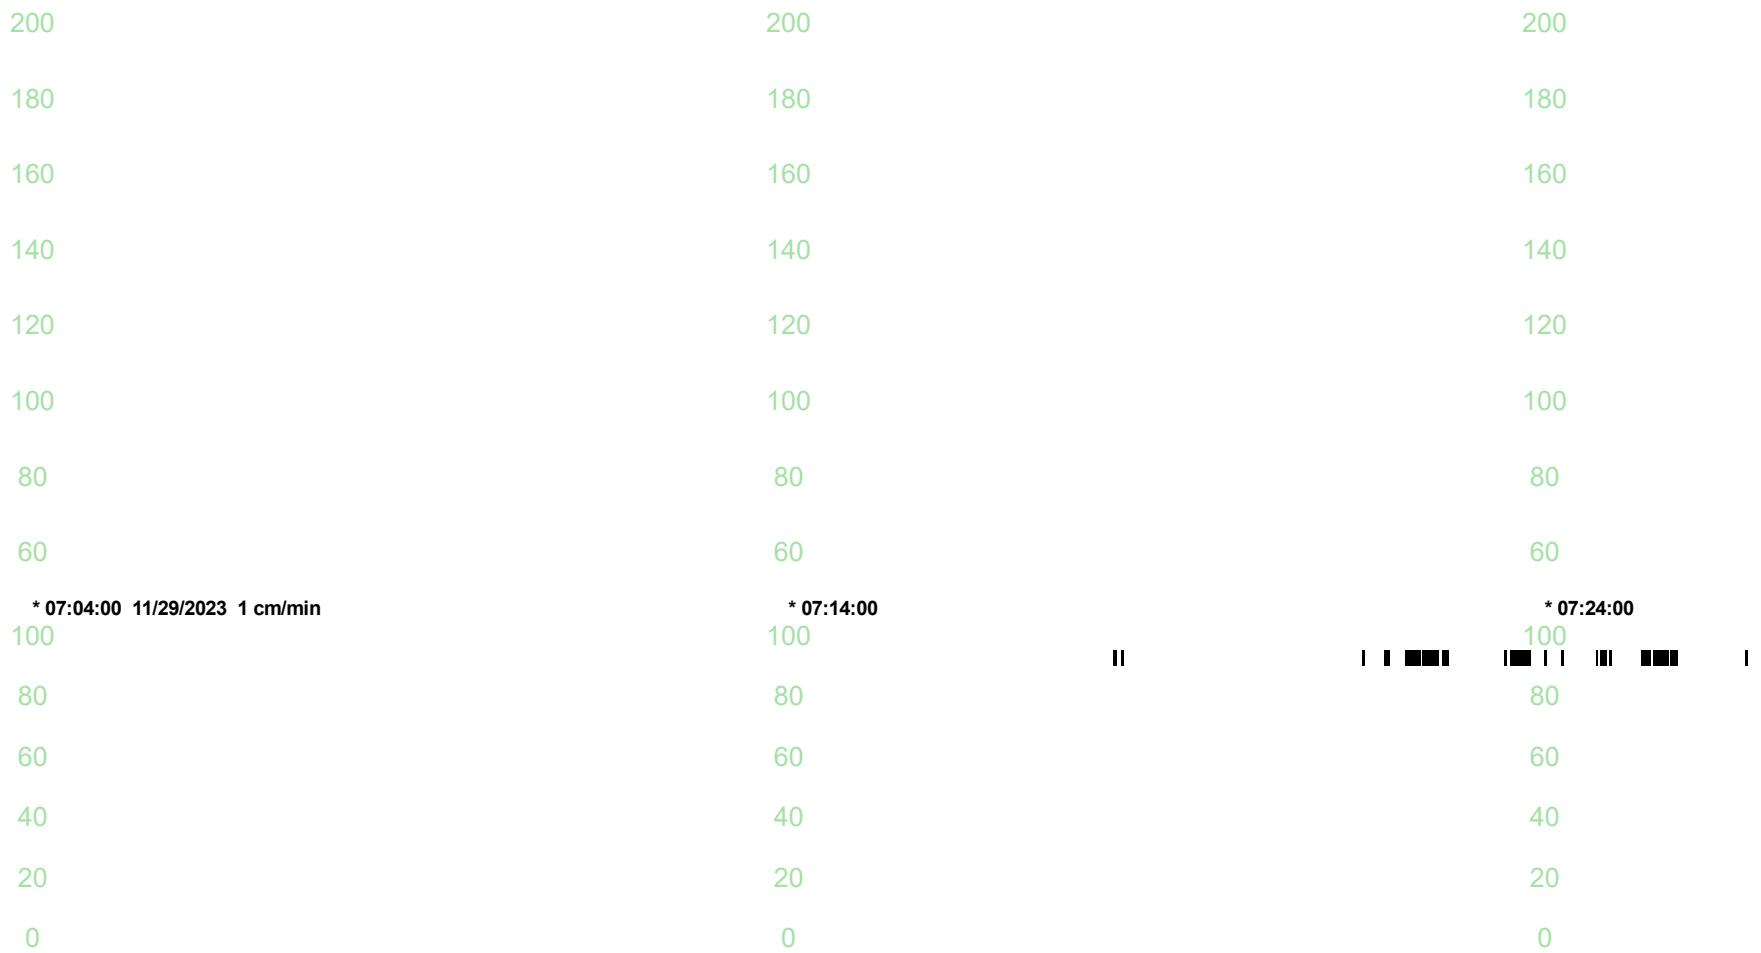

* COINCIDENCIA
Alarma con acuse de recibo


* FCF1: PERDIDA SEÑAL


* FCF1: PERDIDA SEÑAL

Alarma con acuse de recibo

Estado de coincidencia: Activado
* COINCIDENCIA
Estado de coincidencia: Activado
Alarma con acuse de recibo
** FCF1: BRADICARDIA
Alarma con acuse de recibo

Estado del monitor: En espera
Modo FCF1: no transductor
Modo Toco : no transductor
Estado del registrador: Desactivado

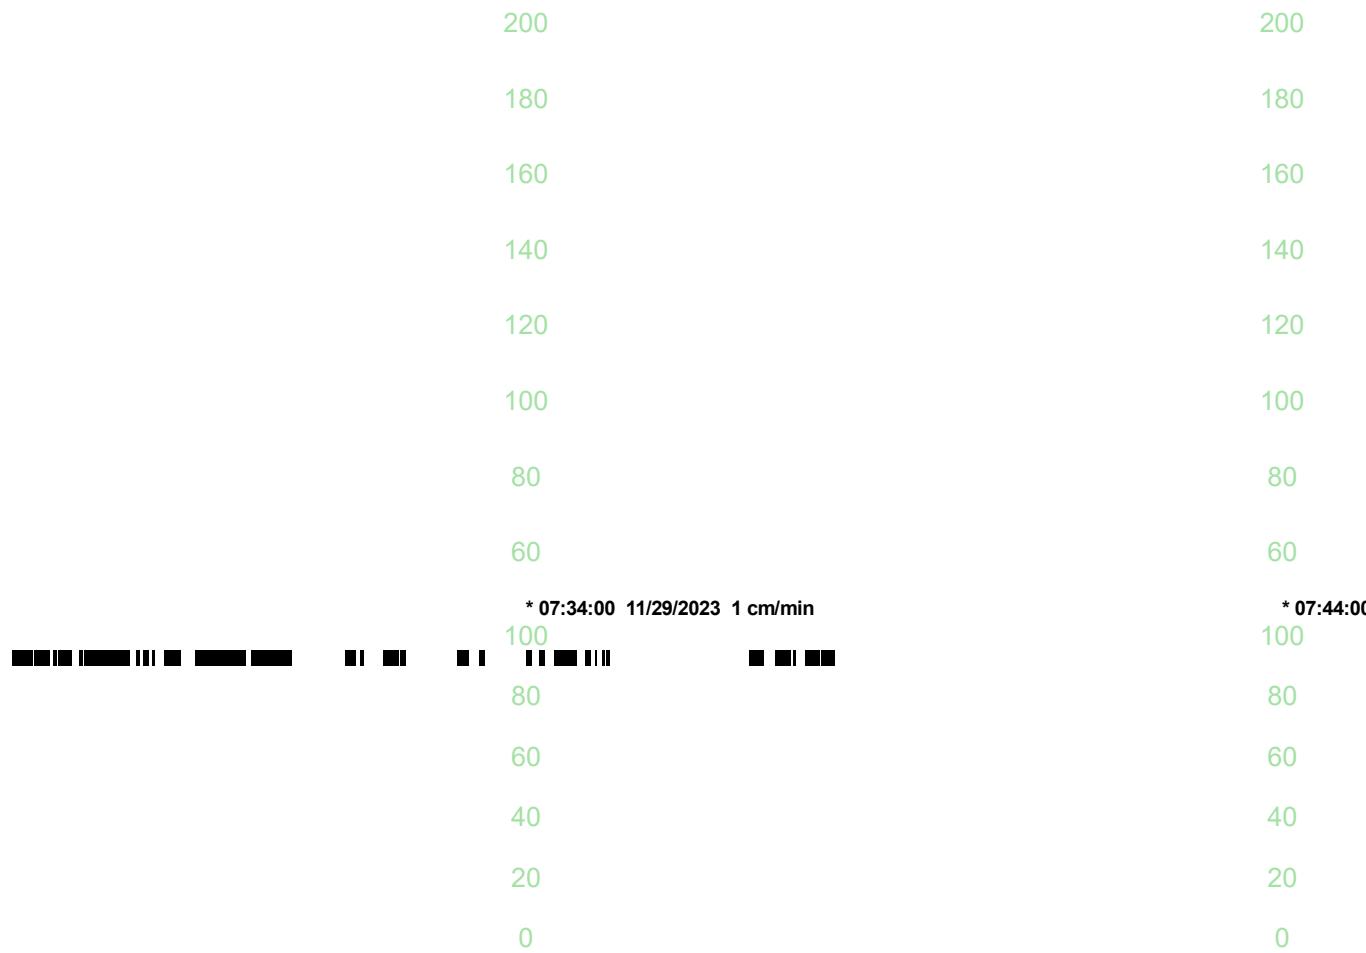

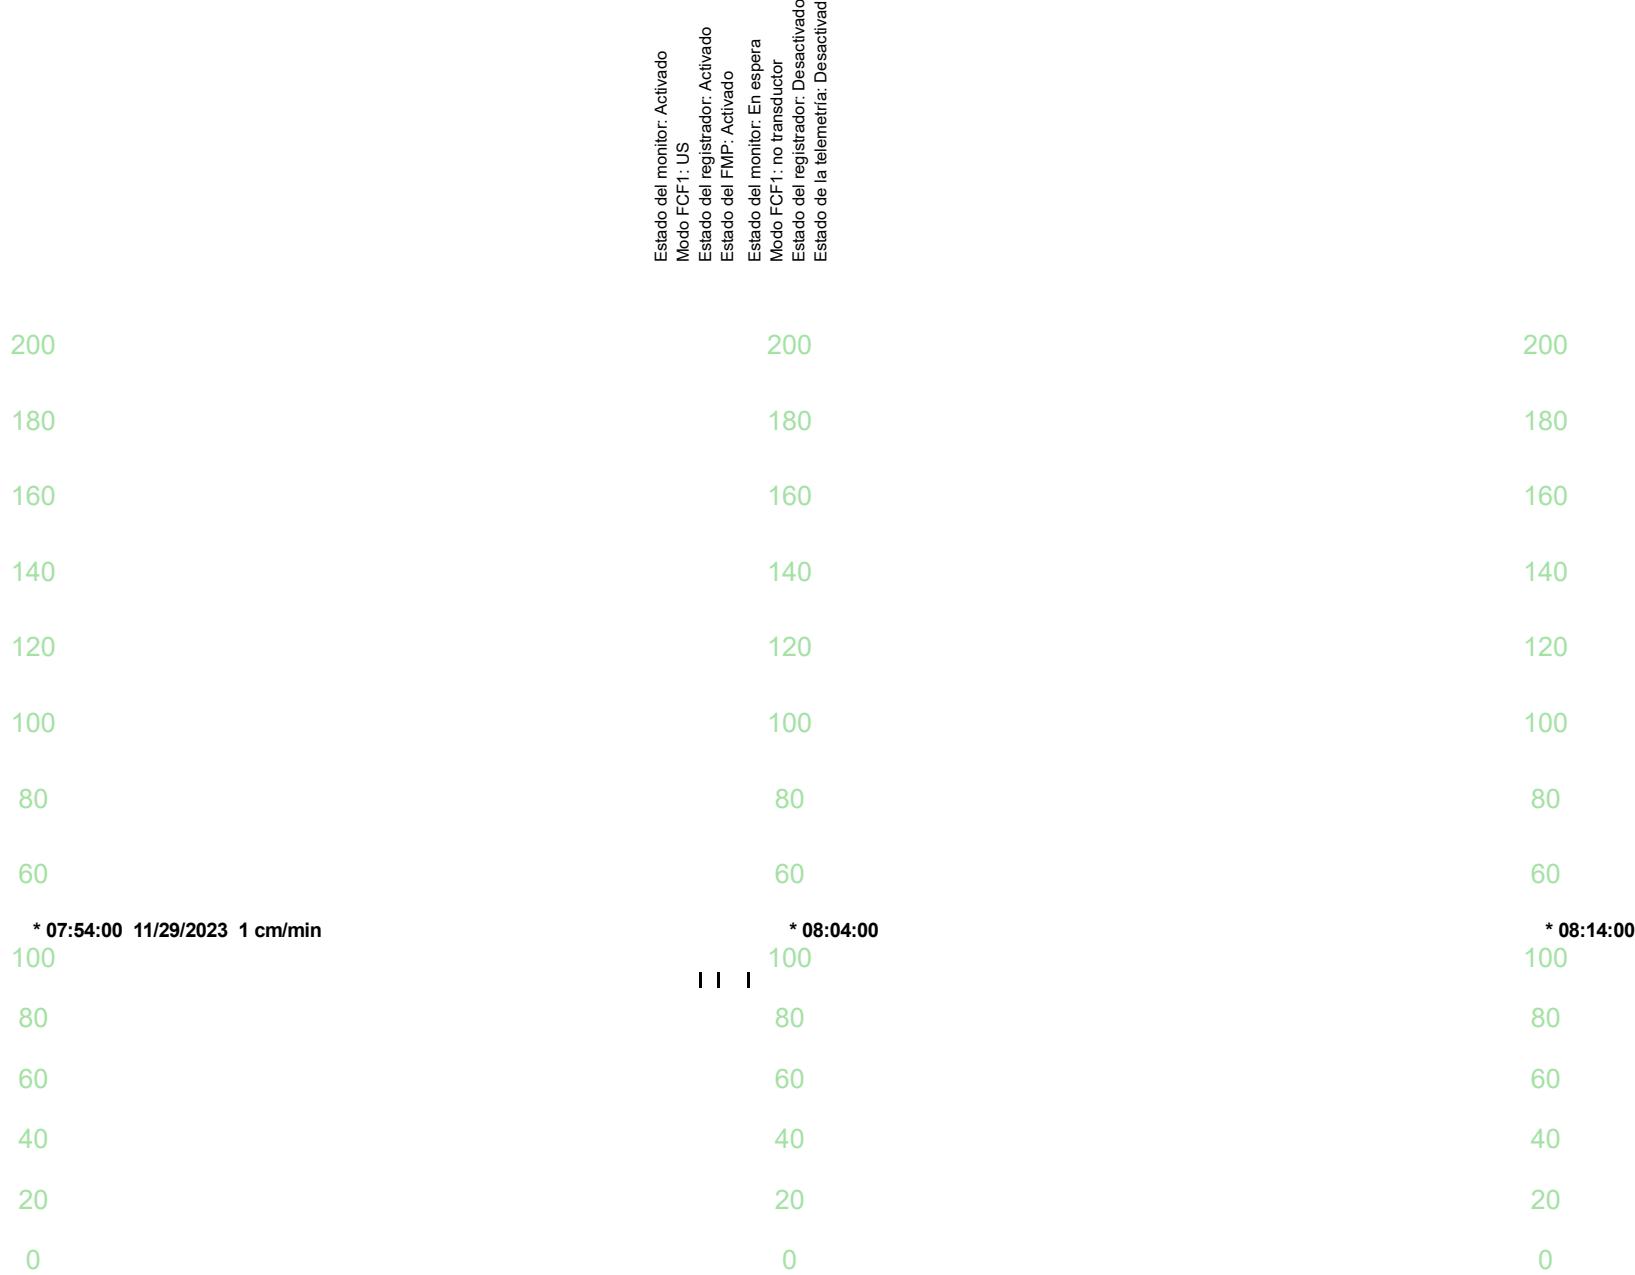

Estado del registrador: Activado
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado


* FCF1: PERDIDA SEÑAL.


Alarma con acuse de recibo

* FCF1: PERDIDA SEÑAL.
Alarma con acuse de recibo

** FCF1: BRADICARDIA


Alarma con acuse de recibo

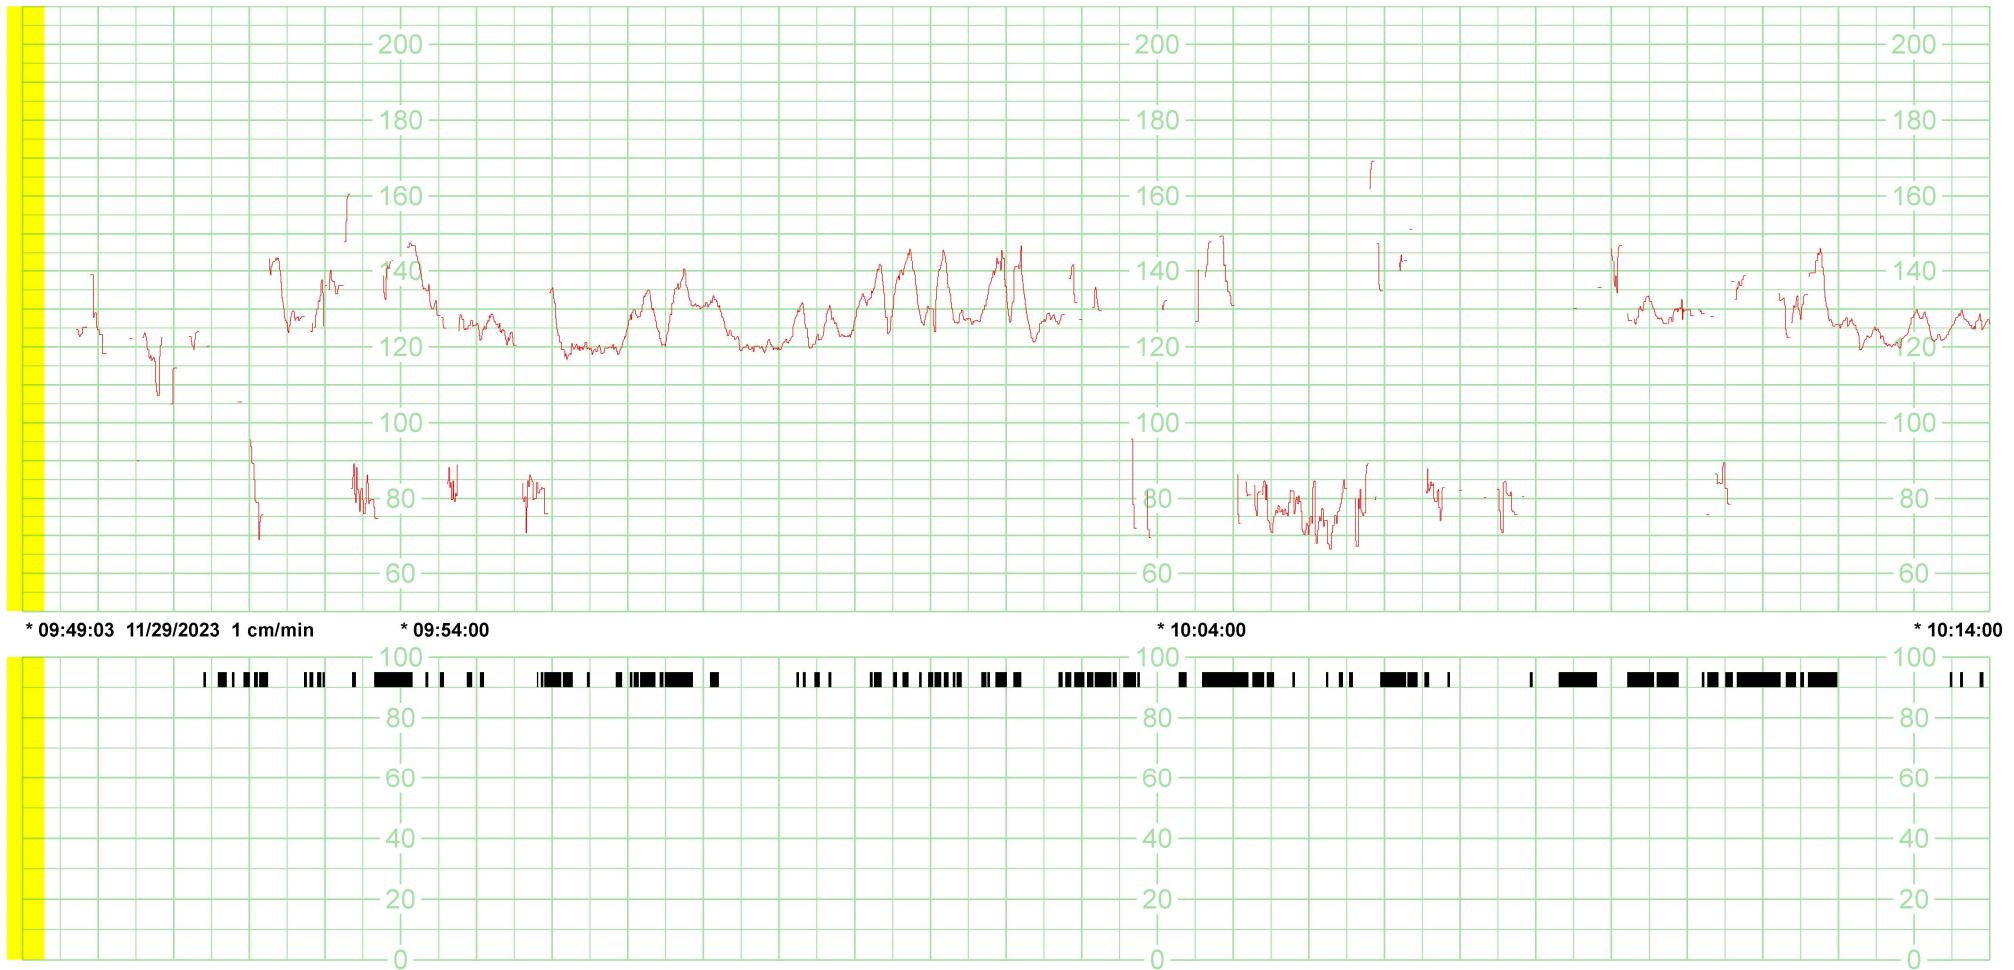

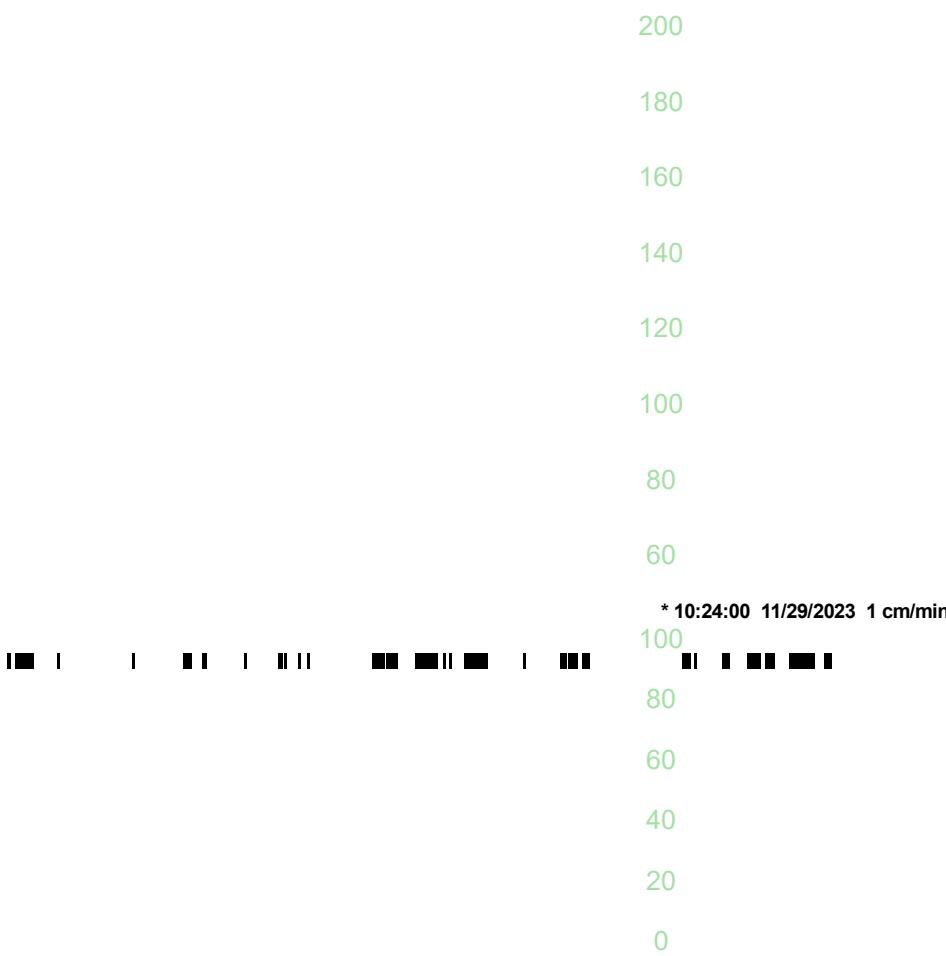

Estado del monitor: En espera
Modo FCFI: no Transductor
Estado del registrador: Desactivado


Estado de la telemetría: Desactivado

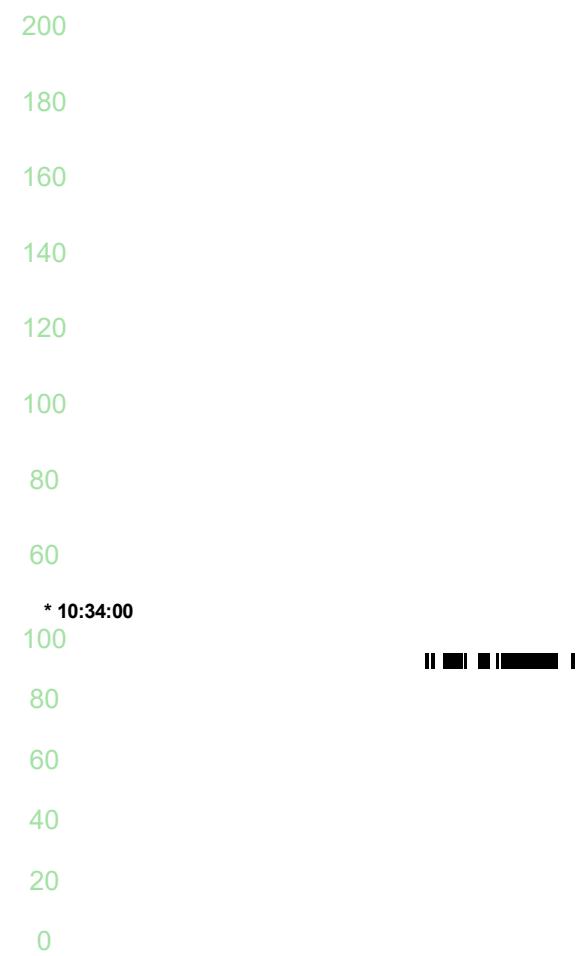


Estado de la telemetría: Activado
Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado
Modo FCFI: US
Estado del FMP: Activado



Estado del monitor: Desactivado

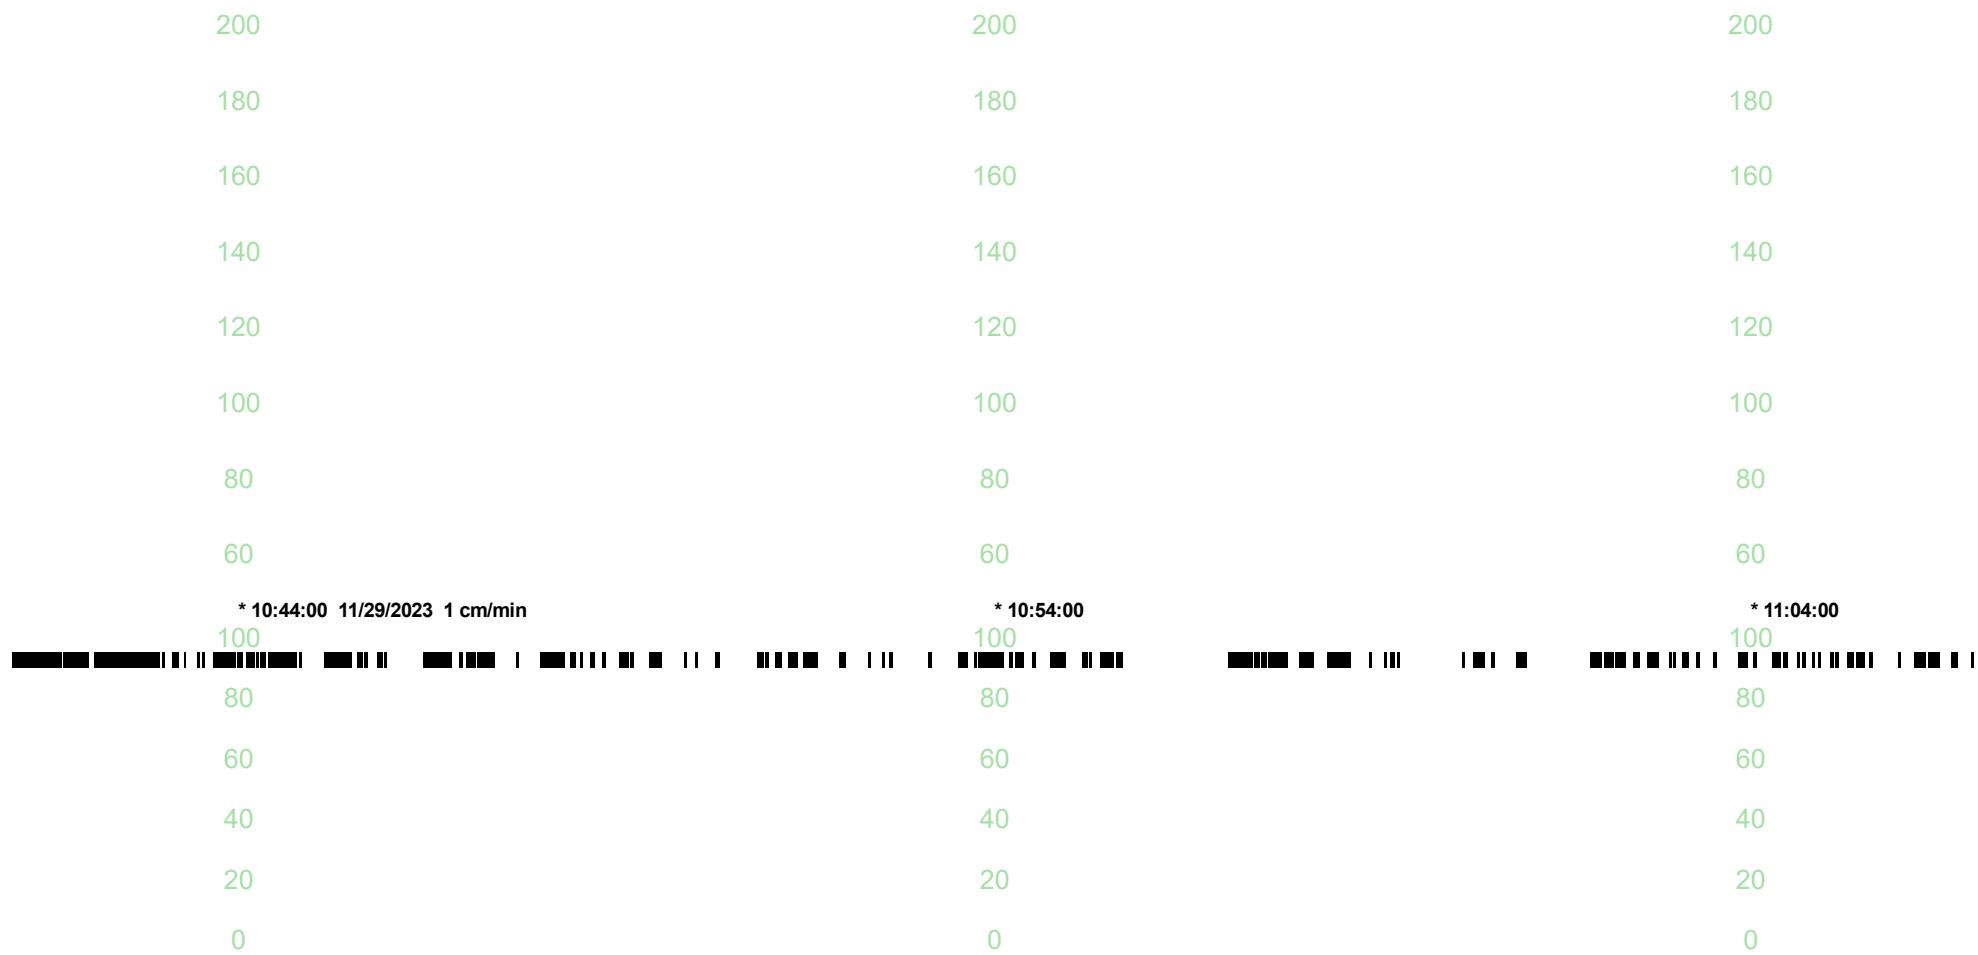

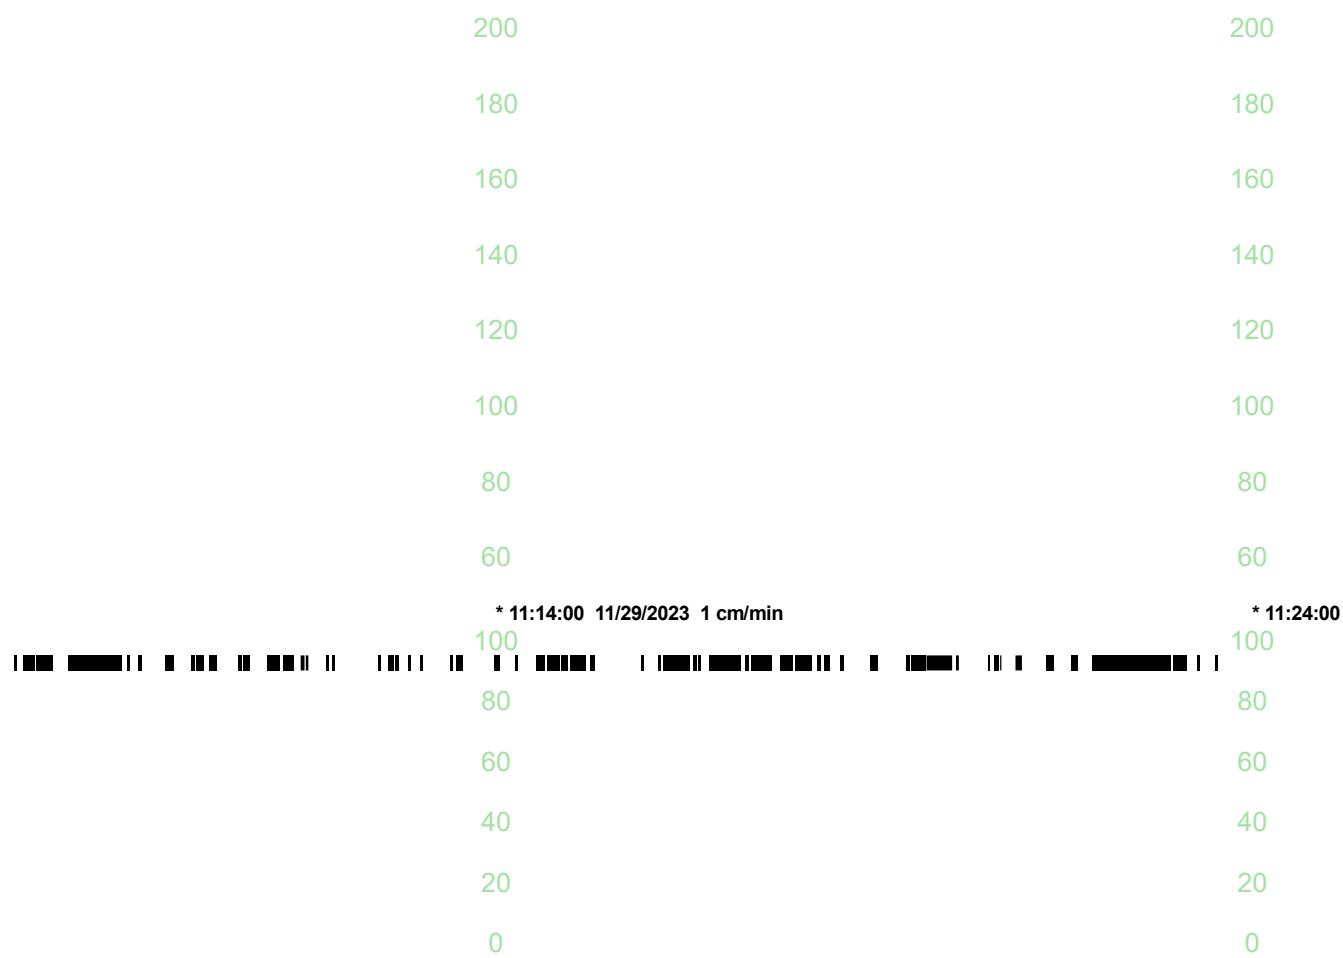

200

180

160

140

120

100

80

60

*** 11:34:00 11/29/2023 1 cm/min**

100

80

60

40

20

0

200

180

160

140

120

100

80

60

*** 11:44:00**

100

80

60

40

20

0

200

180

160

140

120

100

80

60

*** 11:54:00**

100

80

60

40

20

0


Estado del monitor: Activado
 Estado del registrador: Activado
 Estado del registrador: Desactivado


Modo FCM: SpO2


Estado de la telemetría: Activado
 Modo FCF: US
 Estado del FMP: Activado






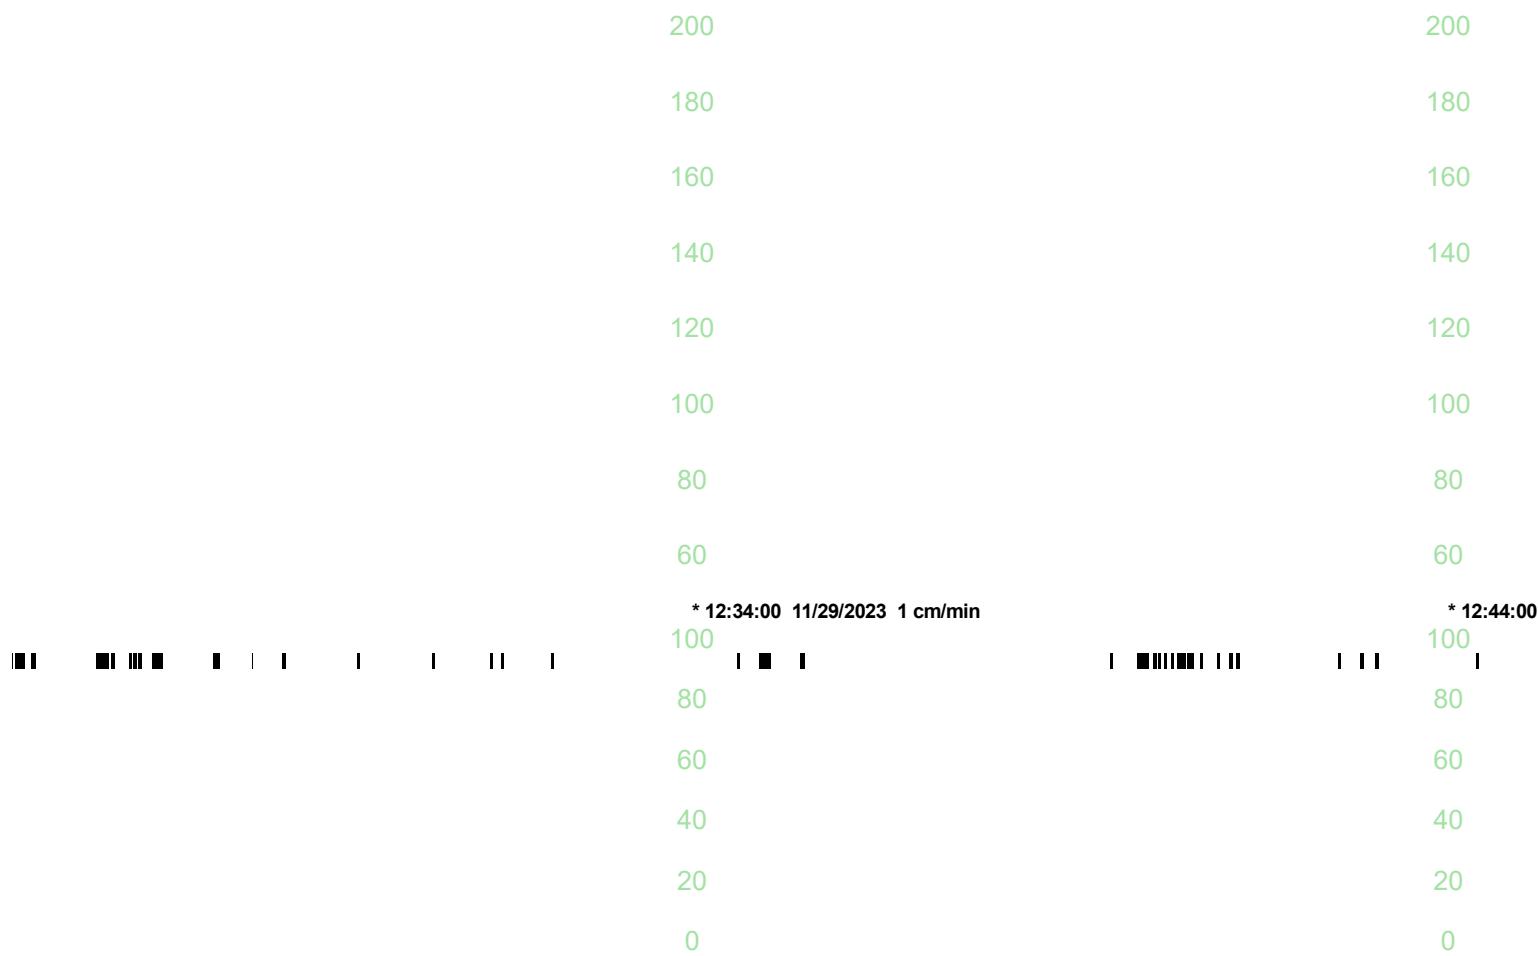

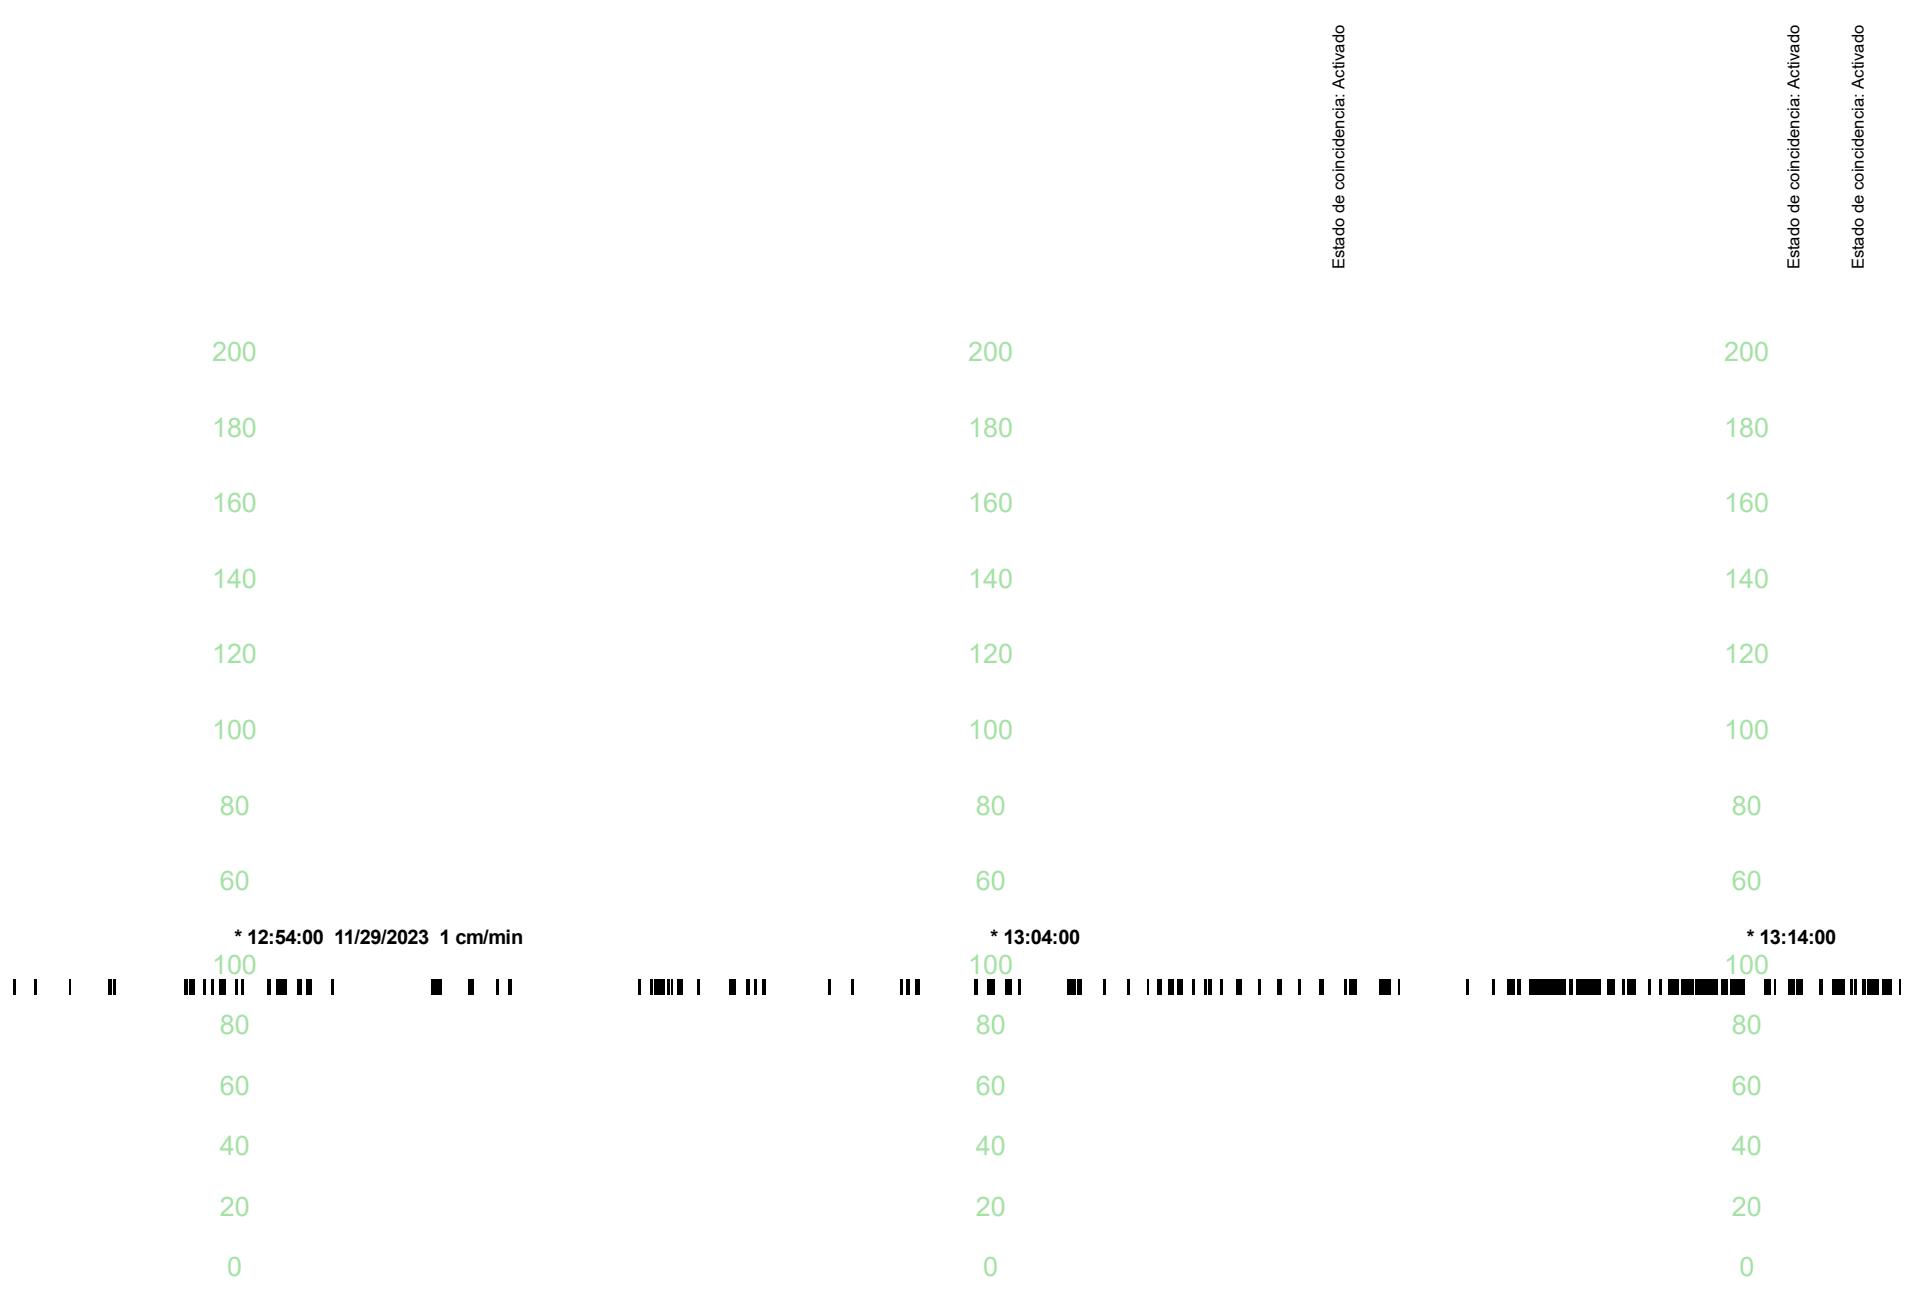


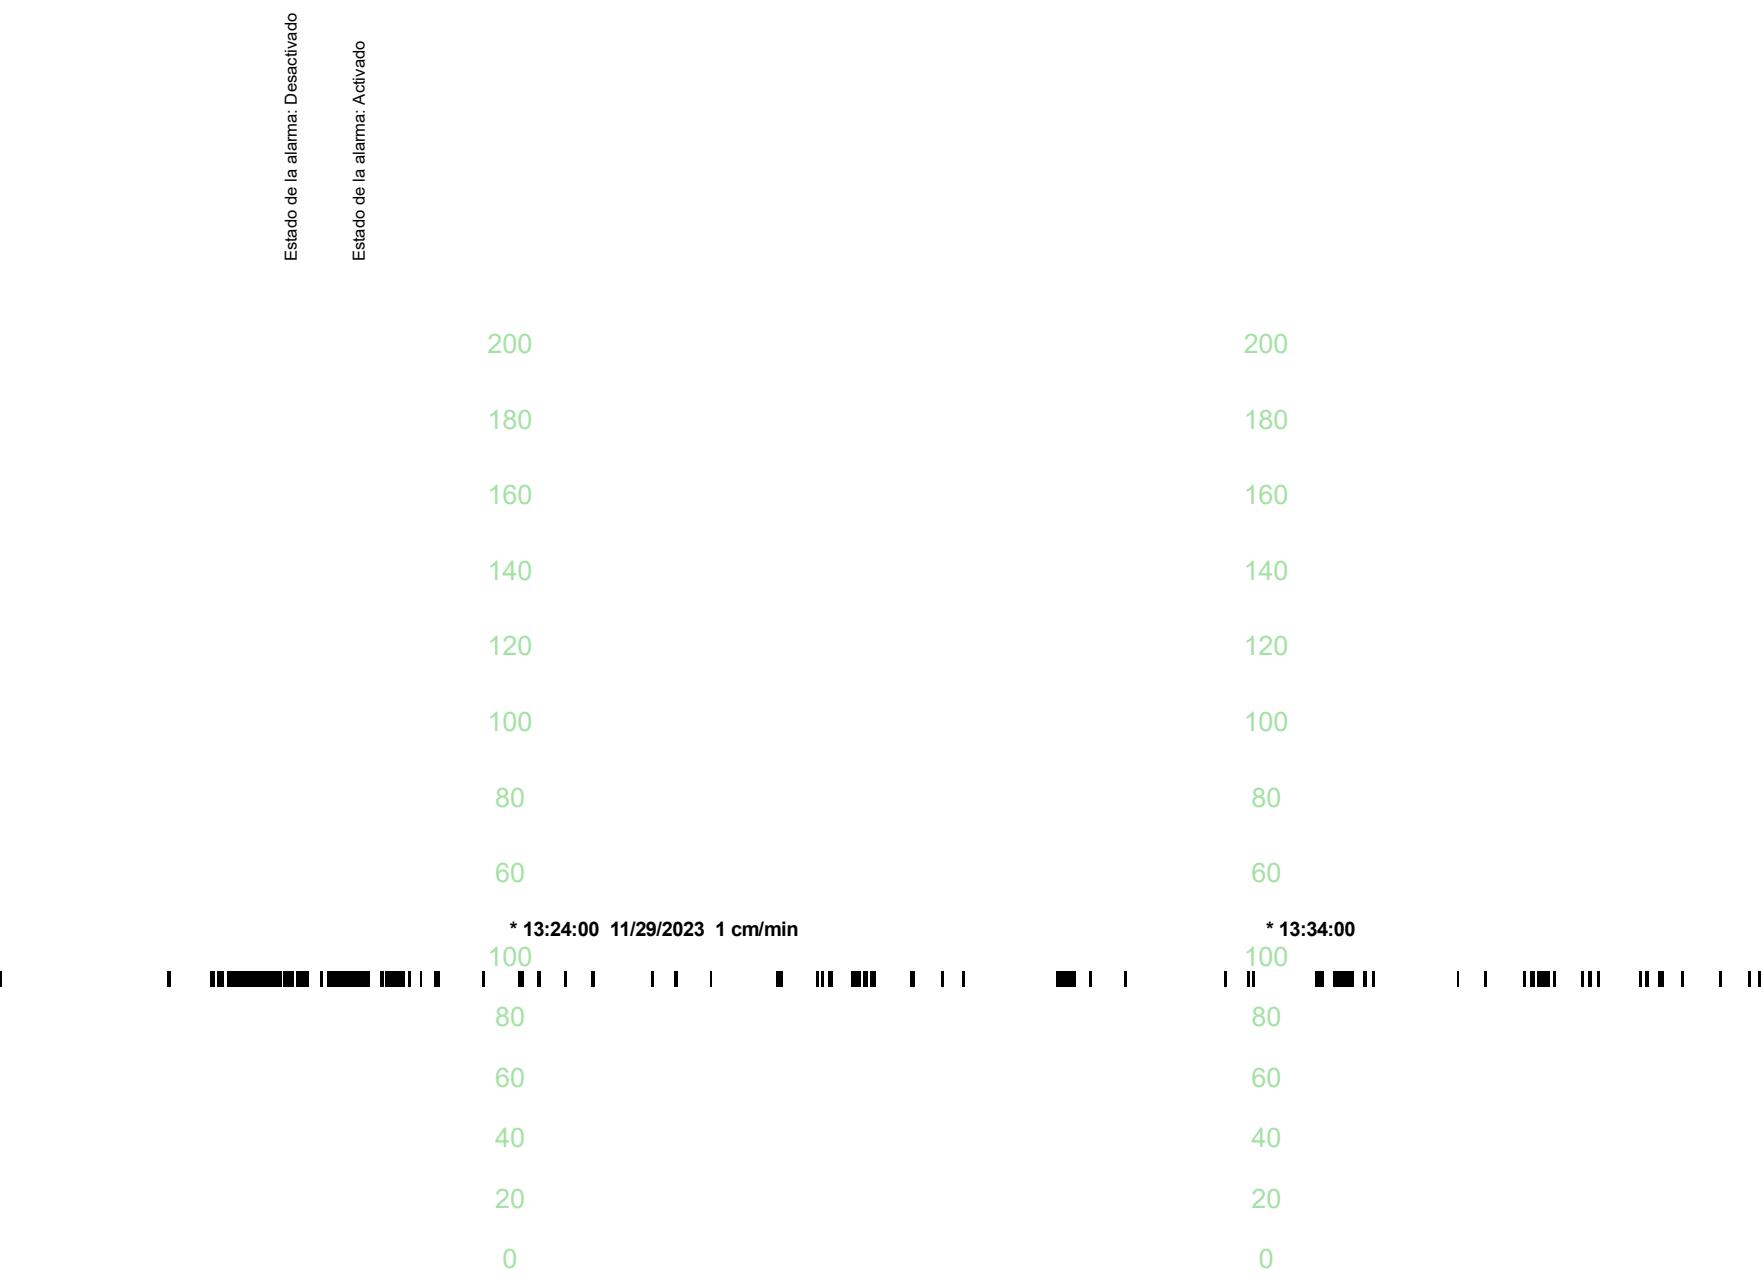

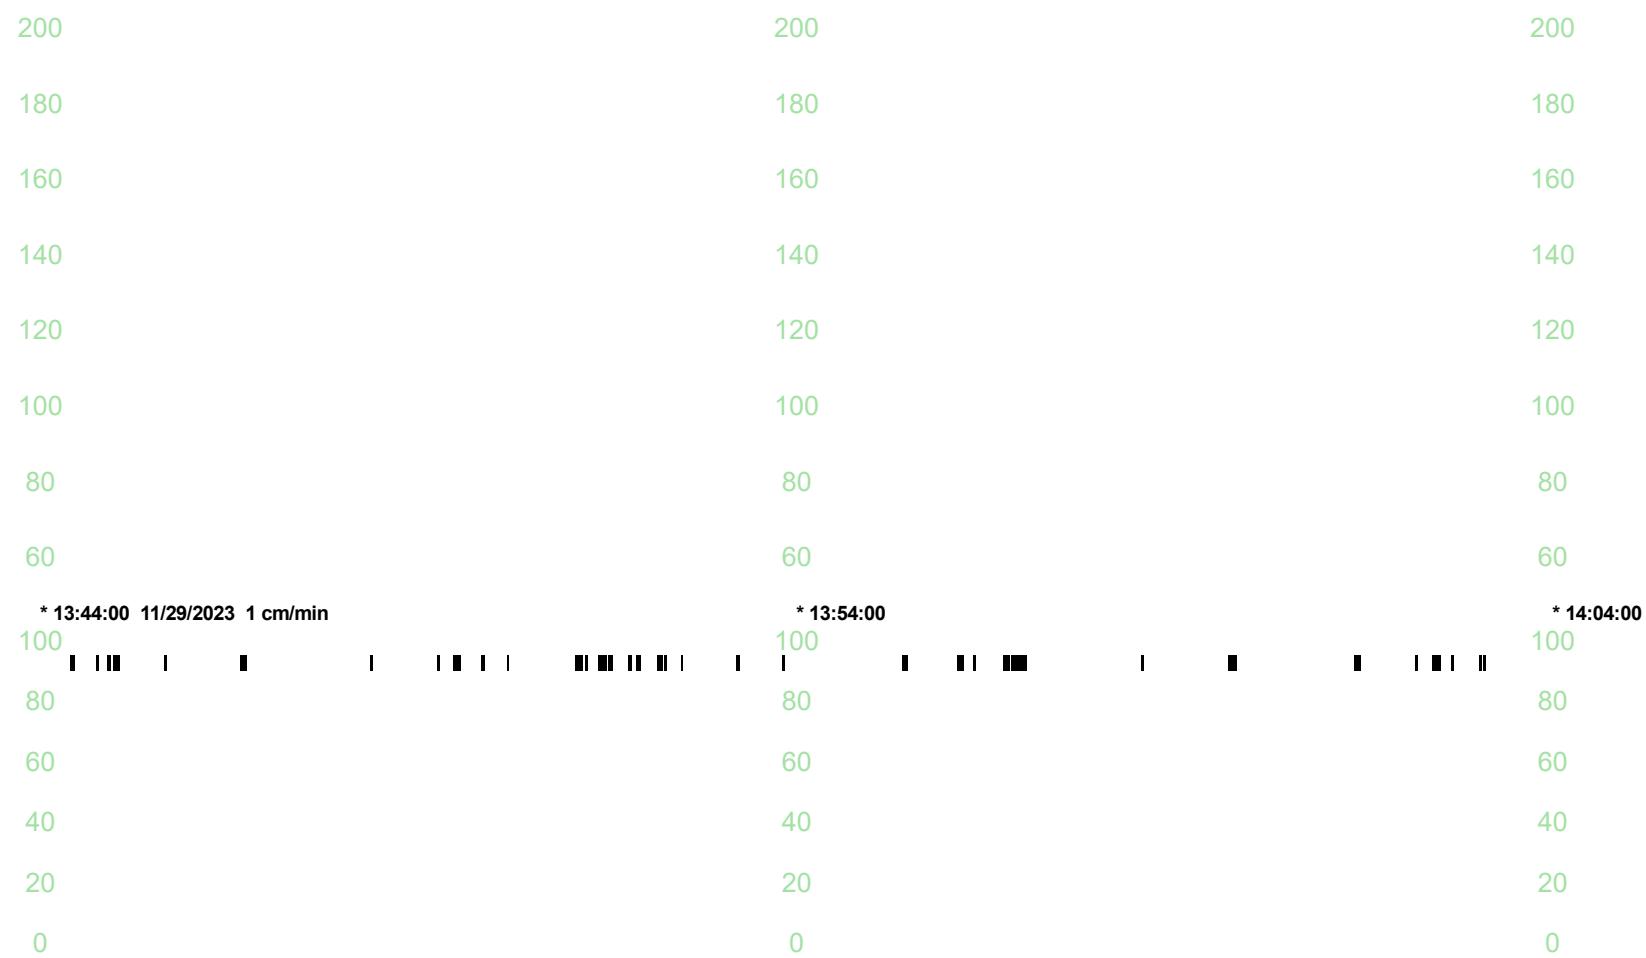




Estado del registrador: Desactivado
Estado del registrador: Activado

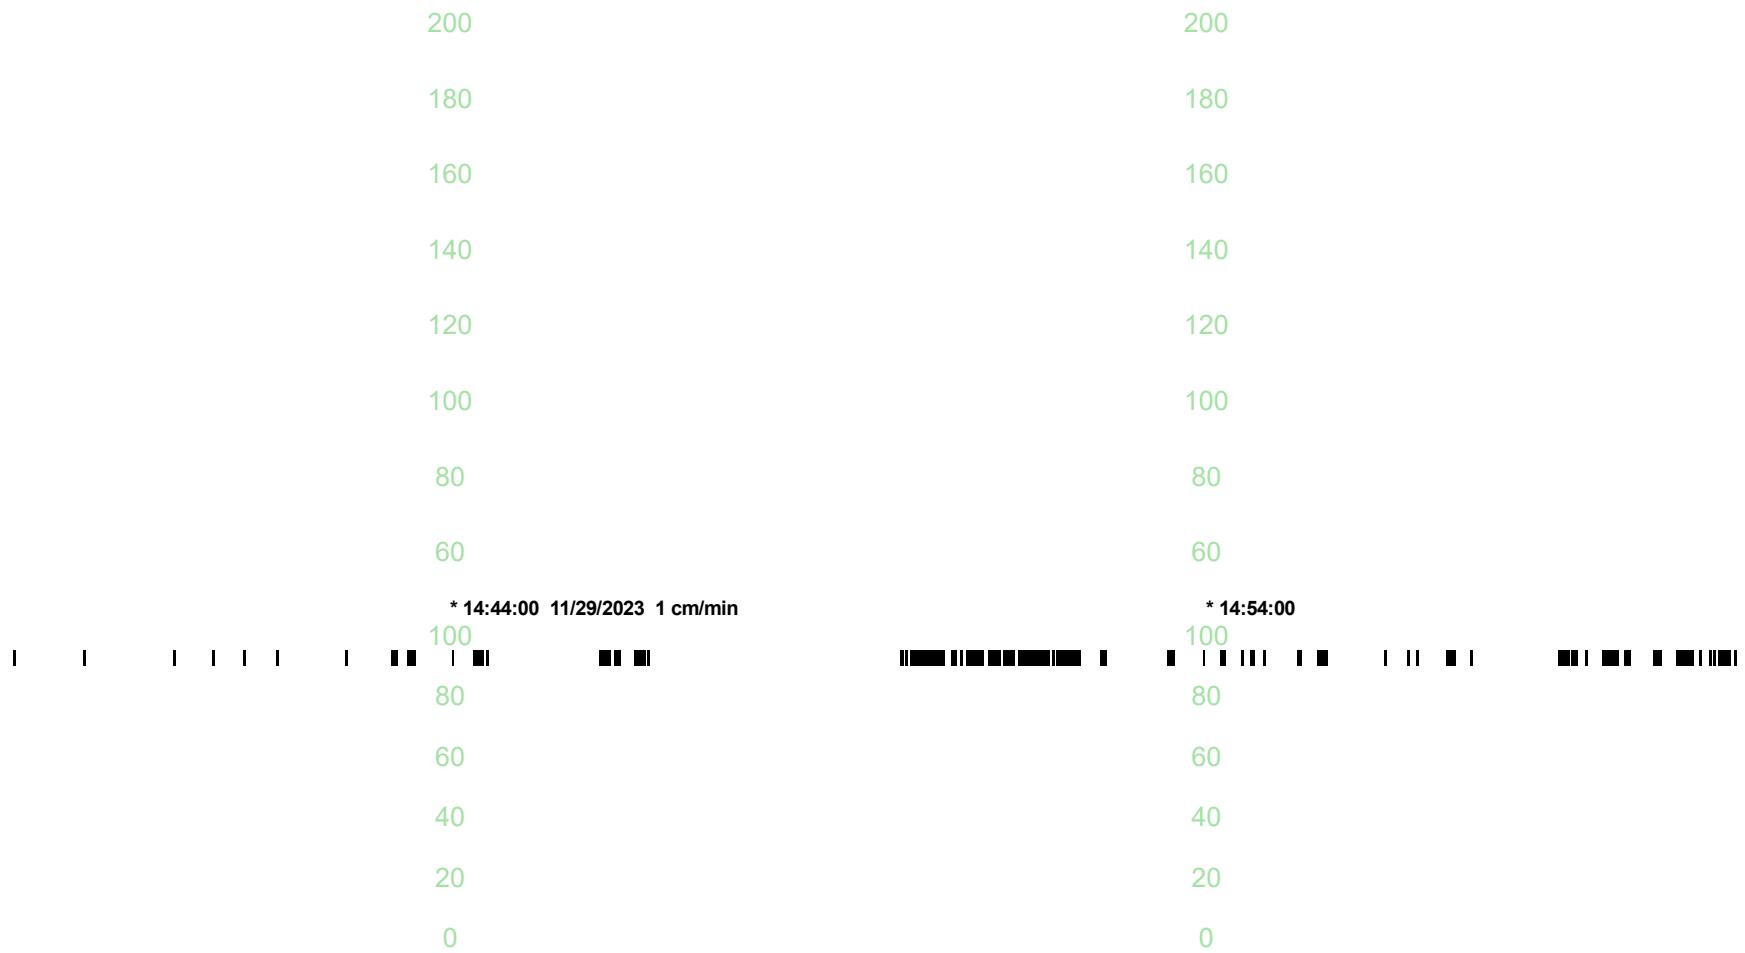


Estado de coincidencia: Activado

Estado de coincidencia: Activado

Estado de coincidencia: Activado

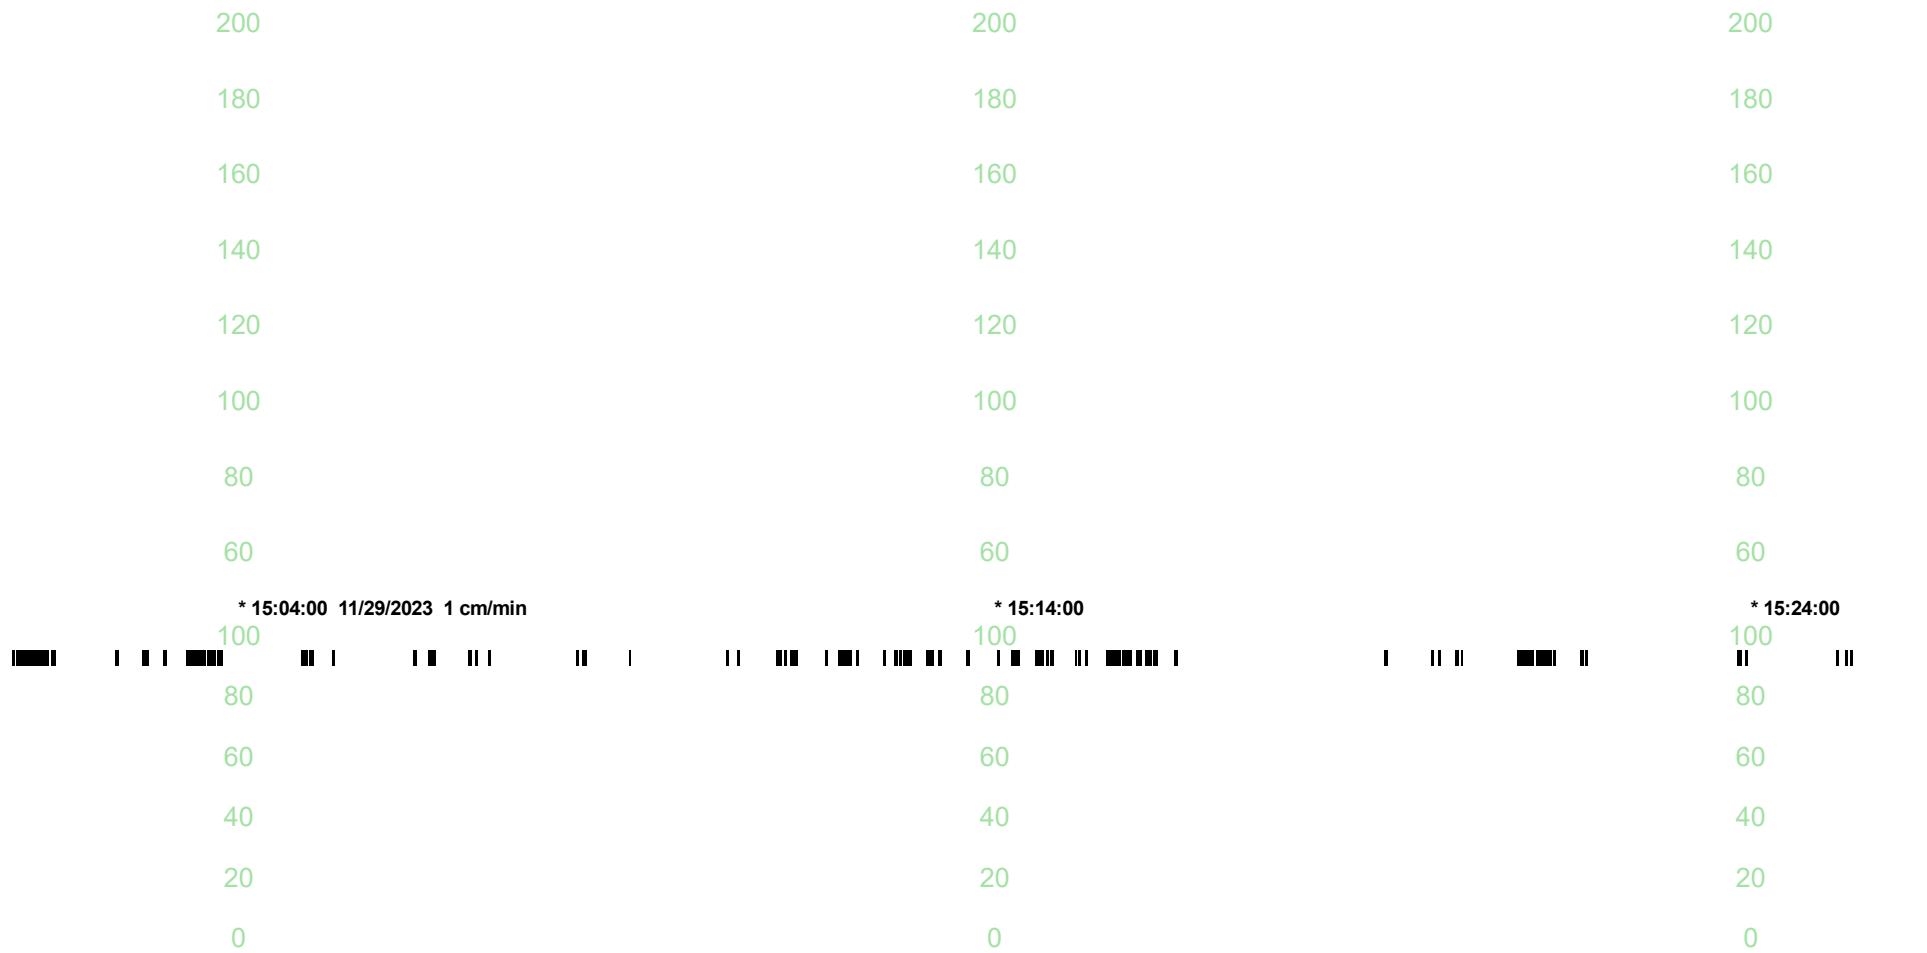


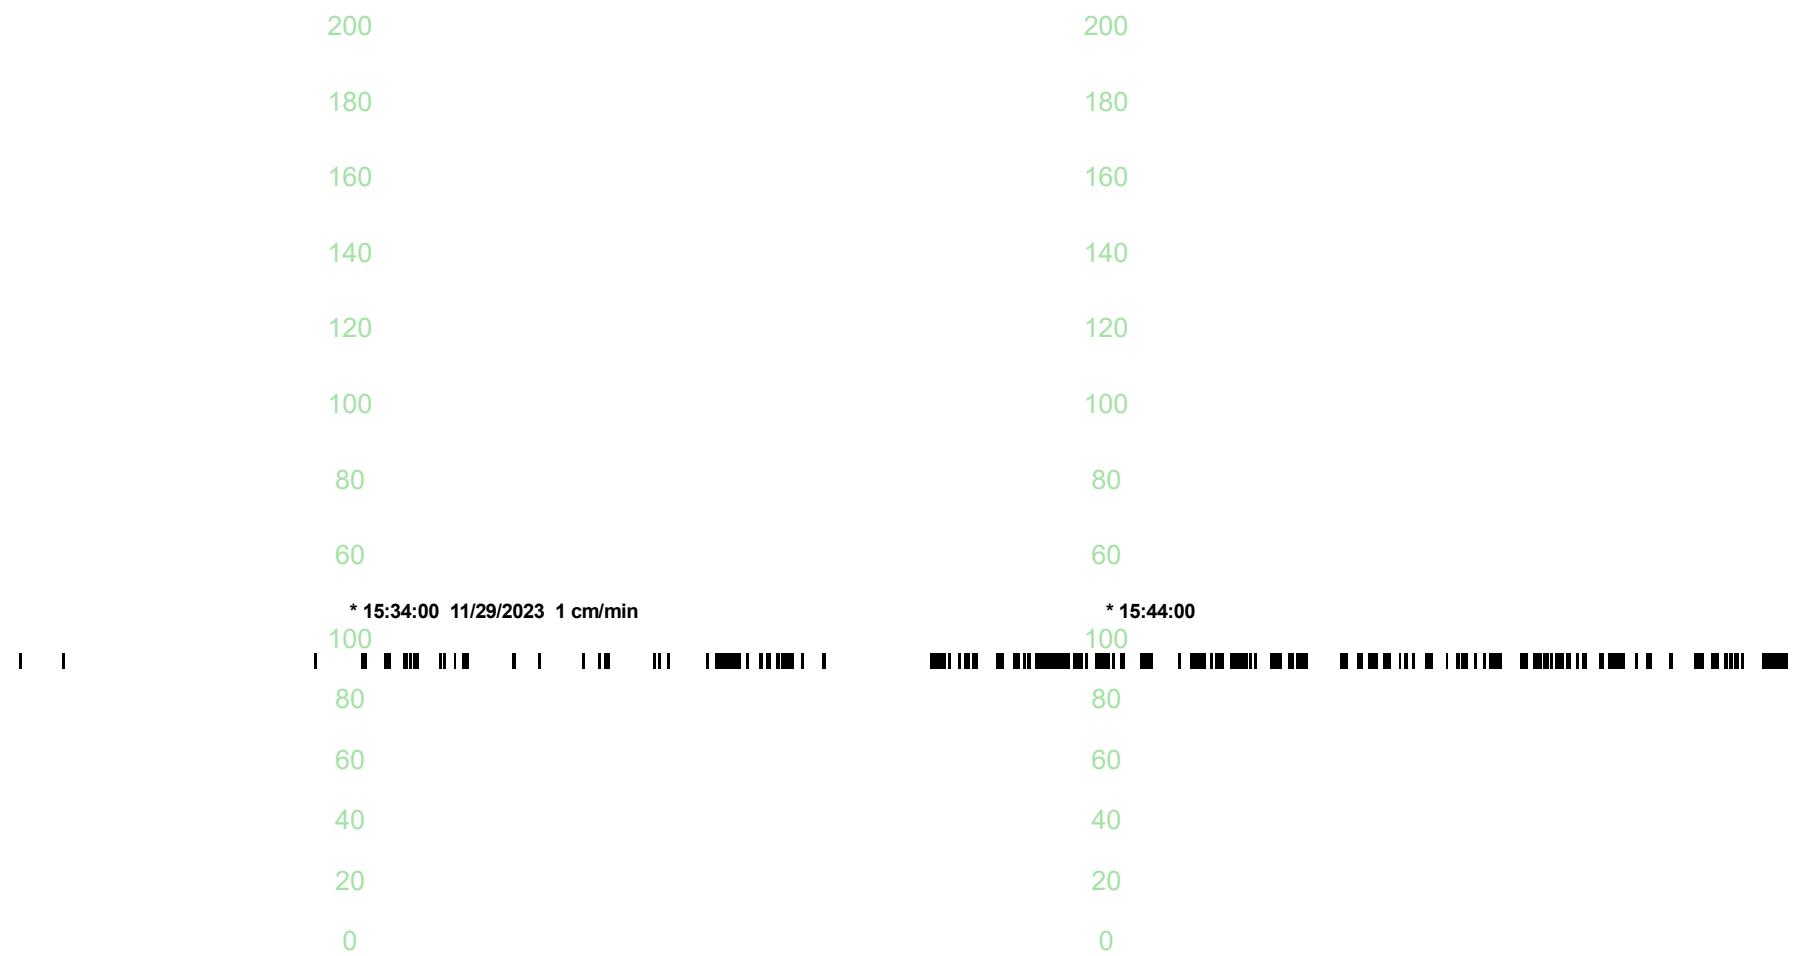

Estado de coincidencia: Activado

Estado de coincidencia: Activado

Estado de coincidencia: Activado

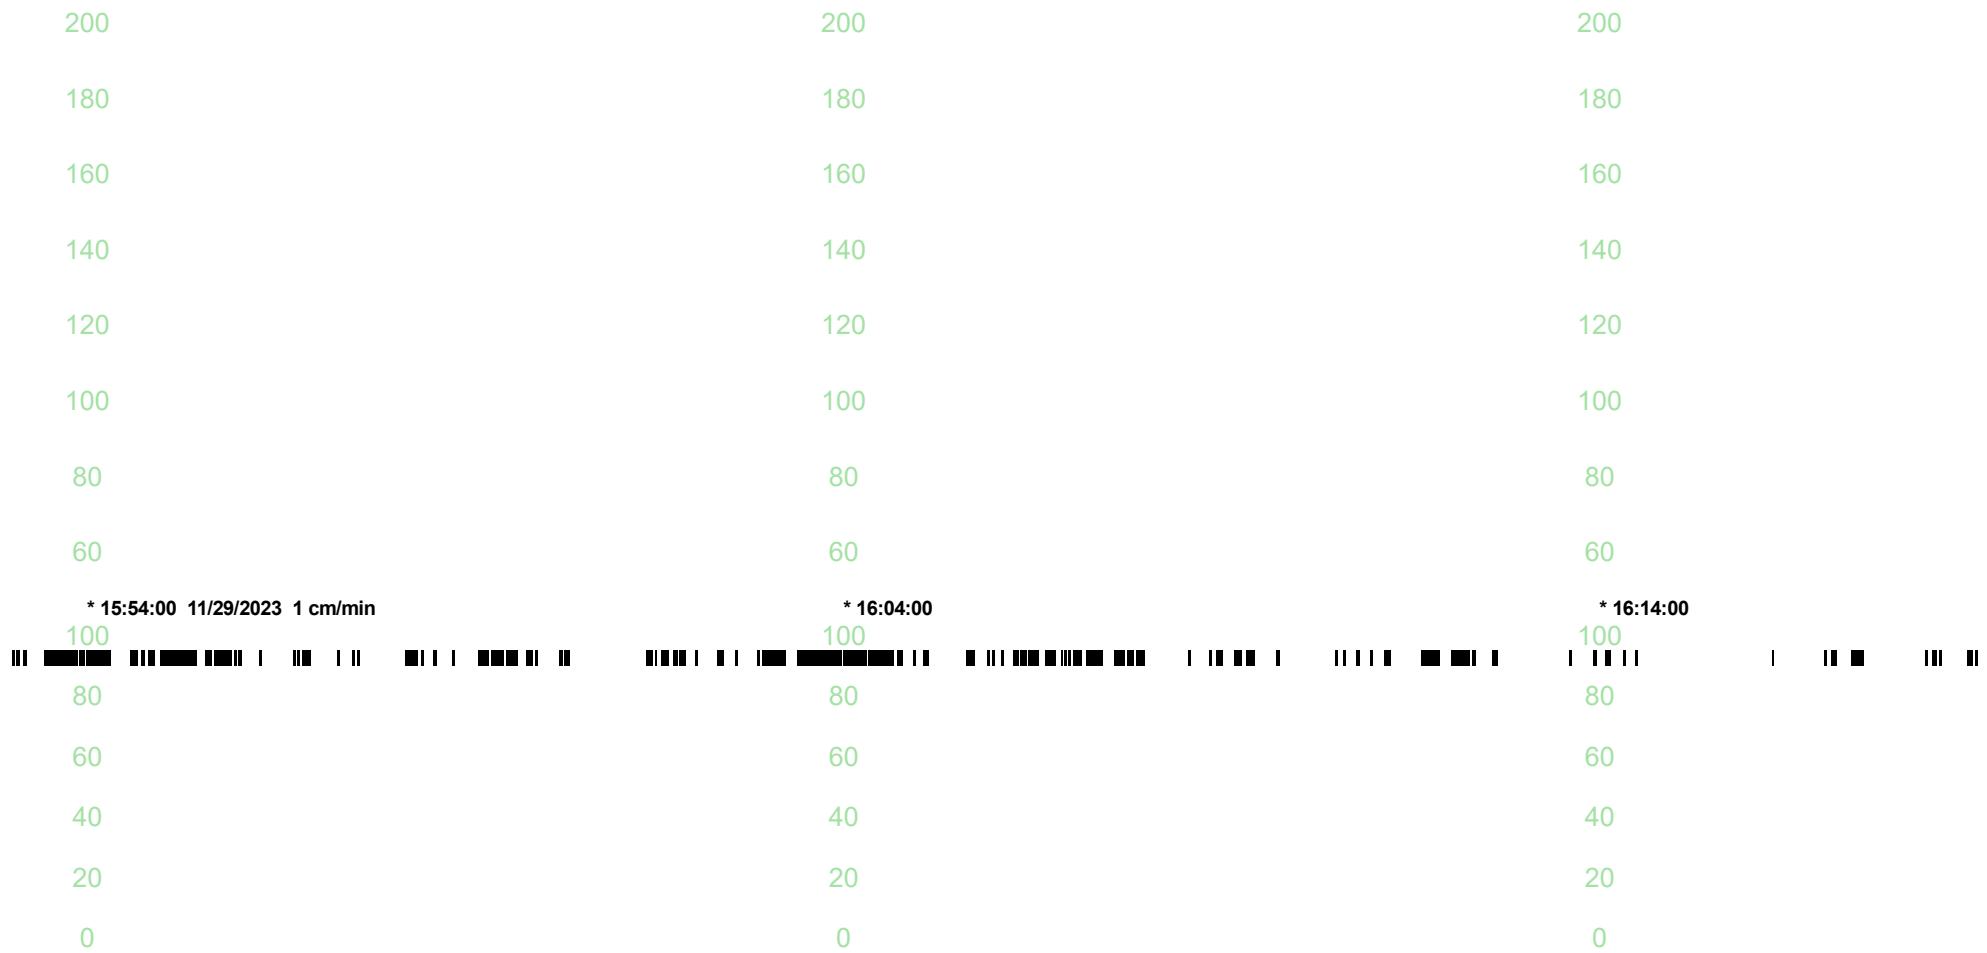

Estado de coincidencia: Activado

