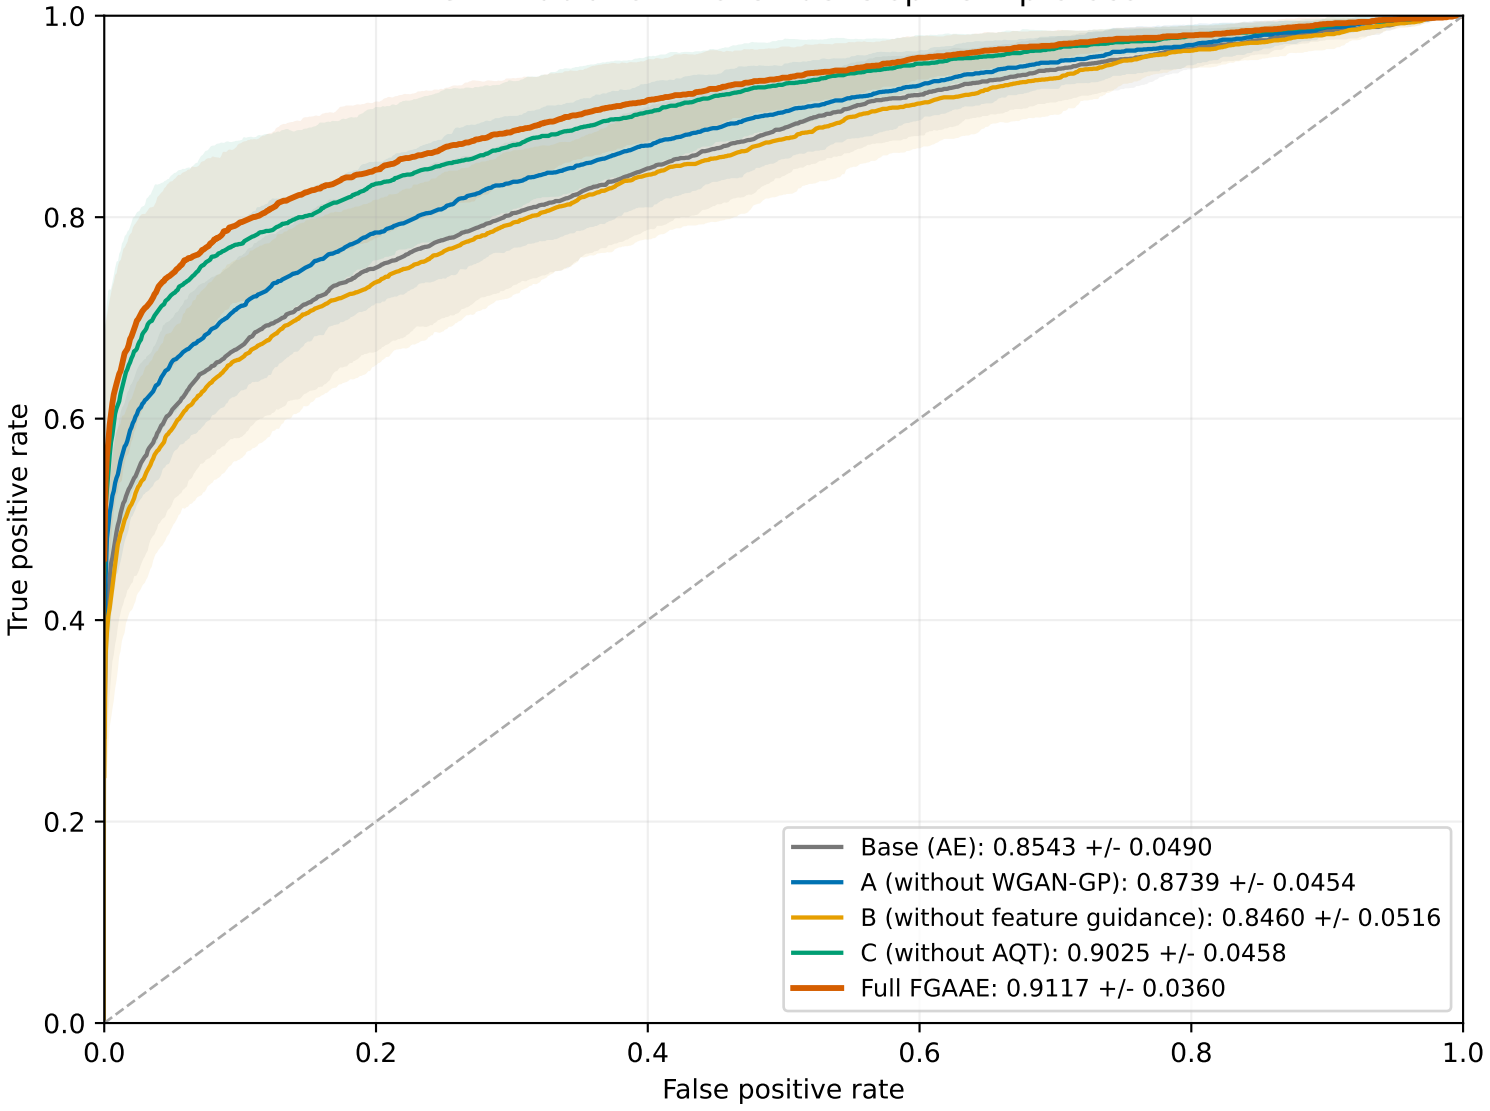

FGAAE ablation: frozen development protocol
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Base (AE): 0.8543 +/- 0.0490
A (without WGAN-GP): 0.8739 +/- 0.0454
B (without feature guidance): 0.8460 +/- 0.0516
C (without AQT): 0.9025 +/- 0.0458
Full FGAAE: 0.9117 +/- 0.0360