



Erhvervsfremme  
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø  
Tlf. 35 46 60 00  
Fax 35 46 60 01  
E-post efs@efs.dk  
www.efs.dk

1. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
1999-7053-1274

Nr.: 2000-7053-1572


Udgave: 1

Dato: 2001-08-15

Gyldig til: 2009-07-15

Systembetegnelse: TS 24.41-013

## AUTOMATISK KONTROLVÆGT

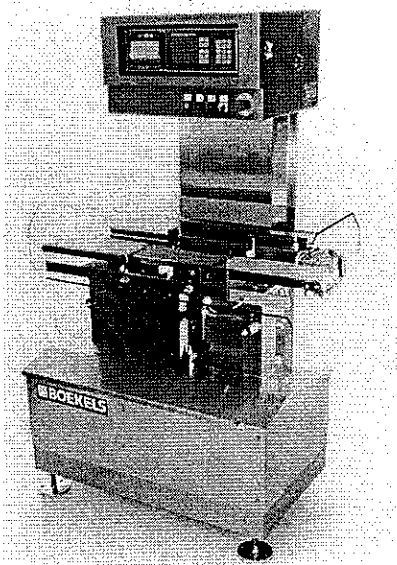

**Producent**

Dr. Hans Boekels GmbH & Co., Tyskland.

**Ansøger**

Dr. Hans Boekels GmbH & Co., Tyskland.

**Art**

Kontrol- og sortervægt.

**Type** visningsenhed  
underpart

EWK 409, EWK 1500 og EWK 2000.  
WS x y.

**Anvendelse**

Industri.

**Suppl. udstyr**

Intet.

**Typegodkendelse**

I overensstemmelse med OIML R51, 1996.

Vægten er herefter også godkendt i varianter med visningsenheder type EWK 1500 eller EWK 2000.

Underpartens typebetegnelse er WS x y.

x er maksimumslast. y findes ikke eller er D eller SD.

Vægtens digitale vejeceller benævnes WZ x D.

x er vægtens største maksimumslast med den vejecelle.

Vægten er herefter også godkendt med maksimumslaster til og med 100 kg.

**BEMÆRK !**

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

## 1. LEGALE MÅLEDATA

I overensstemmelse med OIML R51, udgave 1996.

Følgende varianter er godkendt:

Underpart	Max	e	n
WS 600 g y	600 g	$\geq 0,1$ g	$\leq 7500$
WS 1,25 kg y	1,25 kg	$\geq 0,2$ g	$\leq 7500$
WS 3,0 kg y	3 kg	$\geq 0,5$ g	$\leq 7200$
WS 6,0 kg y	6 kg	$\geq 1$ g	$\leq 7200$
WS 10 kg y	10 kg	$\geq 2$ g	$\leq 6000$
WS 30 kg y	30 kg	$\geq 5$ g	$\leq 7200$
WS 60 kg y	50 kg	$\geq 10$ g	$\leq 6000$
WS 100 kg y	100 kg	$\geq 20$ g	$\leq 6000$

## 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	Forinden verifikation aflæses vægtens kalibreringsfunktions tællerværdi. Tællerens værdi vises i Dialog nr. 630 benævnt "Boekels". Dialogen er beskyttet med kodeord.
Påskrifter	Ved eller på type/verifikationsskiltet skiltes med kalibreringsfunktions tællerværdi.
Plombering	Skiltet med kalibreringsfunktions tællerværdi sikres med forseglingsmærkater eller plomber.

## 3. KONSTRUKTION

### EWK 1500 har følgende karakteristika:

LCD monokrom skærm, folietaster, numerisk tastatur, 6 funktionstaster, kursortaster, automatisk nulstilling, kabinet i rustfrit stål, forekommer med seriel interface RS 422 / RS 232 /strømsløjfe og med termoprinter.

### EWK 2000 har følgende karakteristika:

LCD monokrom or color skærm eller TFT farveskærm, folietaster, numerisk tastatur, 6 funktionstaster, kursortaster, automatisk nulstilling, kabinet i rustfrit stål, forekommer med seriel interface RS 422 / RS 232 /strømsløjfe med 20 mA seriel interface og med termoprinter.

## 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1572.

Med dette tillæg forlænges typegodkendelsens gyldighedsperiode.

P. Claudi Johansen.