



# BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

## TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 8/1982

Udgave 1


Dato 1982-03-01

Gyldig til 1984-06-30

Systembetegnelse: IV-161 cs

*Sat i kraft 8/82*

## MÅLEANLÆG

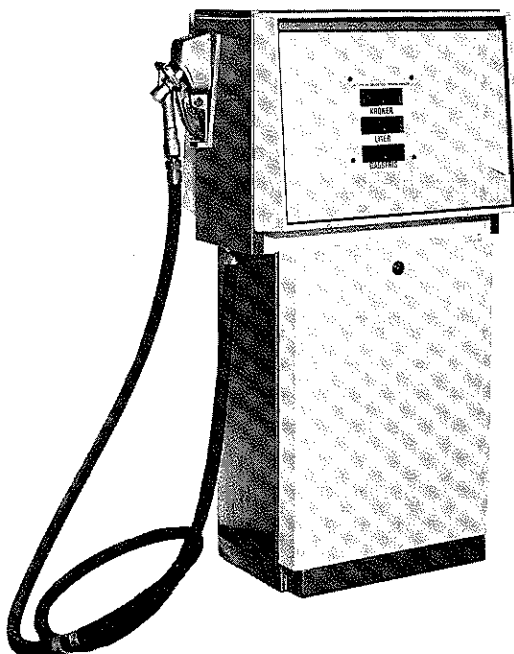

**Fabrikant:** Schwelmer Eisenwerk, Tyskland og Tatsuno Ltd., Japan.  
**Anmelder:** Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.  
**Art:** Gasstander med elektronisk tællerværk.  
**Type:** Schwelm/Tatsuno.  
**Anvendelse:** Til udmåling af flydende gas.

### 1. JUSTERTEKNISKE DATA

**Kapacitet:** 50 l/min.  
**Mindste lovlige udmåling:** 20 l

<b>Tællerværk:</b>	Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
		deling	0,01 kr.
	Litertæller,	kapacitet	999,99 l
		deling	0,01 l
	Dagspris,	kapacitet	99,99 kr. pr. l
		deling	0,01 kr.

**Justertolerance:**  $\pm$  5 %

**BEMÆRK:** Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

### BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



# TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 8/1982

Systembet.: IV-161 cs

## 2. JUSTERBESTEMMELSER

### Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

### Påskrifter:

Eventuel fjernregistrering mærkes »Ujusteret«.

### Skalaplade:

Kroner, liter, dagspris.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

### Justerskilt:

Til flydende gas.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. ....l.

Mindste lovlige salg ....l.

### Plombering:

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

**Justerskilt** sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans dæksler over reguleringsskruer, cylinder- og bunddæksel samt topstykke hver for sig og måleorgan til standers chassis.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste bagdæksel sikres ikke).

Elektronikboxen og tandhjulsgear under denne sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i sikkerhedsplomberingen.

## 3. KONSTRUKTION

Standeren er identisk med den i bekendtgørelse nr. 466, systembetegnelse IV-96c beskrevne.

Dog er det mekaniske tællerværk erstattet af et elektronisk tællerværk af fabrikat TATSUNO, model RFU 8001A, som har indbygget 2-kanal impulsgiver og krone-, liter- og dagsprisvisning på begge sider.

I tilfælde af strømsvigt under tankning fastholdes litervisningen på det ene display i mindst 5 minutter.

## 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1061/81, dateret 1981-10-08.

*E. Repstorff Holtveg*