

Målemaskine

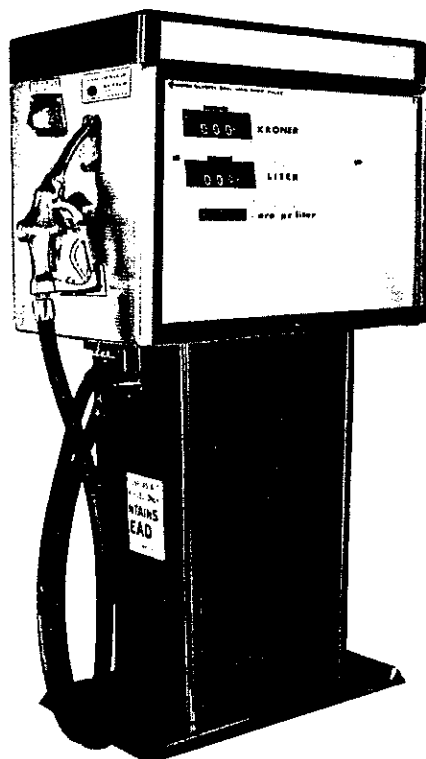


fig. 1.

Fabrikeret af: Wayne Pump Company, Symington Wayne Corporation, Salisbury, Maryland, USA og Wayne Tank & Pump Comp. Ltd., Bracknell, England.
Anmeldt af: A/S Biro, København.
Anvendelse: Til udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.
Kapacitet: 50 l/min.

Tællerværk:

Detaillitertæller:	(Ciffertæller)
Kapacitet:	100 l
Inddeling:	0,1 l
Detailpristæller:	(Ciffertæller)
Kapacitet:	100 kr.
Inddeling:	1 øre
Totallitertæller:	(Ciffertæller)
Kapacitet:	1.000.000 l
Inddeling:	0,1 l
Totalpristæller:	(Ciffertæller)
Kapacitet:	1.000.000 kr.
Inddeling:	10 øre

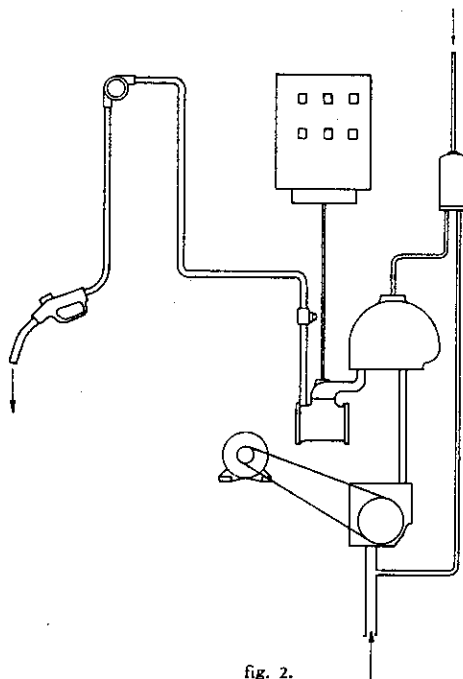


fig. 2.

Konstruktion m. v.:

Målemaskinens konstruktion er i hovedsagen som beskrevet i »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 384«. Den væsentligste ændring består i, at filter, luftudskiller samt pumpe er adskilt og fremtræder som selvstændige komponenter.

Målemaskinen kan fremtræde som dobbeltstander, der består af 2 komplette enkeltstandere indbygget i samme kabinet og med hver sin sugeledning til tanken.

Nærmere bestemmelser for justeringen:

Systembetegnelse: IV-78 c
 Tolerancer: $\pm 1:200$ af det udmålte rumfang.
 Lovligt brugsområde: Mindste lovlige salg 5 liter.
 Omjustering: Målemaskinen skal omjusteres, såfremt justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter sådanne reparationer eller indgreb, der berører dele, som kan have indflydelse på udmålingernes rigtighed.

Periodisk omjustering: Hvert år.

Påskrifter:

På skalapladerne skal findes følgende påskrifter:

Liter.

Glasset skal altid være fyldt (samt en pil pegende mod kontrolglasset).

Ved kontrolglasset:

»Glasset skal altid være fyldt«.

På et særligt skilt (justerskilt) skal findes følgende påskrifter:

IV - 78 c.

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Mindste lovlige salg 5 liter.

Højest 50 l/min.

Justeringen gælder ikke totaltæller og prisudregning.

Stempling:

Måleorganets topstykke samt cylinderdækslerne sikres ved plombering gennem 2 skruer hvert sted. Reglerskruen sikres til krumtapakslen ved plombering gennem en gennemboring af denne og skruen. Plomberne stemples med justermærke.

Justerskiltet, der skal være i ætset eller graveret udførelse, sikres til kabinetet med en fast plombe, der stemples med justermærke med årstal.

Andre sikringsstemplinger, som måtte anses for nødvendige, anbringes efter justerdirektørens nærmere bestemmelse.

Justervæsenet, København, den 15. februar 1968.

A. K. F. Christiansen