



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 26 / 1982


Udgave 1

Dato 1982 - 12-15

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-163 cs

MÅLEANLÆG

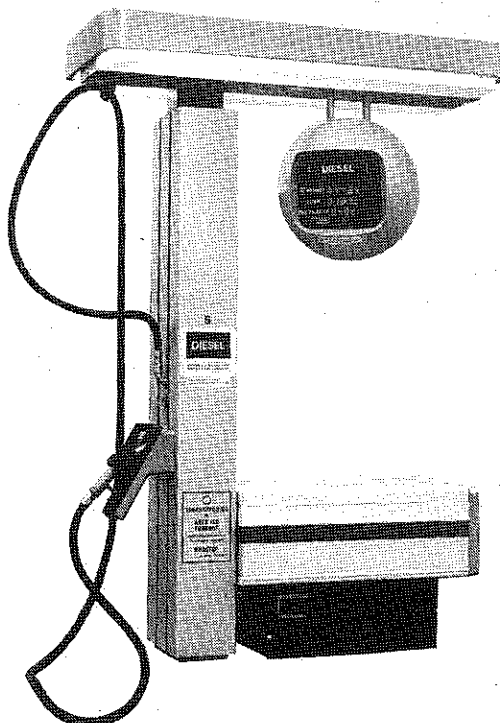

Fabrikant: Koppens Automatic B. V. Holland.
Anmelder: Koppens Automatik Danmark ApS.
Art: Dieselstander med elektronisk tællerværk.
Type: CBD HS DK.
Anvendelse: Udmåling af dieselolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 120 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 20 l

Tællerværk:

Pristæller,	kapacitet	9999,90 kr.
	deling	0,10 kr.
Litertæller,	kapacitet	9999,90 l
	deling	0,10 l
Dagspris,	kapacitet	9999 øre pr. l
	deling	1 øre pr. l

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 26 / 1982

Systembet.: IV-163 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv.nr., Fabr.nr., Max. l/min.

Mindste lovlige salg l.

Plombering:

Justeringen gælder kun detaillertælleren.

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans over- og underpart, kalibrators låsestift, impulsgiver til måleorgan og måleorgan til standers chassis.

Displayenhed med microprocessor (med 3 flangede kabelforbindelser på bagside) sikres imod åbning og på den mellemste kabelforbindelses flange sikres 2 skruer, således at displayenheden ikke kan fjernes fra displaykuglen.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er forsynet med 1 pumpe med luftudskiller af fabrikat STORK, type KSR 25-80 samt 2 måleorganer af fabrikat TOKHEIM, arbejdende i parallel.

Måleorganerne er identiske med det i justervæsenets bekendtgørelse nr. 480, systembetegnelse IV-95 beskrevne.

2-kanal impulsgiverne er af fabrikat KOPPENS, type PG03 og kalkulator med microprocessor og FERRANTI displays er af fabrikat KOPPENS, type EPS 3-c.

Standeren er i kiosken tilsluttet en central styringspult, og indtil 16 standere kan tilsluttes denne.

Fra denne styringspult sættes literpriser og standernes ønskede arbejdsform.

Seddelautomat og kreditkortautomat kan tilsluttes.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1079/82, dateret 1981-05-25.

E. Repstorff Holtveg