


## ANALYTE niveau 1 05/03/2018

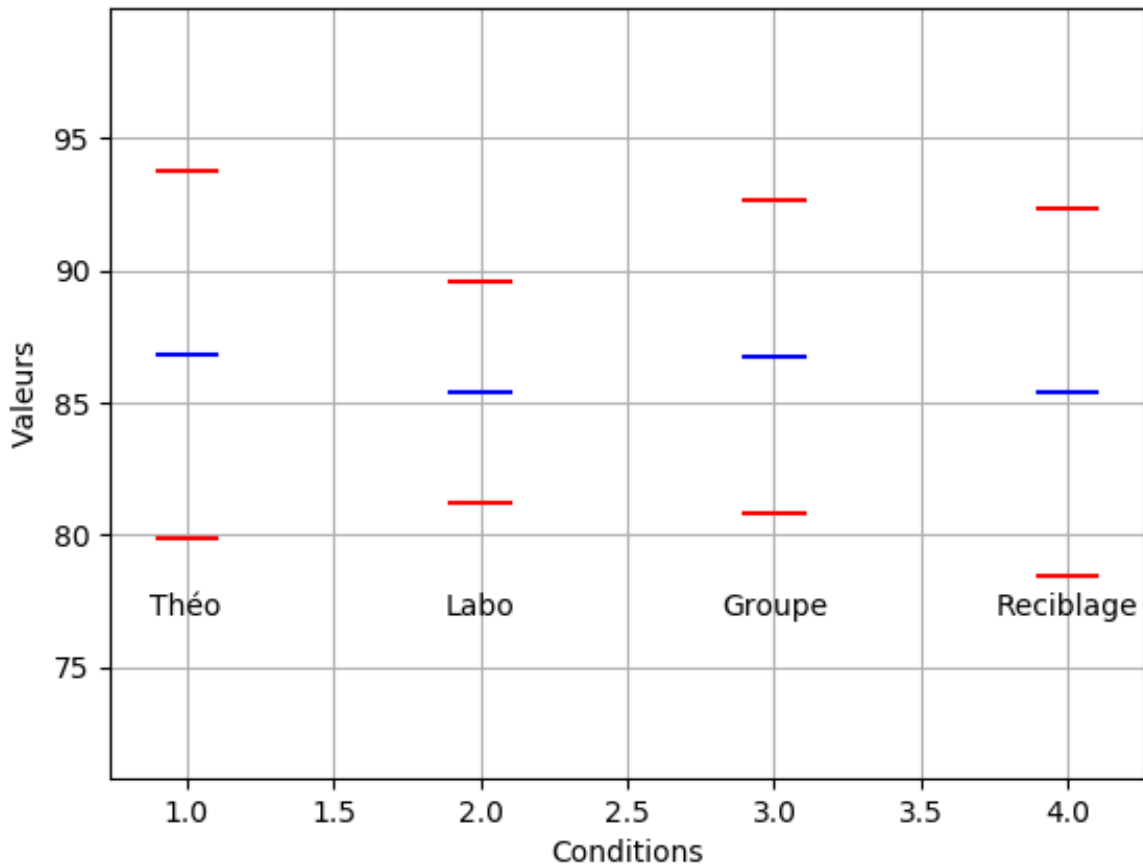

Programme : reciblage\_modele.py v:1.5 du 13/10/2016

-----  
M théo = 86.85  
CV théo = 4  
SD théo = 3.474


-----  
M labo = 85.42  
CV labo = 2.45  
SD labo = 2.093

-----  
M groupe = 86.75  
CV groupe = 2.27  
SD groupe = 1.969

-----  
95% des valeurs du labo sont donc entre :81.234 et 89.606

99.6% des valeurs des moyennes du groupe sont entre :80.842 et 92.658

## ANALYTE niveau 2 05/03/2018



Programme : reciblage\_modele.py v:1.5 du 13/10/2016

-----  
M théo = 342.7  
CV théo = 2.1  
SD théo = 7.197

-----  
M labo = 334.6  
CV labo = 1.38  
SD labo = 4.617

-----  
M groupe = 340.668  
CV groupe = 2.01  
SD groupe = 6.847

-----  
! mal ciblé ! : plus de 2,5 % des ctrl sont trop bas  
limite basse labo : 325.36504 < limite basse théorique : 328.3066  
95% des valeurs du labo sont donc entre :325.365 et 343.835  
99.6% des valeurs des moyennes du groupe sont entre :320.126 et 361.21