
Strana 1 z 4

A 11.08.2023 - 24.08.2023 (14 Dny) 28.07.2023 - 10.08.2023 (14 Dny)

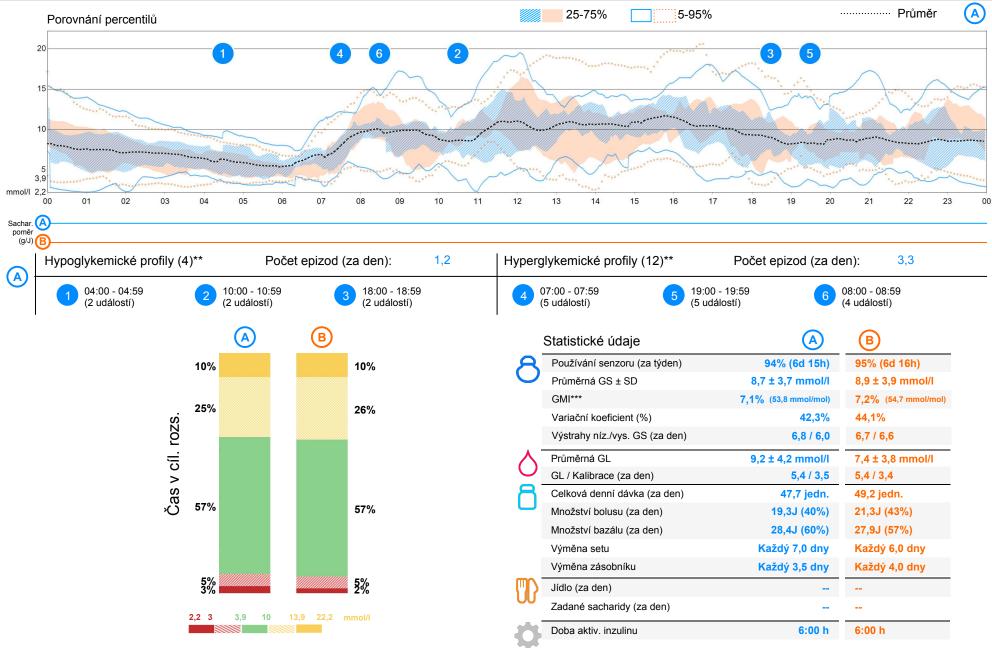

<sup>\*\*</sup> Je zobrazena pouze nejvyšší priorita


<sup>\*\*\*</sup> Indikátor řízení glukózy

	Měření glykémie		Události bolusu				Události plnění						
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	Trvání zastavení (h:mm)
Pátek 11.08.2023	6	21:45	5										5:11
Sobota 12.08.2023	6	24:00	7										압 2:11 삼
Neděle 13.08.2023	5	24:00	5										
Pondělí 14.08.2023	4	23:45	9										1:55 <del>''</del>
Úterý 15.08.2023	5	24:00	8										4:01 <del>**</del>
Středa 16.08.2023	4	21:50	5					2			1	7,2	압 4:36 <del>압</del>
Čtvrtek 17.08.2023	7	19:00	3										3:20
Pátek 18.08.2023	6	23:45	3										0:46
Sobota 19.08.2023	4	22:50	4										2:20
Neděle 20.08.2023	4	21:40	5										4:03 <del>**</del>
Pondělí 21.08.2023	9	24:00	4										5:16 <b>**</b>
Úterý 22.08.2023	6	24:00	4					1			1	7,7	압 7:13 말 삼
Středa 23.08.2023	7	24:00	5										5:51 <del>**</del>
© Čtvrtek 24.08.2023	3	18:30	3										6:01
Shrnutí	5,4/den	13d 05h 05m	5,0/den	0,0/den				3	0		2	7,5J /naplnění	2d 04h 44m

Zdroj dat: MiniMed 640G, MMT-1511/1711 (NG2244446H)

Generováno: 24.08.2023, 22:03

Medtronic 24.08.2023

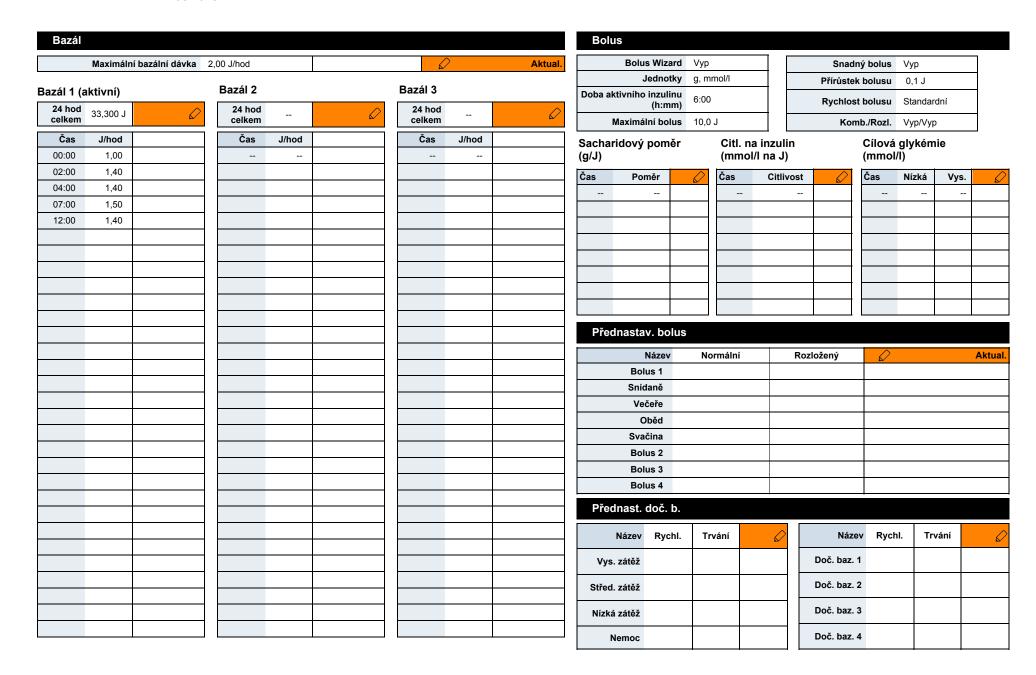

Mectronic Nastavení zařízení (2 z 2) 24.08.2023

Senzor	
Senzor	Zap

Výstr	ahy vys. G	Zap (Odložení 1:00)		
Počátek v	Vysoká (mmol/l)	Výstraha při vys. GS	Výstrah a před vys. GS	Limit výstr. vzest. (mmol/l)
0:00	12	Х		
	·			

Výstra	ahy níz.	GS	Zap (Odložení 0:20)			
Počátek v	Nízká (mmol/l)	Zastav.	Výstr. při níz. GS	Výstr. před níz. GS	Výstr. obnov. bazálu	
0:00	3,2	Před.nízG	Х	Х		

Autokalibrace	Zap
Připomínka kalibrace	Zap
Čas připomínky kalibrace	1:00

## Poznámky

Bazál (pokra	čování)			
Bazál 4	Bazál 5	Prac. den	Den volna	Den nemoci
24 hod celkem				
Čas J/ho	d Čas J/hod	Čas J/hod	Čas J/hod	Čas J/hod
		_		
		-		

## Připomínky

Varov. při nízk. stavu zás.	Jednotky inzul.
Množství	20 J
Kontrola GL po bolusu	Vyp
Výměna setu	3 dny

## Zmeškaný bolus k jídlu

Název	Počátek	Konec
Jídlo 1	Vyp	Vyp
Jídlo 2	Vyp	Vyp
Jídlo 3	Vyp	Vyp
Jídlo 4	Vyp	Vyp
Jídlo 5	Vyp	Vyp
Jídlo 6	Vyp	Vyp
Jídlo 7	Vyp	Vyp
Jídlo 8	Vyp	Vyp

## Osobní připomínky

Název	Čas
Připomínka 1	Vyp
Připomínka 2	Vyp
Připomínka 3	Vyp
Připomínka 4	Vyp
Připomínka 5	Vyp
Připomínka 6	Vyp
Změřte GL	Vyp
Léky	Vyp

Příslušenství	
Režim blokování	Vyp
Formát času	24 hod
Jas	Autom.
Doba podsvícení	15 s
Dálkový bolus	Zap
Možnosti zvuku	Zvuk
Hlasitost alarmu	3
Automat. zastavení	Vyp