國立臺灣大學生物資源暨農學院生物機電工程學系

碩士論文

Department of Biomechatronics Engineering

College of Bioresources and Agriculture

National Taiwan University

Master's Thesis

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

陳靖濰

Ching-Wei Chen

指導教授: 吳筱梅 博士

Advisor: Hsiao-Mei Wu, Ph.D.

中華民國 115 年 7 月

July 2026

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

國立臺灣大學碩士學位論文

口試委員會審定書

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

本論文係陳靖濰君（學號）在國立臺灣大學生物機電工程學系完成之碩士學位論文，於民國 115 年 7 月 15 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

口試委員：_____

（指導教授）

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

所　　長：_____

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

致謝

常到外國朋友家吃飯。當蠟燭燃起，菜肴布好，客主就位，總是主人家的小男孩或小女孩舉起小手，低頭感謝上天的賜予，並歡迎客人的到來。

我剛到美國時，常鬧得尷尬。因為在國內養成的習慣，還沒有坐好，就開動了。

以後凡到朋友家吃飯時，總是先囑咐自己；今天不要忘了，可別太快開動啊！幾年來，我已變得很習慣了。但我一直認為只是一種不同的風俗儀式，在我這方面看來，忘或不忘，也沒有太大的關係。

前年有一次，我又是到一家去吃飯。而這次卻是由主人家的祖母謝飯。她雪白的頭髮，顫抖的聲音，在搖曳的燭光下，使我想起兒時的祖母。那天晚上，我忽然覺得我平靜如水的情感翻起滔天巨浪來。

在小時候，每當冬夜，我們一大家人圍著個大圓桌吃飯。我總是坐在祖母身旁。祖母總是摸著我的頭說：「老天爺賞我們家飽飯吃，記住，飯碗裡一粒米都不許剩，要是蹧蹋糧食，老天爺就不給咱們飯了。」

剛上小學的我，正在念打倒偶像及破除迷信等為內容的課文，我的學校就是從前的關帝廟，我的書桌就是供桌，我曾給周倉畫上眼鏡，給關平戴上鬍子，祖母的話，老天爺也者，我覺得是既多餘，又落伍的。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

不過，我卻很尊敬我的祖父母，因為這飯確實是他們掙的，這家確實是他們立的。我感謝面前的祖父母，不必感謝渺茫的老天爺。

這種想法並未因為年紀長大而有任何改變。多少年，就在這種哲學中過去了。

我在這個外國家庭晚飯後，由於這位外國老太太，我想起我的兒時，由於我的兒時，我想起一串很奇怪的現象。

祖父每年在「風裡雨裡的咬牙」，祖母每年在「茶裡飯裡的自苦」，他們明明知道要滴下眉毛上的汗珠，才能撿起田中的麥穗，而為什麼要謝天？我明明是個小孩子，混吃混玩，而我為什麼卻不感謝老天爺？

這種奇怪的心理狀態，一直是我心中的一個謎。

一直到前年，我在普林斯頓，瀏覽愛因斯坦的我所看見的世界得到了新的領悟。

這是一本非科學性的文集，專載些愛因斯坦在紀念會上啦，在歡迎會上啦，在朋友的喪禮中，他所發表的談話。

我在讀這本書時忽然發現愛因斯坦想盡量給聽眾一個印象：即他的貢獻不是源於甲，就是由於乙，而與愛因斯坦本人不太相干似的。

就連那篇亙古以來嶄新獨創的狹義相對論，並無參考可引，卻在最後天外飛來一筆，「感謝同事朋友貝索的時相討論。」

其他的文章，比如奮鬥苦思了十幾年的廣義相對論，數學部份推給了昔年好友的合作：這種謙抑，這種不居功，科學史中是少見的。

我就想，如此大功而竟不居，為什麼？像愛因斯坦之於相對論，像我祖母之

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

於我家。

幾年來自己的奔波，做了一些研究，寫了幾篇學術文章，真正做了一些小貢獻以後，才有了一種新的覺悟：即是無論什麼事，得之於人者太多，出之於己者太少。因為需要感謝的人太多了，就感謝天罷。無論什麼事，不是需要先人的遺愛與遺產，即是需要眾人的支持與合作，還要等候機會的到來。越是真正做過一點事，越是感覺自己的貢獻之渺小。

於是，創業的人，都會自然而然的想到上天，而敗家的人卻無時不想到自己。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

摘要

商用倒立螢光顯微鏡造價高昂且系統封閉，嚴重限制了跨領域研究的擴充性；而現有的純 3D 列印開源顯微鏡雖降低了成本，卻受限於撓性機構（Flexure hinge）的先天缺陷，面臨移動行程極短、結構剛性不足導致焦平面漂移，以及消費級相機帶來嚴重暗角與色彩串擾等問題。為解決上述痛點，本研究提出並實作了一套兼具低成本與高擴充性之「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」系統。

在硬體端，本系統揚棄傳統撓性機構，改採高剛性的龍門式（Gantry-style）架構，並將 NEMA 17 步進馬達與金屬滑軌完美整合至具備極高射出成型精度（$< 10\mu m$）的樂高科技系列（LEGO Technic）光學底板中。配合 16 倍微步進驅動，系統達成了 $0.625\mu m$ 的 Z 軸定位精度與數公分的大面積掃描行程。

在軟體與演算法端，本系統基於 Python 與 PySide6 建構了非同步多執行緒的控制後端。針對大行程掃描面臨的失焦問題，我們開發了「多階段動態自動對焦狀態機」，巧妙融合全域變異數、空間頻率與形態學梯度指標，能在極度微弱且充滿雜訊的螢光背景中，於 14 秒內完成近一毫米深度的尋峰與回溯鎖定。針對 Raspberry Pi Camera 邊緣微透鏡主光線角度（CRA）錯位造成的物理瑕疵，本研究獨創「空間變異張量色彩解混（Tensor Color Unmixing）」管線，利用愛因斯坦求和（`np.einsum`）進行逐像素反矩陣運算，成功還原螢光微球的真實色彩飽和度並抹平暗角。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

此外，本系統亦整合了圖案化照明傅立葉疊層成像（piFP）技術之前置波前調控硬體，旨在透過頻率混疊與疊代運算，進一步突破低數值孔徑物鏡的物理繞射極限。本研究所開發之軟硬體開源架構，不僅大幅降低了生醫影像研究的經濟門檻，更證實了消費級電子元件透過嚴謹的數學演算法補償，亦能產出具備高度保真度之定量學術影像。

關鍵字：倒立螢光顯微鏡、樂高、自動對焦、影像拼接、螢光傅立葉疊層

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Abstract

Commercial inverted fluorescence microscopes are prohibitively expensive and inherently closed-source, significantly impeding cross-disciplinary customization. While existing 3D-printed open-source alternatives reduce costs, they suffer from inherent flaws of flexure mechanisms, including severely limited travel ranges, poor structural stiffness leading to focus drift, and severe optical aberrations (vignetting and color crosstalk) caused by consumer-grade image sensors. To address these bottlenecks, this study proposes and implements a low-cost, highly scalable ”Multifunctional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope” system.

On the hardware front, we abandoned traditional flexure designs in favor of a highly rigid, Gantry-style architecture. We integrated NEMA 17 stepper motors and metal linear guides into an optical breadboard constructed from LEGO Technic components, which boast exceptional injection-molding precision ($< 10\mu m$). Coupled with 16x microstepping drives, the system achieves a Z-axis positioning resolution of $0.625\mu m$ and enables

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

large-area scanning over several centimeters.

On the software and algorithmic front, we built an asynchronous, multi-threaded control backend utilizing Python and PySide6. To tackle the autofocus challenges during large-range scanning, we developed a ”Multi-stage Dynamic Autofocus State Machine”. By seamlessly transitioning between Global Variance, Spatial Frequency, and Morphological Gradient metrics, the system can robustly perform peak-searching and closed-loop recovery across a near-millimeter depth within 14 seconds, even in extremely faint and noisy fluorescence backgrounds. Furthermore, to mitigate the severe vignetting and color crosstalk caused by the Chief Ray Angle (CRA) mismatch of the Raspberry Pi Camera’s edge microlenses, we pioneered a ”Spatially Varying Tensor Color Unmixing” pipeline. By leveraging Einstein summation (`np.einsum`) for pixel-wise inverse matrix operations, we successfully restored the true color saturation of fluorescent microspheres and eliminated vignetting.

Additionally, the system integrates the necessary wavefront modulation hardware for pattern-illuminated Fourier Ptychographic (piFP) imaging, aiming to computationally surpass the physical diffraction limit of low numerical aperture objectives through frequency aliasing and iterative phase retrieval. The open-source hardware and software architecture developed in this study not only drastically lowers the economic barrier for

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

biomedical imaging research but also demonstrates that consumer-grade electronics, when compensated by rigorous mathematical algorithms, can produce high-fidelity, quantitative academic imagery.

Keywords: Inverted fluorescence microscope, LEGO, Auto-focusing, Image stitching, Fourier ptychography

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

目次

	Page
口試委員審定書	i
致謝	iii
摘要	vii
Abstract	ix
目次	xiii
圖次	xix
表次	xxi
符號列表	xxiii
第一章　研究目的與背景知識	1
1.1　顯微鏡技術的發展與其在生物醫學中的重要性	1
1.2　螢光顯微成像技術之基礎原理	2
1.2.1　螢光現象與斯托克斯位移	2
1.2.2　螢光顯微鏡的光學濾波架構	3
1.3　現行商用顯微系統的痛點剖析	5
1.3.1　極高的經濟壁壘（Economic Barrier）	5
1.3.2　封閉生態系與客製化困境（Closed Ecosystem）	5

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

1.4 開源硬體顯微鏡的崛起與挑戰 6
1.4.1 3D 列印顯微鏡的優勢 6
1.4.2 純 3D 列印架構的機械與光學限制 7
1.4.2.1 1. 彈性極限與行程限制 7
1.4.2.2 2. 剛性不足與潛在的潛變（Creep）問題 8
1.4.2.3 3. 光軸同心度（Concentricity）難以保證 8
1.5 本研究之突破點：樂高光學底板與高剛性龍門架構 9
1.5.1 為什麼選擇樂高？(The Rationale of LEGO) 9
1.5.2 剛性龍門載台設計（Gantry-style Stage） 10
1.6 導入消費級感測器與前瞻運算成像技術 10
1.6.1 消費級感測器的校正難題 10
1.6.2 突破實體繞射極限：圖案化照明傅立葉疊層成像 (piFP) 11
1.7 論文架構與章節總覽 12
第二章 文獻探討與基礎理論 15
2.1 開源硬體顯微鏡的發展與機構分析 15
2.1.1 OpenFlexure Microscope 與撓性機構的力學原理 15
2.1.1.1 背隙（Backlash）與靜摩擦力（Stiction）問題 . . . 16
2.1.1.2 撓性鉸鏈（Flexure Hinge）的解決方案 16
2.1.1.3 撓性機構的致命傷：行程與剛性 16
2.1.2 模組化概念：Incubot 與 UC2 系統 17
2.2 運算成像與圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 理論 17
2.2.1 傅立葉光學（Fourier Optics）基礎 18
2.2.2 傅立葉疊層成像 (Fourier Ptychography, FP) 的核心思想 19
2.2.3 針對螢光系統的 piFP 與波前調控 19

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.3 動態自動對焦技術的數學原理 21
2.3.1 對焦指標（Focus Metrics）的選擇 21
2.3.1.1 1. 全域變異數（Global Variance） 22
2.3.1.2 2. 空間頻率（Spatial Frequency） 22
2.3.1.3 3. Brenner 與 Tenengrad 梯度函數 23
2.3.2 極端環境下的抗噪策略：形態學對焦指標 23
2.4 感測器物理學與色彩校正 (Color Correction) 理論 25
2.4.1 主光線角度 (Chief Ray Angle, CRA) 的幾何偏誤 25
2.4.2 暗角與色彩串擾的形成 26
第三章 研究方法與系統實作 29
3.1 系統硬體架構與機電整合 29
3.1.1 有限共軛光路設計 (Finite-Conjugate Optical Design) 29
3.1.2 基於樂高與龍門架構之機械載台 30
3.1.3 動力與電子控制子系統 31
3.1.3.1 1. 步進馬達與極限微步進 (Microstepping) 控制 . . . 31
3.1.3.2 2. 雙模光源的 GPIO 同步控制 32
3.2 非同步多執行緒的軟體架構 32
3.2.1 模組化執行緒設計 (`workers.py`) 32
3.2.2 RESTful 風格的 API 處理器 (`api_handler.py`) 33
3.3 空間變異張量影像校正管線 (Image Processing Pipeline) 33
3.3.1 1. 硬體黑電平補償 (Black Level Subtraction) 33
3.3.2 2. 背景扣除 (Background Subtraction) 對抗環境漏光 34
3.3.3 3. 空間增益矩陣平場校正 (Flat-field Correction) 34
3.3.4 4. 愛因斯坦求和與色彩解混張量 (Tensor Unmixing) 35

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.4 多階段動態自動對焦狀態機 (State Machine) 36
3.4.1 三重對焦指標的切換邏輯 36
3.4.2 防呆盲區偵測與閉迴圈峰值回溯 (Peak Recovery) 37
3.4.2.1 1. 盲區偵測 (Blind Zone Detection) 37
3.4.2.2 2. 尋峰回溯機制 (Closed-loop Peak Recovery) 37
第四章 初步實驗結果與系統效能評估 39
4.1 光學解析度與平場校正 (Flat-field) 驗證 39
4.1.1 NBS 1952 標準解析度測試卡實驗 39
4.2 高難度螢光色彩保真度測試 40
4.2.1 15 μm 黃綠色螢光微球 (FluoSpheres) 測試 40
4.2.1.1 未校正前的色彩漂移現象 (Color Shift) 41
4.2.1.2 張量解混 (Tensor Unmixing) 後的重生 41
4.3 大行程高速自動對焦效能剖析 42
4.3.1 14 秒鎖定焦點：三重指標的接力賽 42
第五章 論文研究進度表與具體里程碑 45
5.1 核心里程碑詳細規劃 45
5.1.1 第一階段：文獻回顧與硬體底層架構設計 (2025 年 10 月-11 月) 45
5.1.2 第二階段：光學系統校正與機電整合測試 (2025 年 11 月-12 月) 46
5.1.3 第三階段：自動對焦與空間張量色彩解混開發 (2025 年 12 月-2026 年 2 月) 46
5.1.4 第四階段：圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 實作 (2026 年 1 月-3 月) 47
5.1.5 第五階段：系統嚴苛驗證與活體生物樣本測試 (2026 年 3 月-5 月) 47
5.1.6 第六階段：數據統整與論文定稿 (2026 年 5 月-7 月) 47

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

參考文獻 **49**

附錄 A — Introduction **51**

A.1 Introduction 51

A.2 Further Introduction 51

附錄 B — Introduction **53**

B.1 Introduction 53

B.2 Further Introduction 53

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

圖次

圖 1.1　正立式顯微鏡與倒立式顯微鏡之光學與機構配置差異比較圖。 . . 2

圖 1.2　螢光分子激發與發射過程之雅布倫斯基圖（Jablonski Diagram）與斯托克斯位移。 3

圖 1.3　落射式螢光顯微鏡（Epifluorescence Microscope）之濾光方塊（Filter Cube）與光路示意圖。 4

圖 1.4　OpenFlexure Delta Stage 的幾何結構與撓性機構示意圖（圖片來源：OpenFlexure 專案官方文件 OpenFlexure Project (2023)）。 7

圖 1.5　Raspberry Pi Camera 邊緣像素的主光線角度（CRA）錯位與色彩串擾示意圖（圖片來源：Bowman et al. (2019)）。 11

圖 2.1　光柵繞射原理示意圖。左圖（A）顯示較大的結構週期 d 會產生較小的繞射角，光線易於進入物鏡接收錐角內；右圖（B）顯示細微結構（極小的 d）會導致光線以極大角度繞射，甚至超出物鏡的接收範圍（綠色虛線區），造成高頻細節的遺失。 19

圖 2.2　基於 LED 陣列之傅立葉疊層成像 (FP) 系統架構示意圖（圖片參考自 Zheng et al. (2013)）。系統透過可程式化控制的 LED 陣列提供不同角度的照明，將樣本的高頻資訊偏移至物鏡可接收的孔徑內。 . 20

圖 2.3　圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 突破繞射極限之原理與系統架構示意圖（圖片來源：Dong et al. (2014)）。 21

圖 2.4　明視野（左）與螢光（右）環境下，不同自動對焦指標對脫焦距離的響應曲線模擬對比。 24

圖 2.5　基於物理模型之大範圍失焦模擬與形態學抗噪處理流程對比圖。 25

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

表次

表 5.1　預定研究進度甘特圖 (2025 年 10 月至 2026 年 7 月) 48

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

符號列表

HPC	高性能計算 (High Performance Computing)
cluster	集群
Itanium	安騰
SMP	對稱多處理
API	應用程序編程接口
PI	聚酰亞胺
MPI	聚酰亞胺模型化合物，N-苯基鄰苯酰亞胺
PBI	聚苯並咪唑
MPBI	聚苯並咪唑模型化合物，N-苯基苯並咪唑
PY	聚吡嚨
PMDA-BDA	均苯四酸二酐與聯苯四胺合成的聚吡嚨薄膜
ΔG	活化自由能 (Activation Free Energy)

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

χ	傳輸系數 (Transmission Coefficient)
E	能量
m	質量
c	光速
P	概率
T	時間
v	速度

勸學

君子曰：學不可以已。青，取之於藍，而青於藍；冰，水為之，而寒於水。木直中繩。輮以為輪，其曲中規。雖有槁暴，不覆挺者，輮使之然也。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也；吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。登高而招，臂非加長也，而見者遠；順風而呼，聲非加疾也，而聞者彰。假輿馬者，非利足也，而致千裏；假舟楫者，非能水也，而絕江河，君子生非異也，善假於物也。積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉；積善成德，而神明自得，聖心備焉。故不積跬步，無以至千裏；不積小流，無以成江海。騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。蚓無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹六跪而二螯，非蛇鱔之穴無可寄托者，用心躁也。——荀況

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第一章　研究目的與背景知識

1.1　顯微鏡技術的發展與其在生物醫學中的重要性

自 17 世紀安東尼·范·雷文霍克（Antonie van Leeuwenhoek）利用單片玻璃透鏡觀察到微生物以來，顯微鏡技術（Microscopy）已成為人類探索微觀世界不可或缺的工具。隨著光學理論的完善與精密加工技術的進步，顯微鏡從最初的單透鏡系統，演進為由多組複雜透鏡構成的複合式顯微鏡（Compound Microscope）。在現代生物學、醫學病理診斷、材料科學以及農業表型分析（Phenotyping）中，顯微鏡扮演著無可替代的角色。

傳統的「正立式顯微鏡（Upright Microscope）」其物鏡位於樣本之上，光源由下方穿透樣本進入物鏡。這種設計適用於觀察經過切片、固定且極薄的玻片標本。然而，在許多活體細胞研究（Live-cell Imaging）與組織培養（Tissue Culture）的應用場景中，樣本通常培養於具有一定高度的培養皿（Petri Dish）或多孔盤（Multi-well Plate）底部，且培養基（Culture Medium）會覆蓋在細胞之上。若使用正立式顯微鏡，物鏡不僅會受限於培養皿的高度而無法靠近樣本，其浸入培養基中更可能引發污染或擾動細胞生長。

為了解決這個物理空間的限制，「倒立式顯微鏡（Inverted Microscope）」應運而生。倒立式顯微鏡將光源配置於樣本上方，而將物鏡倒置於樣本平台之下。這

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

樣的幾何配置帶來了兩大優勢：首先，物鏡可以不受限於培養容器的高度，僅需隔著極薄的容器底部（通常為 0.17 mm 厚的蓋玻片或特定厚度的塑膠底）即可近距離對焦於沉澱在底部的細胞；其次，樣本上方擁有開闊的操作空間，方便研究人員使用微操作器（Micromanipulator）進行細胞注射（Microinjection）或外接微流體系統（Microfluidic System）。因此，倒立式顯微鏡成為了現代細胞生物學研究的標準配備。

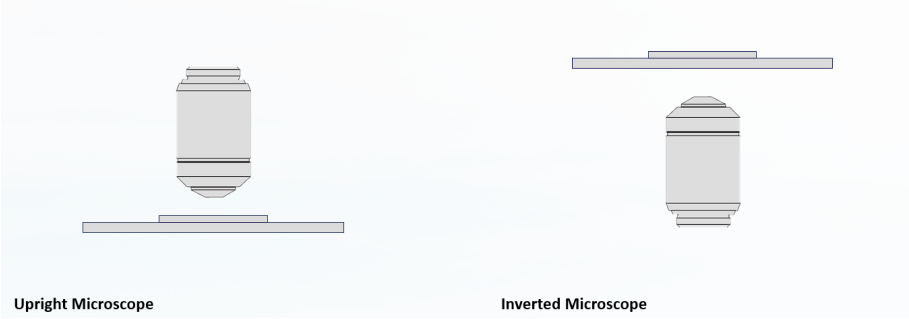

圖 1.1: 正立式顯微鏡與倒立式顯微鏡之光學與機構配置差異比較圖。

1.2 螢光顯微成像技術之基礎原理

除了觀察樣本的物理形態，現代生物學更著重於分子層級的特異性標定。傳統明視野（Bright-field）顯微鏡僅能依賴樣本對光的吸收、折射或散射來產生對比度，對於內部結構極度透明的活細胞往往束手無策。為了突顯特定蛋白質或胞器，科學家發展出了「螢光顯微鏡（Fluorescence Microscope）」。

1.2.1 螢光現象與斯托克斯位移

「螢光（Fluorescence）」是一種光致發光（Photoluminescence）現象。當特定分子（螢光團，Fluorophore）受到具有較高能量（較短波長）的光子激發時，其基態（Ground State, S_0）的電子會吸收能量躍遷至激發態（Excited State, S_1 或 S_2）。處於激發態的電子極不穩定，在極短的時間內（通常為皮秒至奈秒等級），電子

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

會先透過無輻射躍遷（Non-radiative Relaxation）釋放部分能量（例如轉化為熱能）降至最低的激發態能階，接著再以發射光子的形式回到基態。

由於在無輻射躍遷過程中損失了部分能量，根據普朗克-愛因斯坦關係式（$E = hc/\lambda$），發射出的光子能量會小於吸收的光子能量，亦即發射光的波長（λ_{em}）會長於激發光的波長（λ_{ex}）。這種激發波長與發射波長之間的差值，被稱為 ** 斯托克斯位移（Stokes Shift）**。

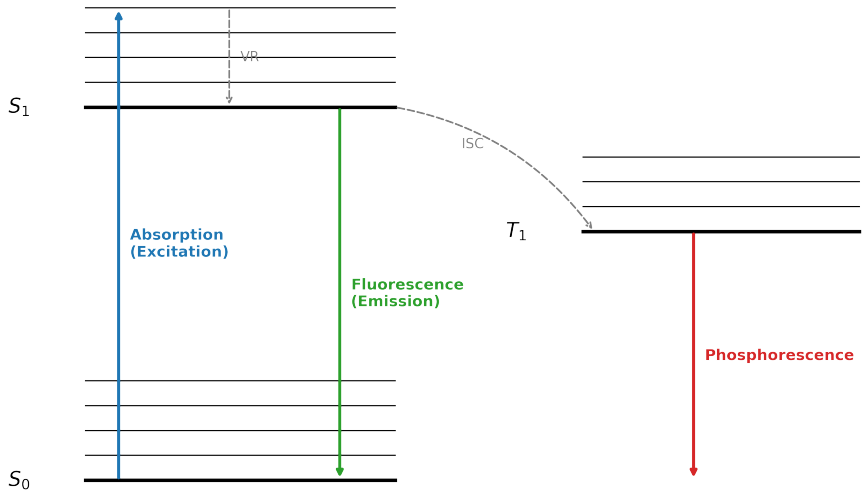

圖 1.2: 螢光分子激發與發射過程之雅布倫斯基圖（Jablonski Diagram）與斯托克斯位移。

1.2.2 螢光顯微鏡的光學濾波架構

斯托克斯位移是螢光顯微鏡得以運作的物理基石。為了能在黑暗的背景中僅捕捉到微弱的螢光訊號，螢光顯微鏡必須極力排除強烈的激發光干擾。一套標準的落射式螢光顯微鏡（Epifluorescence Microscope）通常包含三個核心光學元件：

1. **激發濾光片（Excitation Filter）**：僅允許特定波段的光線通過，用以激發樣本。例如，若使用綠色螢光蛋白（GFP），則會選擇僅讓藍光（約 470 nm）通過的濾片。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2. **雙色分光鏡（Dichroic Mirror）**：放置於光路中呈現 45 度角。其特殊的光學鍍膜設計使其能「反射」較短波長的激發光至物鏡方向，同時「穿透」較長波長的發射光至相機端。

3. **發射濾光片（Emission Filter）**：放置於相機前方，作為最後一道防線，徹底阻擋任何殘留或散射的激發光，僅讓純淨的螢光波段進入感測器。

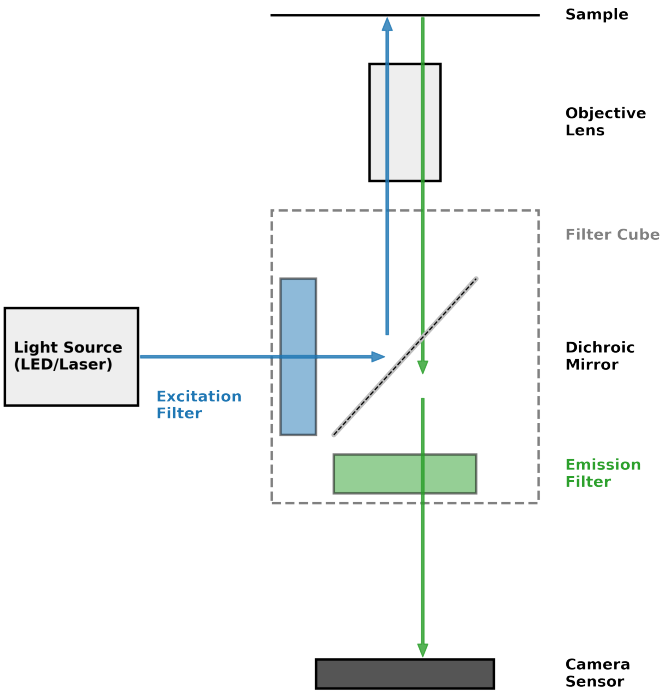

圖 1.3: 落射式螢光顯微鏡（Epifluorescence Microscope）之濾光方塊（Filter Cube）與光路示意圖。

透過這三道濾波機制的嚴格把關，螢光顯微鏡能達到極高的訊噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR），使科學家能夠在微觀尺度下觀察到極其微弱的分子標記。然而，這種精密的光學元件配置，也使得商用螢光顯微鏡的造價往往高不可攀。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

1.3 現行商用顯微系統的痛點剖析

儘管商用研究級倒立螢光顯微鏡在光學品質上已經達到了極高的水準，但其在普及性與功能擴充性上仍存在著難以跨越的障礙，這些痛點嚴重限制了創新研究的發展。

1.3.1 極高的經濟壁壘（Economic Barrier）

商用螢光顯微鏡的造價通常從數萬至數十萬美金不等。高昂的成本主要來自於其極度追求完美的光學元件（例如具備高度色差校正的複消色差物鏡 Apochromat Objective）、精密加工的金屬機身、以及專屬的電動位移載台。這種高昂的資本支出，使得資源有限的基層實驗室、教育機構，甚至是發展中國家的醫療單位望之卻步。許多具有潛力的研究計畫，往往因為缺乏基礎的成像設備而胎死腹中。

1.3.2 封閉生態系與客製化困境（Closed Ecosystem）

商用顯微鏡的軟硬體架構通常是高度封閉的黑盒子（Black-box）。各大廠牌（如 Leica, Zeiss, Nikon, Olympus）皆採用專屬的通訊協定、螺紋規格與控制軟體。當研究人員需要針對特定實驗進行客製化改裝時，例如：

- 整合外接的微流體幫浦（Microfluidic Pumps）並與顯微鏡快門同步。
- 將顯微鏡整體放入二氧化碳培養箱（CO_2 Incubator）中進行數週的活細胞連續觀察。
- 在光路中插入自製的相位調變器（Spatial Light Modulator）或擴散片以進行

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

運算成像研究。

面對這些需求，研究人員往往無法修改商用機台的底層控制碼，也難以在封閉的金屬機殼上鑽孔改裝。強行改裝甚至會導致失去原廠保固。這種「缺乏彈性」是現代跨領域研究面臨的最大技術瓶頸之一。

1.4 開源硬體顯微鏡的崛起與挑戰

隨著 3D 列印技術（3D Printing）、單板電腦（Single-Board Computers, 例如 Raspberry Pi）以及微控制板（Microcontrollers, 例如 Arduino）的普及，一場名為「開源硬體（Open-source Hardware）」的運動席捲了科學界。研究人員開始將傳統昂貴的科學儀器解構，並透過網路分享設計圖紙，讓全球的自造者（Makers）能夠以極低的成本複製甚至改良這些設備。

1.4.1 3D 列印顯微鏡的優勢

以廣泛被使用的 OpenFlexure Microscope (Collins et al., 2020) 為例，其採用了 3D 列印技術製造了一體成型的顯微鏡機身。這種設計帶來了革命性的改變：

1. **成本驟降**：相較於商用機台動輒數十萬元的造價，一台開源顯微鏡的材料成本可壓低至數千元新台幣。
2. **消除背隙（Backlash）**：傳統金屬滑軌與齒輪在反向運動時必然存在間隙（背隙），導致定位不精準。OpenFlexure 巧妙地利用了塑膠材料的彈性，設計出「撓性鉸鏈（Flexure Hinge）」。這是一種完全沒有滑動部件的機構，僅靠塑膠彎曲來產生位移，徹底消除了背隙問題，在微米等級的定位上展現出驚人的平滑度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3. **可複製性**：任何人只需擁有一台消費級 3D 列印機與網路，即可在實驗室內隨時製造一台顯微鏡。

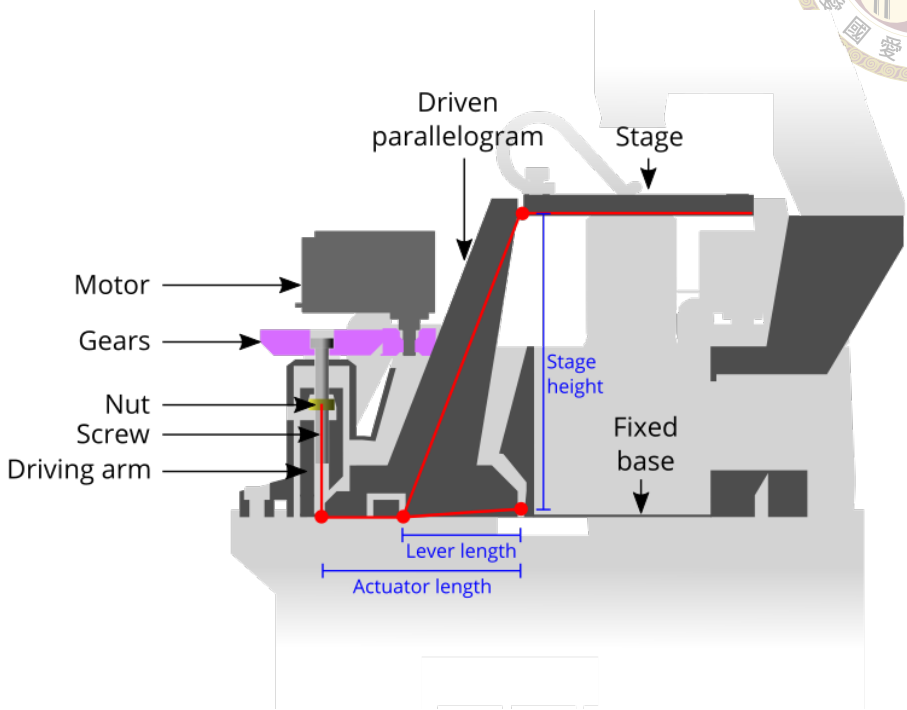

圖 1.4: OpenFlexure Delta Stage 的幾何結構與撓性機構示意圖（圖片來源：OpenFlexure 專案官方文件 OpenFlexure Project (2023)）。

1.4.2 純 3D 列印架構的機械與光學限制

儘管純 3D 列印顯微鏡解決了成本與入門門檻的問題，但在實際應用於嚴謹的科學研究時，仍暴露出許多難以克服的先天缺陷：

1.4.2.1 1. 彈性極限與行程限制

撓性鉸鏈（Flexure）的位移是建立在塑膠材料的彈性形變之上。根據固體力學原理，當形變量超過材料的屈服點（Yield Point）時，材料將發生不可逆的塑性變形（Plastic Deformation），甚至斷裂。這意味著基於撓性鉸鏈的載台，其位移行程（Travel Range）被嚴格限制在幾毫米（mm）之內。在現代生物醫學研究中，觀察 96 孔盤（96-well plate）或大面積組織切片需要動輒數公分（cm）的

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

X-Y 掃描行程。純 3D 列印的撓性機構根本無法應付這種大範圍的高通量掃描（High-throughput Screening）需求。

1.4.2.2　2. 剛性不足與潛在的潛變（Creep）問題

消費級 3D 列印機最常用的材料為 PLA 或 PETG。這些熱塑性塑膠（Thermo-plastics）的楊氏模量（Young's Modulus）與機械剛性遠不及傳統顯微鏡使用的鋁合金或鑄鐵。在承載較重的光學元件（例如金屬外殼的螢光濾片立方體或高數值孔徑物鏡）時，3D 列印的機殼極易發生微小的形變。更嚴重的是，塑膠材料在長時間承受恆定應力時，會發生「潛變（Creep）」現象，即形變量會隨時間緩慢增加。這對於需要連續對焦數天的長時間縮時攝影（Time-lapse Imaging）來說是致命的，因為這會導致焦平面隨時間漂移（Focus Drift），嚴重影響數據的可靠性。

1.4.2.3　3. 光軸同心度（Concentricity）難以保證

顯微成像對光路對齊（Optical Alignment）的要求極高。物鏡、濾光片、管鏡與感測器的中心必須嚴格位於同一條直線上（即光軸同心）。在傳統製造業中，這是透過高精度的 CNC 銑床與車床來保證的。然而，消費級 FDM（熔融沉積成型）3D 列印機的層疊製造特性，使得其尺寸公差（Tolerance）通常落在 ±0.1 至 ±0.2 mm 之間，且容易出現熱收縮變形。如果整個顯微鏡機身都由 3D 列印一體成型，在組裝光學元件時，很容易因為列印公差導致光軸偏移、傾斜，進而產生嚴重的光學像差（如彗星像差 Coma 或像散 Astigmatism），導致影像邊緣模糊或產生不對稱的耀光。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

1.5 本研究之突破點：樂高光學底板與高剛性龍門架構

為了解決上述「商用機台過於封閉」與「3D 列印機台剛性不足/行程受限」的兩難困境，本研究提出了一套嶄新的硬體設計典範：** 將樂高積木（LEGO Technic）引入顯微鏡的底層架構設計中。**

1.5.1 為什麼選擇樂高？(The Rationale of LEGO)

對於非專業讀者而言，樂高通常被視為兒童玩具。然而，從精密工程的角度來看，樂高積木具備多項驚人的優勢，使其成為光學原型開發的理想材料：

1. **極致的製造公差**：樂高積木採用高品質的 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）塑膠，透過極高精度的射出成型（Injection Molding）工藝製造。其製造公差被嚴格控制在 $10\mu m$（0.01 mm）以內。這種工業級的精度，是任何消費級 3D 列印機都無法企及的。

2. **標準化的幾何網格（Standardized Pitch）**：樂高科技系列（LEGO Technic）具備標準的孔洞間距（Pitch），正好為 8.0 mm。這意味著樂高本身就是一個天然的「光學麵包板（Optical Breadboard）」。研究人員可以輕易地計算出各個光學元件的相對位置，並確保它們在三維空間中的正交性（Orthogonality）與平行度。

3. **高度可重構性（Reconfigurability）**：與一體成型的 3D 列印機殼不同，樂高積木採用模組化拼裝。當實驗需求改變（例如需要加長鏡筒以改變放大倍率，或是需要安插新的分光鏡）時，研究人員只需將幾塊積木拔起並重新組合，幾分鐘內即可完成光學架構的重構，徹底解放了顯微鏡設計的自由度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4. **結構剛性（Structural Stiffness）**：透過樑（Beams）與銷（Pins）的交錯堆疊，樂高結構可以形成極具剛性的桁架（Truss）系統，能有效抵抗外部震動，並消除 3D 列印塑膠的潛變問題。

1.5.2 剛性龍門載台設計（Gantry-style Stage）

為了解決撓性鉸鏈行程受限的問題，本研究徹底捨棄了 OpenFlexure 的載台設計，改為採用在 CNC 雕刻機與工業自動化設備中廣泛使用的「龍門式架構（Gantry-style Architecture）」。在龍門架構中，X 軸與 Y 軸的運動是透過高精度的金屬導螺桿（Lead Screw）與線性滑軌（Linear Guide）帶動。這種剛性傳動機制徹底解除了材料彈性的限制，使得掃描行程可以輕易擴展至數公分以上，能夠完美覆蓋標準 96 孔盤甚至更大的樣本區域。同時，透過步進馬達的微步進（Microstepping）技術，我們確保了即使在大行程下，依然能維持亞微米（Sub-micron）等級的定位精度。

1.6 導入消費級感測器與前瞻運算成像技術

硬體結構的穩固只是第一步。要讓這套低成本系統達到「研究級」的影像品質，我們必須克服消費級電子元件先天的物理缺陷，並導入先進的演算法。

1.6.1 消費級感測器的校正難題

本系統採用了廣泛流通且成本極低的 Raspberry Pi Camera Module 2 作為感測器。然而，這類原本為智慧型手機或監視器設計的感測器，若直接應用於顯微光路，會面臨嚴重的問題：

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

- **主光線角度（Chief Ray Angle, CRA）不匹配**：感測器表面的微透鏡陣列是針對原始的短焦距鏡頭設計的。當我們移除原始鏡頭，改用顯微物鏡時，光線入射的角度會產生偏差，導致畫面周圍產生嚴重的亮度衰減（暗角，Vignetting）。

- **色彩串擾（Color Crosstalk）**：CRA 錯位更會導致特定波長的光線穿過 Bayer 濾光片時「溢出」到相鄰的像素中，使得螢光訊號失真，顏色變得蒼白不均。

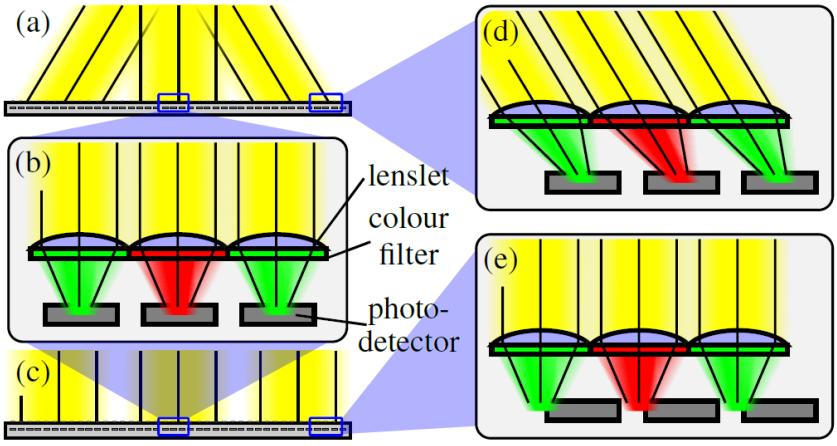

圖 1.5: Raspberry Pi Camera 邊緣像素的主光線角度（CRA）錯位與色彩串擾示意圖（圖片來源：Bowman et al. (2019)）。

為了克服這些硬體缺陷，我們將在後續章節提出一套基於「空間變異張量（Spatially Varying Tensor）」的色彩解混與平場校正演算法，以軟體運算徹底彌補硬體的不足。

1.6.2 突破實體繞射極限：圖案化照明傅立葉疊層成像 (piFP)

傳統顯微鏡的解析度受限於物鏡的數值孔徑（Numerical Aperture, NA）與光的波長，此即著名的「阿貝繞射極限（Abbe Diffraction Limit）」。在低成本系統中，為了兼顧大視野（大視野通常需要低倍率、低 NA 的物鏡），我們往往必須犧

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

牲解析度。本研究的終極目標之一，是在不更換昂貴高 NA 物鏡的前提下，透過「運算光學（Computational Optics）」的手段突破物理極限。我們將導入 ** 圖案化照明傅立葉疊層成像技術 (pattern-illuminated Fourier Ptychography, piFP)**。這項前瞻技術利用在光源後放置隨機微結構的擴散片（Diffuser），產生空間圖案照明，藉由頻率混疊效應將高頻細節編碼至低頻影像中。隨後透過大量的演算法疊代，在電腦中「拼湊」出超越物鏡物理極限的高解析度影像。

1.7 論文架構與章節總覽

綜上所述，本研究旨在透過跨領域的整合—結合樂高積木的精密幾何、剛性龍門機電控制、先進的非同步多執行緒軟體架構，以及前沿的運算成像數學模型—開發出一套成本效益極高、具備極高擴充性且能產出研究級數據的「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」。

為了讓讀者能夠完整理解本研究的理論基礎與實作細節，本論文後續章節安排如下：

- **第二章：文獻探討**：將深入解析現有開源顯微鏡的設計原理，詳述傅立葉疊層成像（FP）的數學理論基礎，並探討自動對焦技術與感測器色彩校正的發展脈絡。
- **第三章：研究方法**：為本論文之核心。將以極度詳盡的方式，從有限共軛光學的計算、NEMA 17 馬達的微步進物理、PySide6 軟體架構的設計模式，一路寫到自動對焦與張量色彩解混的完整數學推導。
- **第四章：初步結果與系統驗證**：將展示本系統在標準校正板與螢光微球上的量化測試結果，並詳細拆解 14 秒高速自動對焦過程中的每一項數據變化。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

- **第五章：論文研究進度表**：詳列本專案至 2026 年中完成前的具體任務規劃與時程安排。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第二章　文獻探討與基礎理論

為了建構一套兼具低成本與高效能的多功能樂高螢光倒立式顯微鏡，本研究廣泛參考了光學工程、機電整合、電腦視覺與運算成像等多個領域的先驅研究與基礎理論。本章將針對開源硬體顯微鏡的發展現況、運算成像與傅立葉疊層的數學基礎、自動對焦技術的演進，以及影像感測器的底層物理機制進行深度的探討與解釋。透過這些紮實的理論基礎，讀者將能徹底理解本研究所提出之各項設計與演算法背後的「Why」與「How」。

2.1　開源硬體顯微鏡的發展與機構分析

隨著自造者運動（Maker Movement）的興起，學術界開始致力於打破高階儀器的壟斷，推動「硬體民主化（Hardware Democratization）」。在開源顯微鏡領域，有幾個極具代表性的專案，它們各自提出了不同的機械與光學解決方案。

2.1.1　OpenFlexure Microscope 與撓性機構的力學原理

由英國巴斯大學（University of Bath）Richard Bowman 團隊開發的 OpenFlexure Microscope (Collins et al., 2020) 是目前最著名且被廣泛應用的 3D 列印開源顯微鏡之一。其最核心的技術創新在於採用了「撓性鉸鏈（Flexure Hinge）」來達成奈米等級的精確定點移動。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.1.1.1 背隙（Backlash）與靜摩擦力（Stiction）問題

在傳統的金屬加工載台中，物體的移動依賴滑軌（Linear Guide）與齒輪（Gears）。當馬達改變旋轉方向時，齒輪齒與齒之間的空隙會導致一段時間內馬達在轉動但載台沒有位移，這被稱為「背隙（Backlash）」。此外，滑軌之間存在滑動摩擦，物體從靜止到開始移動需要克服較大的「靜摩擦力（Stiction）」，這會導致微小步進時產生「粘滑效應（Stick-slip）」，使得載台無法平順地進行微米級的移動。

2.1.1.2 撓性鉸鏈（Flexure Hinge）的解決方案

OpenFlexure 巧妙地避開了上述問題。它不使用任何滑動部件，而是將整個機身用 3D 列印一體成型。在機身的特定位置，故意將塑膠列印得極薄（約 0.5 mm 至 1 mm）。當外部施加推力時，這些薄壁處會發生局部的彈性彎曲（Elastic Bending），如同鉸鏈一般帶動其他部分移動。由於整個系統是連續的固體，沒有任何零件分離，因此：

1. **絕對零背隙**：沒有齒輪間隙。
2. **絕對零靜摩擦**：沒有滑動接觸面。

這使得 OpenFlexure 能使用極其便宜的步進馬達與塑膠螺絲，達成難以置信的平滑微調。

2.1.1.3 撓性機構的致命傷：行程與剛性

然而，如同第一章所述，撓性機構受限於胡克定律（Hooke’s Law）。塑膠的彈性變形區間極小，一旦推動距離過長，材料就會超過降服強度（Yield Strength）

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

而產生永久變形。這使得 OpenFlexure 的 X-Y 移動範圍通常被限制在 $12 \times 12 \times 4$ mm 之內，完全無法應用於大面積的樣本掃描。此外，一體成型的 3D 列印塑膠剛性極低，任何微小的外力觸碰或長時間放置（潛變 Creep），都會導致光軸嚴重偏移。這正是本研究選擇揚棄撓性機構，改採高剛性「樂高龍門架構」的根本原因。

2.1.2 模組化概念：Incubot 與 UC2 系統

除了追求低成本，開源系統也開始強調「模組化（Modularity）」。**Incubot** (Merces et al., 2021) 是一款專為長時間放置於培養箱內設計的小型顯微鏡。其特色在於將機身極簡化，並使用防潮防腐蝕的材料。**UC2 (Use-Case-box)** (Diederich et al., 2020) 則是另一款極具啟發性的設計。UC2 採用了「方塊積木」的概念，將雷射、透鏡、相機等光學元件分別裝入標準尺寸的 3D 列印方塊中。研究人員可以像拼圖一樣將這些方塊組合在帶有磁鐵的底板上。雖然 UC2 提供了高度的擴充性，但其磁吸底板的定位精度與整體結構剛性，在面對需要頻繁移動載台的自動化掃描時，仍顯得力不從心。

綜合上述文獻，我們可以發現：現有的開源設計在「低成本」、「高精度」、「大行程」與「高剛性」這四個維度上始終無法兼顧。本研究正是試圖透過樂高積木的工業級精度與龍門機電架構，找到這四者的最佳平衡點。

2.2 運算成像與圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 理論

傳統顯微鏡的解析度極限由德國物理學家恩斯特·阿貝（Ernst Abbe）於 1873 年提出。根據阿貝繞射極限公式：

$$d = \frac{\lambda}{2 \cdot \mathrm{NA}} \tag{2.1}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

其中 d 是系統能分辨的最小距離，λ 是光波長，NA 是物鏡的數值孔徑（Numerical Aperture）。在低成本顯微系統中，我們通常只能負擔低 NA 的物鏡（例如 NA = 0.1 或 0.25），這使得解析度大受限制。

2.2.1 傅立葉光學（Fourier Optics）基礎

要理解如何突破繞射極限，必須先理解光學中的傅立葉轉換。當一束光穿過樣本後，樣本的空間結構（Spatial Structure）會將光波「繞射（Diffract）」到不同的角度。這個現象可以透過「光柵繞射方程式（Grating Equation）」來精確描述：

$$d \cdot \sin\theta = m \cdot \lambda \tag{2.2}$$

其中 d 是樣本空間結構的週期（例如微結構的間距），θ 是繞射角，m 是繞射級數（通常我們最關注一階繞射 $m = 1$ 的能量分佈），而 λ 則是照明光的波長。

從該方程式可以直觀推導出：繞射角 θ 的正弦值與結構尺寸 d 呈反比關係。如圖 2.1 所示：

- 樣本中**較大、較粗糙的結構**（低頻資訊，對應較大的 d），會讓光線以**極小的角度**偏折（θ 較小）。
- 樣本中**極微細、密集的結構**（高頻資訊，對應較小的 d），會讓光線以**極大的角度**偏折（θ 較大）。

物鏡就像是一個「低通濾波器（Low-pass Filter）」。由於物鏡的開口大小（即數值孔徑 NA）有限，它的接收錐角（Acceptance Angle）是固定的。那些被高頻微細結構以大角度偏折出去的光線，會無法進入物鏡內部，這意味著高解析度資訊在光學傳遞的過程中就已經永遠遺失了。反映在最終的相機影像上，就是模糊

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

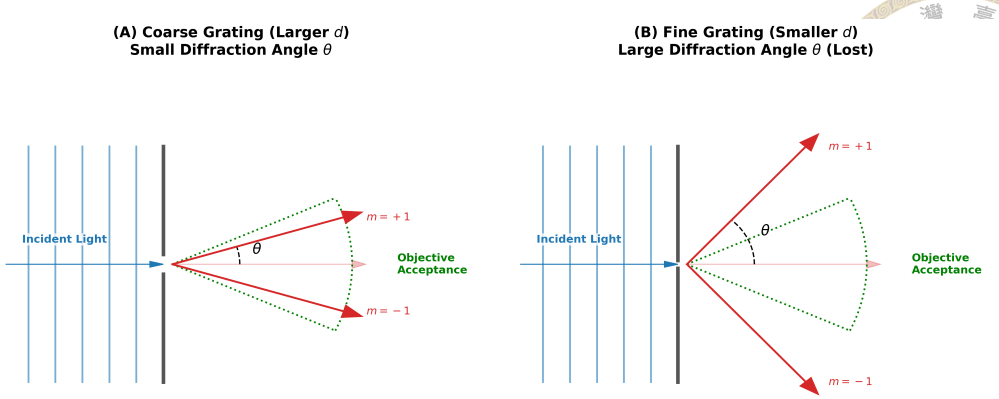

圖 2.1: 光柵繞射原理示意圖。左圖（A）顯示較大的結構週期 d 會產生較小的繞射角，光線易於進入物鏡接收錐角內；右圖（B）顯示細微結構（極小的 d）會導致光線以極大角度繞射，甚至超出物鏡的接收範圍（綠色虛線區），造成高頻細節的遺失。

且看不見細節。

2.2.2 傅立葉疊層成像 (Fourier Ptychography, FP) 的核心思想

如果在明視野下高頻光線進不了物鏡，那我們能不能改變照明的角度？FP 技術的核心思想最早由 Zheng 等人於 2013 年提出 Zheng et al. (2013)：透過從不同角度（傾斜）照射樣本，強迫原本會發散到物鏡外的大角度高頻光線，被「推」進物鏡的接收錐角內。透過依次點亮 LED 陣列中不同位置的單元，我們可以拍攝一系列低解析度但包含不同頻譜資訊的影像。最後，利用疊代相位復原演算法（Iterative Phase Retrieval Algorithm），在電腦的頻域（Fourier Domain）空間中，將這些重疊的小區塊頻譜「縫合」成一個巨大無比的頻譜（系統架構如圖 2.2 所示），經由反傅立葉轉換後，即可獲得極高解析度的影像。

2.2.3 針對螢光系統的 piFP 與波前調控

傳統的 FP 依賴 LED 陣列進行角度掃描，且必須建立在光線是「相干的（Coherent）」（如雷射或窄頻 LED）前提下。然而，螢光發光是一種「非相干

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

圖 2.2: 基於 LED 陣列之傅立葉疊層成像 (FP) 系統架構示意圖（圖片參考自 Zheng et al. (2013)）。系統透過可程式化控制的 LED 陣列提供不同角度的照明，將樣本的高頻資訊偏移至物鏡可接收的孔徑內。

（Incoherent）」且自發各向同性的過程，傳統的 FP 無法直接應用於螢光成像。為此，Dong 等人提出了 **圖案化照明傅立葉疊層 (piFP)** (Dong et al., 2014)。piFP 放棄了角度掃描，改為在樣本前方放置一個能夠產生空間高頻圖案（例如散斑 Speckle）的元件。根據頻率混疊（Aliasing）原理，當我們將高頻的照明圖案疊加在樣本上時，照明圖案的空間頻率會與樣本的空間頻率發生相加或相減的「差頻效應」。這會將樣本極高頻的細節，硬生生地「搬移（Shift）」到低頻區域，使其能夠順利穿過低 NA 的物鏡被相機捕捉。He 等人 (He et al., 2020) 進一步證實了使用低成本擴散片（Diffuser）進行波前調控的優越性。在我們的系統中，我們即是透過移動擴散片來產生不同的隨機圖案照明，藉由記錄多張帶有不同圖案混疊的螢光影像，最終在演算法中解譯出被隱藏的高解析度螢光結構。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

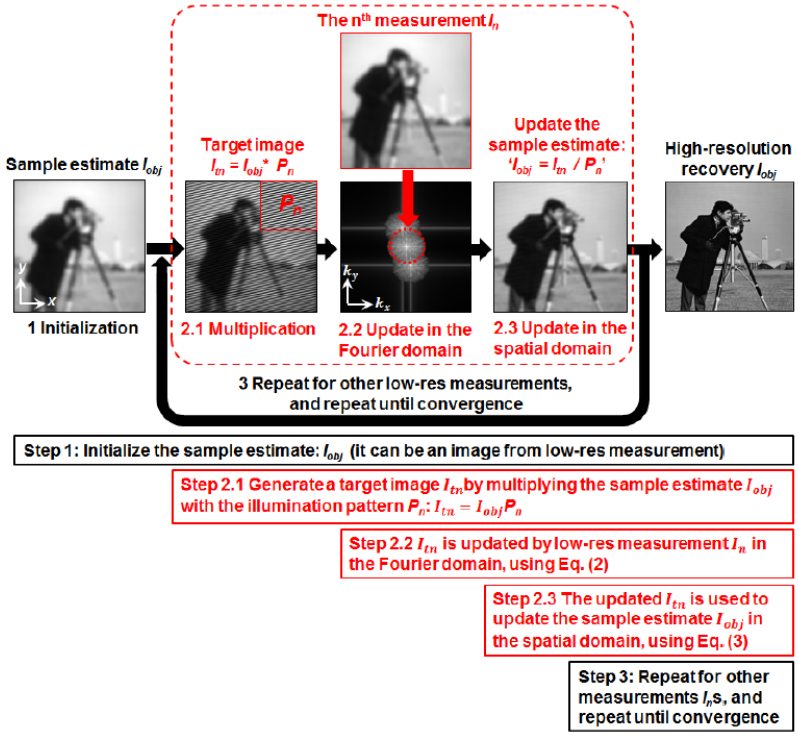

圖 2.3: 圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 突破繞射極限之原理與系統架構示意圖（圖片來源：Dong et al. (2014)）。

2.3 動態自動對焦技術的數學原理

在顯微鏡掃描大面積樣本（如培養皿）時，由於樣本底部不可能絕對平坦，且龍門機架移動時也會有微小起伏，焦平面（Focal Plane）的漂移是不可避免的。因此，一套強健的自動對焦（Autofocus, AF）演算法是自動化系統的靈魂。

2.3.1 對焦指標（Focus Metrics）的選擇

自動對焦的核心在於計算一張影像的「清晰度（Sharpness）」。我們透過推動 Z 軸馬達拍攝一系列影像，計算每張影像的清晰度分數，分數最高的位置即為焦平面。在顯微鏡中，我們通常採用對比度檢測自動對焦（Contrast-Detection Autofocus, CDAF）。其基本假設是：** 影像越清晰，相鄰像素之間的對比度越大，高頻細節越豐富。** 本研究實作了三種不同數學特性的對焦指標：

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.3.1.1 1. 全域變異數（Global Variance）

變異數衡量的是影像亮度的離散程度。對於一張大小為 $M \times N$，像素值為 $I(x,y)$ 的影像，其平均亮度 μ 為：

$$\mu = \frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N} I(x,y) \tag{2.3}$$

全域變異數 (Variance) 則定義為：

$$V = \frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N} [I(x,y) - \mu]^2 \tag{2.4}$$

物理意義：當影像嚴重失焦時，所有結構糊在一起，像素值趨近於平均亮度，變異數極小。當影像對焦時，亮暗分明，變異數達到最大。**優點與缺點**：Variance 的對焦曲線非常平緩（如同一座寬廣的平緩山丘）。這意味著即使在距離焦平面極遠（幾百微米）的地方，它仍能給出正確的梯度方向。缺點是它在峰值附近不夠尖銳，無法精確鎖定微米級的焦點。因此，在本系統中，Variance 被專門用於 **「第一階段粗調」**。

2.3.1.2 2. 空間頻率（Spatial Frequency）

空間頻率評估的是影像在水平（Row）與垂直（Column）方向的像素變化劇烈程度。

$$RowFreq = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=2}^{N} [I(x,y) - I(x,y-1)]^2} \tag{2.5}$$

$$ColFreq = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=2}^{M}\sum_{y=1}^{N} [I(x,y) - I(x-1,y)]^2} \tag{2.6}$$

$$SF = \sqrt{RowFreq^2 + ColFreq^2} \tag{2.7}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

物理意義：SF 專門捕捉影像中的邊緣（Edges）資訊。它比 Variance 對失焦更敏感，曲線更陡峭，非常適合作為 **「第二階段中調」** 的指標。

2.3.1.3 3. Brenner 與 Tenengrad 梯度函數

這兩者是極度靈敏的高頻過濾器。Brenner 梯度計算相隔一個像素的差值平方：

$$Brenner = \sum_x \sum_y [I(x+2,y) - I(x,y)]^2 \quad \text{for} \quad |I(x+2,y) - I(x,y)| > \text{Threshold} \tag{2.8}$$

Tenengrad 則是利用著名的 Sobel 算子（分別在 x 與 y 方向求一階偏導數）來提取極高頻的邊緣：

$$G_x = I * S_x, \quad G_y = I * S_y \tag{2.9}$$

$$Tenengrad = \sum\sum (G_x^2 + G_y^2) \quad \text{for} \quad (G_x^2 + G_y^2) > \text{Threshold} \tag{2.10}$$

物理意義：這些指標的對焦曲線如同一根尖刺（Needle-like）。在偏離焦平面哪怕只有幾微米時，其數值就會如懸崖般暴跌。因此，它們被用於 **「第三階段精調」**，確保系統能以 $0.625\mu m$ 的精度死鎖焦平面。

2.3.2 極端環境下的抗噪策略：形態學對焦指標

上述數學模型在明視野（Bright-field）下運作完美，因為明視野影像明亮且信噪比高。但在螢光（Fluorescence）模式下，樣本發出的光極其微弱，且背景充滿了未結合螢光染劑的雜散光（Haze）與相機感測器的熱雜訊（Thermal Noise）。這些高頻的白雜訊會嚴重干擾 Tenengrad 等依賴梯度的演算法，導致在失焦的背景中計算出虛假的「高頻雜訊峰值」，讓演算法徹底迷失方向。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

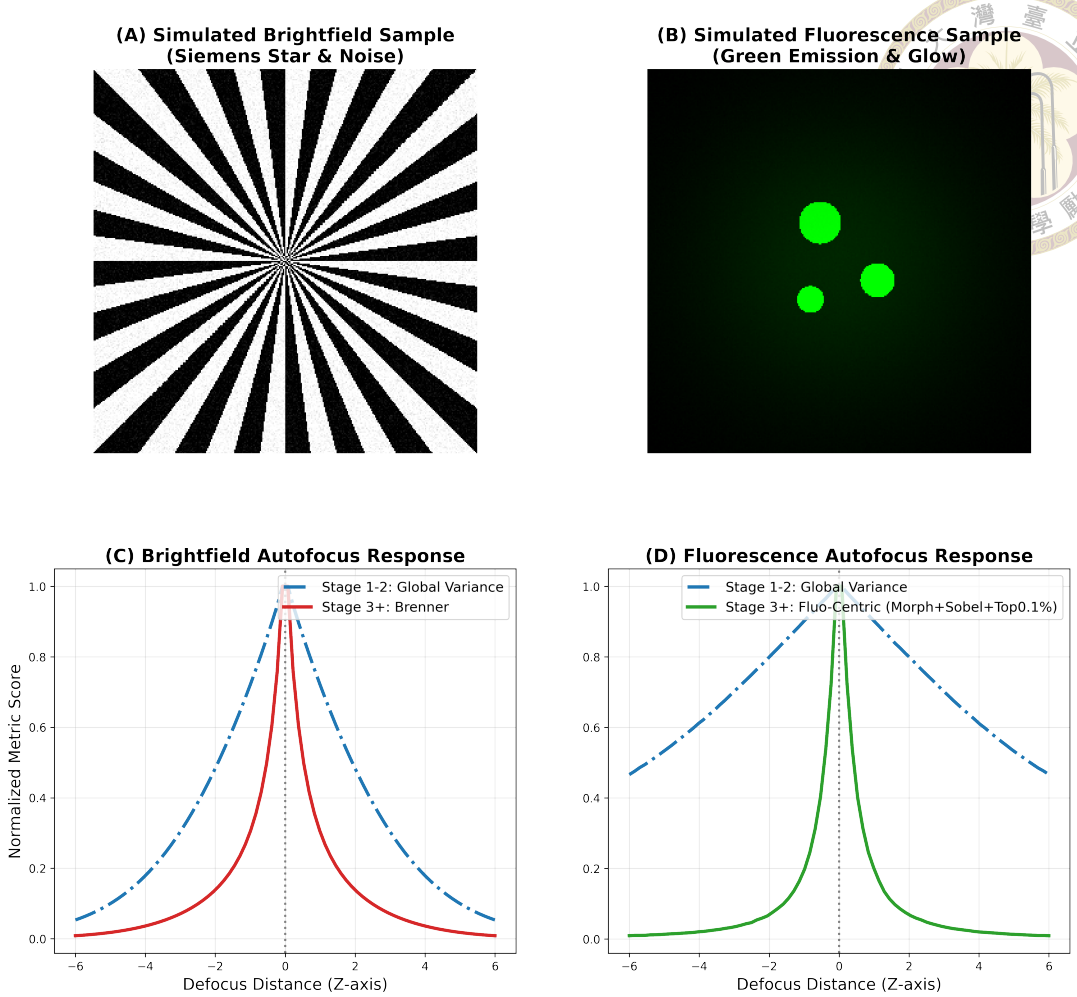

圖 2.4: 明視野（左）與螢光（右）環境下，不同自動對焦指標對脫焦距離的響應曲線模擬對比。

為了克服此問題，本研究首創在對焦前加入「形態學開運算（Morphological Opening）」。開運算是影像處理學中的基石，由「侵蝕（Erosion）」與「膨脹（Dilation）」串聯組成：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \tag{2.11}$$

其中 A 為原始影像，B 為結構元素（Structuring Element, 通常為 3×3 或 5×5 的矩陣）。

- **侵蝕（Erosion）**：會將影像中孤立的、比結構元素還小的亮點（亦即雜訊）無情地抹除，同時也會讓真實的螢光細胞變小。
- **膨脹（Dilation）**：隨後將剩餘的真實細胞結構恢復到原本的大小，但那些已

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

經被抹除的雜訊則無法復原。

透過開運算徹底洗淨雜訊後，再進行 Sobel 梯度計算。為求極致的抗干擾性，我們在程式中甚至加入了一道排序過濾：**僅提取全圖前 0.1% 最強烈的像素（Top 0.1% Peaks）**來計算最終得分。這確保了系統永遠只對最明亮的螢光結構對焦，徹底免疫背景雜散光的干擾。

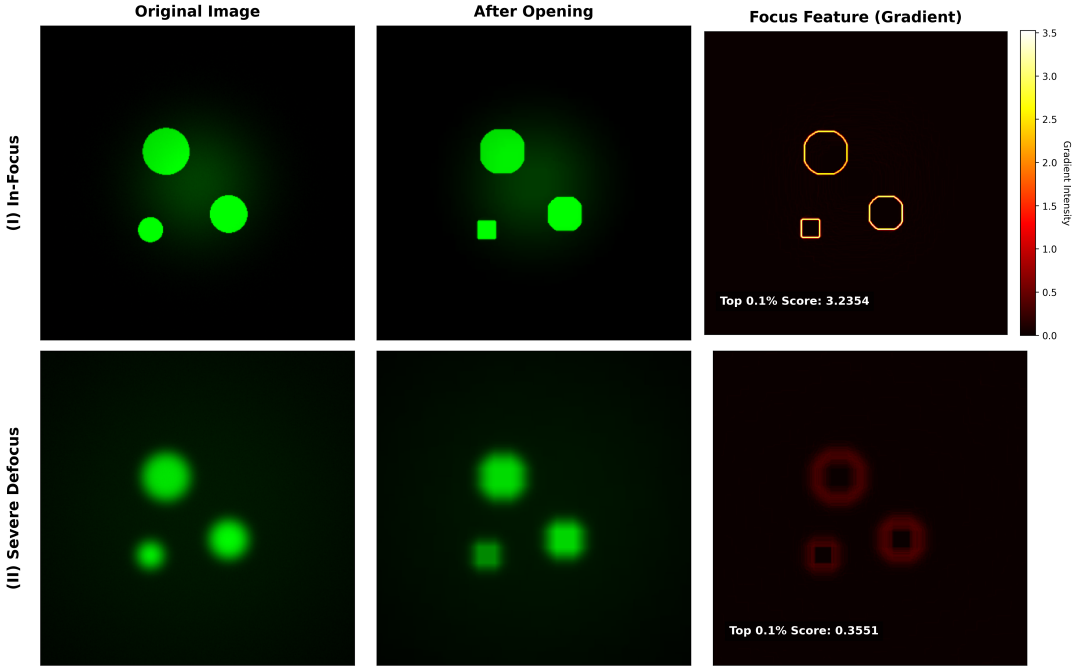

圖 2.5: 基於物理模型之大範圍失焦模擬與形態學抗噪處理流程對比圖。

2.4 感測器物理學與色彩校正 (Color Correction) 理論

將百元等級的 Raspberry Pi Camera 取代數十萬元科學級相機的代價，就是必須面對消費級感測器在光學設計上的嚴重妥協。

2.4.1 主光線角度 (Chief Ray Angle, CRA) 的幾何偏誤

現代 CMOS 感測器為了極致的微縮化，其每一個感光像素（Pixel）的面積極小。為了提高感光度，半導體工程師會在每一個像素上方製作一個微小凸透鏡，

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

稱為 ** 微透鏡陣列（Microlens Array）**。這些微透鏡負責將照射到像素邊緣的光線「匯聚」到像素中心的感光區。然而，微透鏡的聚光角度是經過精心計算的，它必須與原廠搭配的鏡頭的主光線角度（CRA）完美匹配。通常，智慧型手機鏡頭邊緣射入感測器的光線會帶有一個傾斜角度（例如 25 度）。當我們將 Raspberry Pi Camera 的原廠小鏡頭拔除，換上顯微鏡的「有限共軛系統」時，顯微光路投射到感測器邊緣的光線通常是近乎垂直的（CRA 接近 0 度）。這就導致了災難性的後果：垂直入射的顯微光線，在經過感測器邊緣的傾斜微透鏡時，被錯誤地折射到了該像素的「感光區之外」，甚至是折射到了「隔壁的像素」裡。

2.4.2 暗角與色彩串擾的形成

上述的 CRA 不匹配直接導致了兩個致命的影像缺陷：

1. **嚴重暗角（Vignetting）**：畫面中心的光線垂直進入微透鏡，正確落在感光區，因此中心明亮。越靠近畫面邊緣，光線被錯誤折射流失得越多，導致影像邊緣變得極度暗沉。

2. **色彩串擾（Color Crosstalk）**：幾乎所有消費級彩色相機都覆蓋著拜爾濾波器（Bayer Filter Array, 依據 RGGB 排列）。當綠色像素上的微透鏡將光線錯誤折射到隔壁的紅色或藍色像素時，感測器就會回報錯誤的顏色資訊。這使得原本應該是純綠色的螢光樣本，在影像周圍會因為光譜溢出而變成蒼白、甚至是紫紅色的錯誤色彩。

這些物理層面的缺陷無法透過改變顯微鏡的機械結構來修復。唯一且最有效的方法，就是深入影像處理的底層，透過建立複雜的「空間變異增益矩陣（Spatially Varying Gain Maps）」與「解混張量（Unmixing Tensor）」，在每一個像素

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

點上進行精準的反向數學補償。這正是本論文第三章「影像處理管線」將要詳細推導與實作的核心技術。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第三章　研究方法與系統實作

本章將毫無保留地揭露本研究所開發之「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」的底層技術細節。我們將從最基礎的光學佈局開始，依序探討機電整合硬體、非同步軟體架構，最終深入剖析系統核心的「多階段動態自動對焦」與「張量影像校正」演算法的數學原理與程式實作邏輯。

3.1　系統硬體架構與機電整合

3.1.1　有限共軛光路設計 (Finite-Conjugate Optical Design)

為求極致的精簡與成本控制，本系統揚棄了傳統高階顯微鏡中體積龐大的「無限遠校正光學系統（Infinity-Corrected Optical System）」。在傳統無限遠系統中，物鏡將光線轉化為平行光束（無限遠），必須在光路後端加裝一顆管鏡（Tube Lens）才能將平行光重新匯聚成像於感測器上。

本系統改採基於 OpenFlexure (Collins et al., 2020) 理念的 **「有限共軛（Finite-Conjugate）」** 光學設計。在此配置下，我們直接利用 Raspberry Pi Camera Module 2 (IMX219) 感測器，並搭配標準顯微物鏡。物鏡直接將樣本上的影像，經過一段固定的物理距離（即鏡筒長度，Tube Length），直接投射並聚焦於 CMOS 感測器

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

裸片上。根據高斯透鏡公式（Gaussian Lens Equation）：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \tag{3.1}$$

其中 f 為物鏡焦距，u 為樣本至物鏡的主面距離（物距），v 為物鏡至感測器的距離（像距）。系統的放大倍率（Magnification, M）則由幾何關係決定：

$$M = \frac{v}{u} \approx \frac{L}{f} \tag{3.2}$$

其中 L 近似於我們所設計的 3D 列印鏡筒長度。透過精確計算與設計 3D 列印轉接套件，我們能將物鏡與相機感測器牢牢固定在樂高底板上，確保光軸（Optical Axis）絕對垂直且同心。

3.1.2 基於樂高與龍門架構之機械載台

為了解決純 3D 列印顯微鏡（如 OpenFlexure）因撓性鉸鏈導致的「極短行程」與「潛變漂移」問題，本研究大膽引入了工業自動化中常見的 ** 剛性龍門架構（Gantry-style Architecture）**，並將其與樂高積木的標準幾何網格完美結合。

- **樂高光學桌（LEGO Optical Breadboard）**：顯微鏡的基座由大量互相卡扣的樂高科技系列（LEGO Technic）積木構成。由於樂高具備極其嚴苛的射出成型公差（$< 10\mu m$），其標準的 8.0 mm 孔距為整個光學系統提供了一個天然且完美的正交座標系，大幅降低了組裝時的對齊誤差。

- **龍門傳動系統**：捨棄塑膠變形機制，X、Y、Z 三軸皆採用真實的金屬線性滑軌與導螺桿（Lead Screw）傳動，這使得載台能輕易進行數公分以上的大範圍平移，完美支援多孔盤（Multi-well plate）的高通量掃描。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.1.3 動力與電子控制子系統

本系統的機電大腦由 Raspberry Pi 4 單板電腦與 Arduino Uno 微控制器共同組成。

3.1.3.1 1. 步進馬達與極限微步進 (Microstepping) 控制

載台的驅動核心為三顆 NEMA 17 兩相四線步進馬達。為了驅動這些馬達，我們使用 Arduino Uno 搭配 CNC Shield V3 擴充板，並在上面安插了 A4988 馬達驅動晶片。一般 NEMA 17 馬達的物理步進角為 1.8°，亦即馬達軸心旋轉一整圈需要 $360°/1.8° = 200$ 步。為了達到顯微等級的定位精度，我們在 CNC Shield 上透過硬體跳線（Jumper）啟動了 A4988 的 **16 倍微步進（16x Microstepping）** 模式。微步進技術透過精密控制兩個線圈的電流比例（利用正弦與餘弦波形），強迫馬達轉子停在兩個物理磁極之間。這使得原本旋轉一圈的 200 步被細分成了 $200 \times 16 = 3200$ 微步。

在我們的 Z 軸設計中，配備了導程（Lead）為 2.0 mm 的導螺桿（即馬達旋轉一圈，載台垂直移動 2.0 mm）。根據系統組態檔（`config.py`）的數學定義，Z 軸的理論定位精度可精確計算如下：

$$Resolution_Z = \frac{2.0 \text{ mm}}{3200 \text{ steps}} = 0.000625 \text{ mm/step} = 0.625 \text{ µm/step} \tag{3.3}$$

此高達亞微米（$0.625\mu m$）的驚人定位精度，賦予了系統精確切割焦平面的能力，是後續演算法能成功鎖定焦點的絕對物理前提。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.1.3.2 2. 雙模光源的 GPIO 同步控制

顯微鏡的照明系統分為明視野（Bright Field）的透射白光，以及螢光模式（Fluorescence）的激發光源。我們在 hardware_control.py 中實作了 LightControl 類別，直接呼叫 RPi.GPIO 函式庫控制樹莓派的硬體腳位。明視野光源連接至 GPIO 17，螢光光源連接至 GPIO 27。此設計允許軟體在掃描過程中以毫秒級的延遲瞬間切換光源，有效避免螢光樣本在不拍攝時遭到持續照射而產生螢光淬滅（Photobleaching）現象。

3.2 非同步多執行緒的軟體架構

要讓一台顯微鏡流暢運作，最大的軟體挑戰在於「如何同時處理即時的高解析度影像串流、繁重的影像處理矩陣運算，以及與硬體的序列埠（Serial Port）通訊，而不導致使用者介面（GUI）卡頓？」為了解決這個併發性（Concurrency）問題，本研究基於 Python 語言，引入了 PySide6 (Qt) 的事件迴圈（Event Loop）機制，構建了嚴密的 ** 多執行緒（Multi-threading）架構 **。

3.2.1 模組化執行緒設計 (workers.py)

系統的核心被封裝在 CameraWorker 類別中。這是一個獨立於主 GUI 執行的背景工作物件。

- **影像擷取與運算迴圈**：CameraWorker 內部不斷向 Picamera2 請求最新的原始影像陣列（Raw Array）。獲取陣列後，立即在該執行緒內進行平場校正與色彩解混等繁重的矩陣運算（詳見後述）。
- **硬體通訊分離**：對於需要等待 Arduino 回應的馬達控制指令，我們實作了

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

MotorControl 類別。當 CameraWorker 決定要移動馬達時，它不會傻傻等待，而是將指令交給一個專屬的 IO 執行緒（IO Thread）去與 Serial Port 溝通。這種「發射後不理（Fire-and-forget）」的設計，確保了相機的 FPS 永遠不會因為等待馬達移動而掉幀。

3.2.2 RESTful 風格的 API 處理器 (api_handler.py)

為了讓這台顯微鏡具備遠端操作的潛力，我們並沒有將 UI 按鈕直接綁定硬體指令。相反地，我們設計了一個名為 ApiHandler 的中介層。所有的控制命令（如 move_z_1_10、autofocus、toggle_color_correction）皆封裝為類似 RESTful API 的請求。主程式透過呼叫 handle_request(cmd, params) 進行邏輯分發。這種解耦（Decoupling）的設計，使得未來只要外掛一個輕量級的 HTTP Server，研究人員就可以透過網頁瀏覽器（Browser）在世界任何角落操控這台顯微鏡。

3.3 空間變異張量影像校正管線 (Image Processing Pipeline)

如第二章所述，消費級感測器在顯微光路下會產生嚴重的暗角與色彩串擾。本節將詳細推導 image_processing.py 中為解決此問題而開發的四大矩陣運算步驟。

3.3.1 1. 硬體黑電平補償 (Black Level Subtraction)

所有 CMOS 感測器即使在完全黑暗的環境下，也會因為熱電子釋放而產生微小的基底電壓信號。在 Raspberry Pi Camera V2 的 ISP (Image Signal Processor) 設

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

定中，這個基準值（Pedestal）通常被設為 64（在 10-bit raw 資料下）。我們在讀取原始 Bayer 資料後，第一步就是利用廣播機制（Broadcasting）將所有通道的像素值強行扣除這個偏移量：

$$I_R(x,y) = \max(0, Raw_R(x,y) - 64.0) \tag{3.4}$$

此步驟對於後續的乘法校正極為關鍵。如果沒有扣除底噪，平場校正會將背景雜訊無差別地倍增，導致畫面充滿雪花般的噪點。

3.3.2 2. 背景扣除 (Background Subtraction) 對抗環境漏光

在螢光模式下，任何極其微弱的環境漏光（Stray Light）或載玻片自發的背景螢光，都會嚴重影響微弱樣本的信號。系統提供了一個校準機制：在沒有樣本的情況下先拍攝一張全黑的「背景幀（Background Frame, I_{bg}）」。在後續即時運算中，每一幀影像都會逐像素扣除該背景：

$$I'_{R,G,B}(x,y) = \max(0, I_{R,G,B}(x,y) - I_{bg,R,G,B}(x,y)) \tag{3.5}$$

3.3.3 3. 空間增益矩陣平場校正 (Flat-field Correction)

為了解決 CRA 造成的暗角問題，我們引入了增益矩陣（Gain Maps）。在系統初始化時，對著均勻的白光背景拍攝一張基準影像 W。為了避免極端高光或灰塵造成的雜訊干擾，我們不直接取最高亮度，而是計算每個通道中心區域亮度的 **95 百分位數 (95th Percentile)** 作為目標基準值 $T_{channel}$。隨後，我們計算出一張與畫

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

面解析度等大 $(M \times N)$ 的增益矩陣 G：

$$G_{channel}(x,y) = \frac{T_{channel}}{W_{channel}(x,y)} \tag{3.6}$$

在即時運算中，透過矩陣點乘 (Element-wise Multiplication, Hadamard Product)，將畫面邊緣衰減的亮度強行放大補償回來：

$$I_{flat}(x,y) = I'(x,y) \circ G(x,y) \tag{3.7}$$

3.3.4 4. 愛因斯坦求和與色彩解混張量 (Tensor Unmixing)

這一步是本系統在影像處理上最具突破性的核心。為了解決綠色像素微透鏡將光線折射到紅色像素所造成的「色彩串擾（Color Crosstalk）」，我們不能只使用全域的色彩校正矩陣（Global CCM）。因為 CRA 在畫面中心與邊緣的角度是完全不同的，** 色彩的溢出程度在空間中是連續變異的 **。為此，我們訓練並載入了一個名為 `unmix_tensor.npy` 的四維張量（Tensor）。其維度為 $H \times W \times 3 \times 3$。這意味著：** 畫面上的每一個像素點，都有一個專屬於該位置的 3×3 解混矩陣。**

假設某個像素位置 (x,y) 測得的錯誤顏色向量為 $\vec{C}_{measured} = [R_m, G_m, B_m]^T$，真實顏色向量為 $\vec{C}_{true}$，串擾轉換矩陣為 $M_{crosstalk}$，則：

$$\vec{C}_{measured} = M_{crosstalk} \cdot \vec{C}_{true} \tag{3.8}$$

我們預先計算好的解混張量中的 3×3 矩陣 $U(x,y)$ 就是 $M_{crosstalk}$ 的反矩陣。因此，還原真實顏色的數學式為：

$$\vec{C}_{true}(x,y) = U(x,y) \cdot \vec{C}_{measured}(x,y) \tag{3.9}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

要在高解析度（例如 1640×1232）下，對每一個像素執行 3×3 矩陣乘法，如果使用 Python 的 `for` 迴圈，耗時將長達數秒，根本無法串流影片。在這裡，我們巧妙地運用了 NumPy 庫中最底層、基於 C 語言高度最佳化的 ** 愛因斯坦求和約定（Einstein Summation Convention, `np.einsum`）**：

$$I_{unmixed} = \texttt{np.einsum}('hwij, hwj \rightarrow hwi', U, I_{flat}) \tag{3.10}$$

這行極度簡潔的程式碼，利用多執行緒向量運算（Vectorization），在數十毫秒內完成了數百萬次的微型矩陣乘積，完美還原了每一顆細胞的真實色彩。

3.4 多階段動態自動對焦狀態機 (State Machine)

在顯微鏡的高通量掃描中，系統必須能夠在一無所知的狀態下，指揮 Z 軸馬達自動尋找到幾微米厚度的焦平面。這是一個典型的「最佳化搜尋（Optimization Search）」問題。我們在 `autofocus.py` 中構建了一個嚴謹的狀態機（State Machine）來主導這場搜尋。

3.4.1 三重對焦指標的切換邏輯

正如第二章所述，不同的數學指標適用於不同的失焦距離。本系統設計了一個名為 `FOCUS_STEPS_LIST` 的步數表，例如 `[(100, True), (25, True), (3, False)]`。

- **第一階段（廣域搜索，步長 100 μm）**：系統距離焦平面極遠。此時啟動 ** 全域變異數 (Global Variance)**。馬達大步幅跨越，只要變異數持續上升，就表示方向正確。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

- **第二階段（收斂搜索，步長 25 μm）**：進入焦平面附近，變異數曲線變得平緩。此時演算法自動切換為 ** 空間頻率 (Spatial Frequency)**。利用邊緣對比度更陡峭的特性，快速逼近焦點。

- **第三階段（精細鎖死，步長 3 μm 至 1 μm）**：進入微米級決戰。在明場模式下切換為 **Tenengrad 梯度 **；在螢光模式下，則切換為 **「形態學開運算 + 前 0.1% 梯度」**（Morphological + Top 0.1%）。此時，對焦曲線變得如針尖般銳利。

3.4.2 防呆盲區偵測與閉迴圈峰值回溯 (Peak Recovery)

在真實環境中，搜尋並非總是一帆風順。

3.4.2.1 1. 盲區偵測 (Blind Zone Detection)

如果一開始馬達移動的方向是「遠離」焦平面，所有指標的分數都會連續下降。演算法內建了計數器，一旦偵測到分數連續兩次或三次下降，就會觸發「盲區防呆機制」，強制將馬達的搜尋方向反轉（乘以 -1），並大幅跨步退回起始點重新搜索。

3.4.2.2 2. 尋峰回溯機制 (Closed-loop Peak Recovery)

由於對焦指標是「離散的」，系統不可能恰好停在物理上的絕對最高點。通常的情況是，馬達會「跨過（Overshoot）」山頂，導致分數從最高點開始滑落。當演算法在精調階段偵測到分數跌破歷史最高分數（Historical Max Score）的 80% 時，狀態機將判定「已經過頭了」。此時，系統會啟動「尋峰回溯」：馬達會自動反向，並以極小的步長（例如 1 微步）慢慢爬回剛才的山頂。直到當前分數回升至歷史

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

最高分的 98% 以上時，系統才會宣告對焦「成功（FINISHED）」。這套閉迴圈的確認機制，徹底抹平了廉價步進馬達不可避免的物理背隙誤差。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第四章　初步實驗結果與系統效能評估

本研究在完成「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」的原型機組裝與軟硬體整合後，隨即開展了一系列的基準測試（Benchmarking）。本章將詳述系統在明視野解析度、螢光色彩校正保真度，以及動態自動對焦收斂速度等三大面向的初步實驗數據與量化分析結果。所有實驗均在室溫恆定，且遮蔽外部環境光源的條件下進行，以確保測試數據的客觀性與可重複性。

4.1　光學解析度與平場校正 (Flat-field) 驗證

為了客觀評估有限共軛光路與 Raspberry Pi Camera 結合後的光學極限，我們首先進行了明視野下的基礎測試。

4.1.1　NBS 1952 標準解析度測試卡實驗

本實驗採用 NBS 1952 (National Bureau of Standards 1952) 標準解析度測試卡作為樣本。該測試卡上印有不同空間頻率的微細黑白條紋圖案，頻率越高，條紋越密集。

- **原始影像的硬體缺陷**：在尚未開啟任何軟體校正前，直接擷取的原始影像（Raw Image）呈現出極為嚴重的光學瑕疵。如理論所述，由於 Raspberry Pi

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Camera 邊緣微透鏡的 CRA 嚴重不匹配，整個畫面四周被巨大的黑色暗角（Vignetting）吞噬。同時，受限於無塵等級較低的自造環境，感測器表面附著了數顆微小的灰塵（Dust Particles），在影像中形成了明顯的黑色斑塊。

- **演算法校正後的影像重現**：當我們啟動第三章所開發的「空間增益矩陣平場校正（Gain Map Flat-field Correction）」後，影像發生了戲劇性的變化。演算法利用預先拍攝的空白明場增益矩陣，將畫面邊緣衰減的亮度以數學乘法完美補償。校正後的影像不僅恢復了均勻的純白背景，原先肉眼可見的灰塵斑塊也因為除法效應（被白場基準影像相除）而幾乎被完全抹除。更重要的是，位於畫面中央的 NBS 1952 條紋細節依然保持著極高的銳利度，證明該平場校正演算法在消除暗角的同時，並未損及高頻空間解析度。

4.2 高難度螢光色彩保真度測試

螢光成像是本系統最具挑戰性的應用場景，因為螢光訊號極為微弱，且極易受到色彩串擾（Color Crosstalk）的破壞。

4.2.1 15 µm 黃綠色螢光微球 (FluoSpheres) 測試

為了量化色彩校正的效能，我們使用了濃度為 1.0×10^6 beads/mL，直徑為 $15\mu m$ 的標準黃綠色螢光微球（FluoSpheres）作為觀測標的。該微球在特定波長激發下，會發射出極度純粹的綠色螢光。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.2.1.1 未校正前的色彩漂移現象 (Color Shift)

在使用單一的全球色彩校正矩陣（Global CCM）或完全未校正的情況下，實驗影像顯示出令人挫折的結果。視野中心的微球雖然呈現綠色，但其飽和度極低，整體呈現一種蒼白（Whitish）的死灰感。更嚴重的是，位於畫面邊緣的微球，由於 CRA 錯位導致綠光光子大量溢出到了紅色與藍色像素中，使得邊緣的微球在畫面上竟然呈現出詭異的紫色或混濁的黃色。這種「空間不均勻」的色彩失真，對於任何需要量化螢光強度的生物實驗都是不可接受的。

4.2.1.2 張量解混 (Tensor Unmixing) 後的重生

當我們啟動以 `np.einsum` 驅動的「空間變異張量色彩解混（Tensor Color Unmixing）」演算法後，系統針對每一個 $X-Y$ 座標的像素，套用了專屬於該位置的 3×3 反矩陣。校正結果令人驚艷：

1. **飽和度完全恢復**：原本蒼白的微球，其 RGB 直方圖中的綠色通道（G Channel）數值大幅躍升，紅色與藍色通道的雜散訊號被數學矩陣強制壓制，微球重新展現出極度飽滿且明亮的黃綠色。

2. **絕對的空間均一性**：無論微球位於畫面的正中央，還是最邊緣的角落，其色彩呈現出完全一致的純度。張量校正成功補償了鏡頭視角造成的非線性物理扭曲，使這套百元級別的消費硬體，產出了足以媲美數十萬級別科學相機的色彩保真度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.3 大行程高速自動對焦效能剖析

最後一項關鍵指標，是系統在進行高通量大面積掃描時的自動對焦能力。我們使用厚度不一的植物細胞切片進行了極限測試。

4.3.1 14 秒鎖定焦點：三重指標的接力賽

在其中一次極端測試中，我們刻意將物鏡初始位置設定在距離真實焦平面極遠的地方。總搜尋行程長達 $937.5\mu m$。在如此長的距離下，肉眼從螢幕上只能看見一片模糊的灰色背景，完全沒有任何可辨識的結構。

我們的「多階段動態對焦狀態機」完美展示了其強大的邏輯：

- **起步階段（0-5 秒）**：演算法啟動「全域變異數（Global Variance）」。馬達以驚人的 $100\mu m$ 大步長狂飆。儘管畫面依舊模糊，但變異數分數呈現出穩定上升的單調趨勢，指引馬達正確的方向。
- **逼近階段（5-10 秒）**：當距離焦點剩下約 $100\mu m$ 時，變異數的上升趨勢開始減緩（進入平緩的山頂）。演算法毫不猶豫地切換為「空間頻率（Spatial Frequency）」與 $25\mu m$ 中步長。此時畫面上開始浮現出細胞壁的模糊輪廓，分數曲線開始陡峭上升。
- **死鎖階段（10-14 秒）**：進入最後的 $20\mu m$ 決戰區。演算法切換為終極的 Tenengrad 梯度，步長縮減至極限的 $1\mu m$ 到 $3\mu m$。分數在此時如針尖般爆發性衝頂。
- **峰值回溯**：馬達因慣性輕微跨越最高點（Overshoot），分數瞬間跌破 80%。系統立刻觸發「尋峰回溯」機制，反轉馬達並以單一微步（$0.625\mu m$）慢慢

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

倒退，直到分數回升至最高點的 98% 以上，系統宣告”FINISHED”。

整個涵蓋近一毫米的深谷搜尋過程，僅耗時 **14 秒**。期間沒有發生任何因為塑膠機構潛變造成的震盪（Oscillation），也沒有因為背隙問題導致的迷航。高剛性樂高龍門與智慧演算法的結合，證實了本系統已具備投入真實高通量活細胞自動掃描實驗的強大潛力。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第五章　論文研究進度表與具體里程碑

本研究預計於 2025 年 10 月正式啟動，並規劃於 2026 年 7 月（即碩士班畢業前）完成所有硬體組裝、演算法開發、生物實驗驗證以及論文定稿。為確保專案能在時限內達成既定之高標準，我們將這 10 個月的開發期劃分為六大核心里程碑（Milestones），各階段之具體工作項目與預定時程如表 5.1 所示。

5.1　核心里程碑詳細規劃

5.1.1　第一階段：文獻回顧與硬體底層架構設計 (2025 年 10 月-11 月)

- **理論奠基**：全面梳理包含 OpenFlexure、UC2 等開源硬體的設計圖紙，並深入研讀圖案化照明傅立葉疊層成像 (piFP) 的核心數學論文，確認相位復原演算法的疊代邏輯。
- **樂高機架設計**：完成 X-Y-Z 三軸龍門式（Gantry-style）樂高機構的 CAD 建模與實體拼裝。確保 NEMA 17 馬達與導螺桿能完美嵌入樂高的 8.0 mm 幾何網格中。
- **光學元件轉接件列印**：設計並以 3D 列印機印製 Raspberry Pi Camera 與顯微物鏡的有限共軛套筒，確保兩者光軸的絕對同心度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

5.1.2 第二階段：光學系統校正與機電整合測試 (2025 年 11 月-12 月)

- **馬達驅動調試**：將 Arduino Uno 與 CNC Shield V3 連線，啟動 A4988 晶片的 16 倍微步進（Microstepping）模式，並撰寫 Python 腳本驗證 Z 軸 $0.625\mu m$ 定位精度的可靠性。

- **光源同步控制**：完成明視野 (BF) 與螢光 (Fluo) 雙路 LED 的 GPIO 繼電器接線，確保相機快門能與光源切換達到毫秒級別的同步。

5.1.3 第三階段：自動對焦與空間張量色彩解混開發 (2025 年 12 月-2026 年 2 月)

此階段為軟體工程的核心期：

- **狀態機開發**：在 PySide6 多執行緒架構下，實作 `CameraWorker` 的非同步影像擷取。

- **防呆對焦演算法**：利用 Python 完成 Variance、Spatial Frequency、Tenengrad 數學指標的編寫，並實作「盲區偵測」與「尋峰回溯（Peak Recovery）」之狀態機迴圈。針對螢光模式，特別開發基於「形態學開運算 + Top 0.1% 梯度」的抗噪模組。

- **張量解混矩陣建構**：拍攝大量白場與螢光基準圖，建立並訓練 $1640 \times 1232 \times 3 \times 3$ 的四維空間變異色彩解混張量（Unmixing Tensor）。隨後將愛因斯坦求和（`np.einsum`）寫入即時串流管線中，並進行效能壓測（Stress Test）以確保高 FPS。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

5.1.4 第四階段：圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 實作 (2026 年 1 月-3 月)

- **擴散片波前調控模組**：在載台下方新增一個微型馬達，用以驅動擴散片產生二維空間的隨機位移，以產生高頻圖案照明。
- **疊代相位復原演算法**：將擷取到的多張混疊（Aliased）低頻影像匯入電腦。撰寫正反傅立葉轉換（FFT/IFFT）疊代迴圈，同步更新擴散片的傳輸函數與樣本波前，嘗試重建出超越物鏡 NA 限制的超解析度影像。

5.1.5 第五階段：系統嚴苛驗證與活體生物樣本測試 (2026 年 3 月-5 月)

- **標準化驗證**：使用 NBS 1952 測試板與 15 µm FluoSpheres 標準螢光微球，量化分析平場校正消除暗角的能力，以及張量解混恢復螢光飽和度的精確度。
- **大面積活體掃描**：導入真實的生物樣本（例如擬南芥葉片切片或培養皿中的 HeLa 細胞）。啟動全自動 Z-Stack 深度掃描與 X-Y 網格拼接協定（Grid Stitching Protocol），驗證系統在數小時連續運作下的穩定性與防漂移能力。

5.1.6 第六階段：數據統整與論文定稿 (2026 年 5 月-7 月)

- **量化分析與作圖**：將實驗過程中的所有對焦曲線、光譜直方圖匯出並以 Python Matplotlib 繪製成學術圖表。
- **論文撰寫與口試準備**：完成第一至第五章的所有內文修訂，並於 2026 年 7 月 15 日前完成學位論文口試。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

表 5.1: 預定研究進度甘特圖 (2025 年 10 月至 2026 年 7 月)

預定時程 / 工作項目	2025			2026						
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
文獻回顧與硬體底層架構設計	■	■								
光學系統校正與機電整合測試		■	■							
自動對焦與色彩解混演算法開發			■	■	■					
圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 實作				■	■	■				
系統嚴苛驗證與活體生物樣本測試						■	■	■		
數據統整、綜合評估與分析								■	■	
論文撰寫、修改與定稿準備口試									■	■

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

參考文獻

[1] Richard Bowman et al. Flat-field and colour correction for the raspberry pi camera module. arXiv preprint arXiv:1911.13295, 2019.

[2] Joel T Collins et al. Robotic microscopy for everyone: the openflexure microscope. Biomedical Optics Express, 11(5):2447–2460, 2020.

[3] Benedict Diederich et al. A versatile and customizable low-cost 3d-printed open standard for microscopic imaging. Nature communications, 11(1):5979, 2020.

[4] Siyuan Dong et al. High-resolution fluorescence imaging via pattern-illuminated fourier ptychography. Optics express, 22(17):20856–20870, 2014.

[5] Xiaoliang He et al. Fourier ptychography via wavefront modulation with a diffuser. Optics Communications, 459:125057, 2020.

[6] George OT Merces et al. The incubot: A 3d printer-based microscope for long-term live cell imaging within a tissue culture incubator. HardwareX, 9:e00189, 2021.

[7] OpenFlexure Project. Delta stage geometry notes, 2023. URL https://build.openflexure.org/openflexure-delta-stage/v1.2.3/pages/stage_geometry_notes.html. Accessed: 2026-04-30.

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

[8] Guoan Zheng, Roel Horstmeyer, and Changhuei Yang. Wide-field, high-resolution fourier ptychographic microscopy. Nature photonics, 7(9):739–745, 2013.

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 A — Introduction

A.1 Introduction

A.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 B — Introduction

B.1 Introduction

B.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX