

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Năm học 2026 — 2027

Dò phức bộ QRS thai nhi từ điện tim ổ bụng đơn  
kênh có nhận biết độ tin cậy

Đổi chuẩn không rò rỉ giữa các họ biểu diễn tín hiệu  
và chỉ số chất lượng dựa trên đồng điều bền vững

*Reliability-aware single-channel fetal QRS detection:  
a leakage-free representation benchmark and a persistent-homology signal-quality index*

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên hệ thống     | RELYFETAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chủ nhiệm đề tài | Ngô Bình Minh                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nhóm thực hiện   | 03 sinh viên                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thời lượng       | 24 tuần                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phiên bản        | 3.5 — 12/09/2026 (vòng 7)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mục tiêu công bố | 01 tạp chí: <i>IEEE JBHI</i> hoặc <i>Biomed. Signal Process. Control</i> (Q1 Scimago) nếu có bộ dữ liệu thứ ba có nhãn; nếu không, <i>Physiological Measurement</i> (Q2/Q3 Scimago 2024, không phải Q1)<br>01 hội nghị <i>Computing in Cardiology</i><br>01 báo cáo Euréka |

Điểm khác biệt của bản đề cương này

Đây không phải một bản kế hoạch thuần lý thuyết. Trước khi viết, nhóm đã chạy hơn 600.000 cửa sổ tín hiệu, huấn luyện và lưu hơn hai mươi mô hình, đọc toàn văn 30 công trình, và **tự bác bỏ giả thuyết trung tâm của chính bản đề cương phiên bản đầu tiên**. Mọi con số trong tài liệu này đều do nhóm tự đo, có mã nguồn và nhật ký kèm theo, và chạy lại được. Những chỗ nhóm còn chưa chắc chắn được ghi rõ trong §12.

**Bản 3.5 (vòng 7) rút thêm:** mọi con số CinC 2013 tính trên **75 bản ghi** (71,21 / 79,40 / 86,87 / 85,60 / +8,18 / +7,47...) — 15 bản set-a là bản sao nguyên văn của 5 bản ADFECGDB dùng huấn luyện. **Điều này ban tổ chức đã ghi nhận từ 2013** (Silva 2013, Bảng 1; Clifford 2014, Bảng 2 và lời cảnh báo về Rodrigues), câu cảnh báo đó nằm ngay trong ghi chú đọc bài của nhóm (p20) mà nhóm bỏ sót; nhóm chỉ xác định bằng

đo lường đúng 15 bản nào và mức thời phòng 3,27–7,18 điểm. Số đúng: **74,28** (PSD mù nhãn, 22 ca) trên **60 bản sạch**; quy tắc peakprob 82,01 là giả thuyết hậu kiểm. Cũng rút: “mô hình không phải nút thắt” (phép thử nhìn thấy có âm tính giả 18%), “Physiological Measurement là Q1” (Scimago 2024: Q2/Q3). Chi tiết ở hộp đầu §5.10.3.

**Năm phát biểu đã bị rút công khai ở bản 3.4.** Bốn của bản 3.2: (i) con số CinC 2013 đo trên **mẫu 10 bản ghi** của một tập có 75 — bản 3.4 thay bằng 79,40 trên 75 bản, nay cũng đã rút, xem trên (§5.10.3); (ii) “Power-MF không chạy lại được” — sai, đã chạy (§5.7); (iii) mọi trị số  $p$  trên 5 sản phụ là giả lập và đã bị gỡ, “8 kiến trúc không phân biệt được” đổi thành “không đủ lực để phân biệt” (§10); (iv) hệ thống **chưa** dùng được làm máy đo biến thiên ngắn hạn (§9).

**Và một của chính bản 3.3, rút chiều 12/09:** con số Power-MF 94,87 cùng kết luận “loại hai bản ghi bắt cách nhịp thì còn 98,38 so với 97,33” **đều sai**. Cả hai đứng trên một bản Octave hồng vì *lỗi công chuyển của chính nhóm* (findpeaks tốn  $O(k^2)$  bộ nhớ), không phải vì tham số 340 ms như nhóm đã đoán — giả thuyết đó bị bác bỏ bằng số đo: 0,00 % khoảng RR dưới 340 ms. Sau khi vá, Power-MF đa kênh đạt **98,83** và tái lập số công bố của tác giả đến 0,06 điểm (§5.7). Hai lần đoán sai nguyên nhân trong cùng một ngày được phân tích ở §12.2.

Thành phố Hồ Chí Minh — Tháng 9 năm 2026

# Mục lục

|          |                                                                                              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tóm tắt</b>                                                                               | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Đặt vấn đề</b>                                                                            | <b>4</b>  |
| 2.1      | Bối cảnh lâm sàng . . . . .                                                                  | 4         |
| 2.2      | Vì sao đơn kênh khó . . . . .                                                                | 4         |
| 2.3      | Ba khoảng trống trong y văn . . . . .                                                        | 5         |
| 2.4      | Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết . . . . .                                                   | 6         |
| <b>3</b> | <b>Nhóm đã đọc gì và so với ai</b>                                                           | <b>8</b>  |
| 3.1      | Cách nhóm chọn và đọc . . . . .                                                              | 8         |
| 3.2      | Kết quả tổng hợp . . . . .                                                                   | 8         |
| 3.3      | Đối thủ mạnh nhất mà nhóm phải nêu . . . . .                                                 | 23        |
| 3.4      | Năm công trình bổ sung trong vòng rà soát thứ ba, và điều chúng buộc nhóm phải sửa . . . . . | 24        |
| 3.5      | Nhóm học được gì từ từng công trình . . . . .                                                | 26        |
| 3.6      | Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện . . . . .                                           | 36        |
| <b>4</b> | <b>Mô hình của nhóm và lý do chọn</b>                                                        | <b>45</b> |
| 4.1      | Toàn cảnh pipeline . . . . .                                                                 | 45        |
| 4.2      | Mô hình: FETALQRS-TCN . . . . .                                                              | 46        |
| 4.3      | Vì sao chọn mô hình này, và vì sao đây không phải bắt chước . . . . .                        | 46        |
| <b>5</b> | <b>Kết quả tiền khả thi đã đo</b>                                                            | <b>51</b> |
| 5.1      | Thiết lập . . . . .                                                                          | 51        |
| 5.2      | Phân rã đóng góp ba tầng . . . . .                                                           | 51        |
| 5.2.1    | Lập lại khảo sát dải lọc trên chính TCN — kết quả sơ bộ . . . . .                            | 53        |
| 5.3      | Quy tắc chọn kênh mù nhãn . . . . .                                                          | 55        |
| 5.4      | Kết quả cuối trên ADFECGDB . . . . .                                                         | 57        |
| 5.5      | Nơi hệ thống sụp đổ . . . . .                                                                | 57        |
| 5.6      | Baseline cổ điển tự cài lại . . . . .                                                        | 58        |
| 5.7      | Đối chuẩn với Power-MF chạy lại . . . . .                                                    | 59        |
| 5.7.1    | Bài học phương pháp: nhóm đã phát biểu nguyên nhân trước khi đo . . . . .                    | 60        |
| 5.7.2    | Bản vá P7 và cách nó tái lập ngữ nghĩa MATLAB . . . . .                                      | 60        |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.7.3    | Ba cột: Power-MF đa kênh, Power-MF đơn kênh, và RELYFETAL . . . . .       | 61        |
| 5.7.4    | Thống kê mức chủ thể: ba phép so sánh trên bốn tập con . . . . .          | 63        |
| 5.7.5    | Ba bản ghi kéo tụt trung bình — và vì sao phải báo cáo cả trung vị . . .  | 65        |
| 5.7.6    | Luận đề đúng của đề tài: lấy lại 89,5 % lợi ích của đa kênh bằng một kênh | 66        |
| 5.7.7    | Ý nghĩa với định vị của cả đề tài . . . . .                               | 67        |
| 5.8      | Mở rộng sang 22 sản phụ và sang thai kỳ . . . . .                         | 67        |
| 5.8.1    | Kiểm tra rò rỉ trước khi đánh giá . . . . .                               | 68        |
| 5.8.2    | Kết quả . . . . .                                                         | 68        |
| 5.8.3    | Đọc kết quả . . . . .                                                     | 69        |
| 5.9      | Độ bền với nhiễu: đường cong F1–SNR . . . . .                             | 70        |
| 5.10     | Huấn luyện lại trên 22 sản phụ . . . . .                                  | 71        |
| 5.10.1   | Giao thức . . . . .                                                       | 72        |
| 5.10.2   | Kết quả trên 22 chủ thể . . . . .                                         | 72        |
| 5.10.3   | PhysioNet/CinC 2013: 60 bản ghi sạch, không phải 75 . . . . .             | 73        |
| 5.10.4   | Vì sao mẫu 10 bản ghi bị lệch, và lệch theo hai hướng . . . . .           | 76        |
| 5.10.5   | Điều 75 bản ghi nói mà 10 bản ghi không nói được . . . . .                | 77        |
| 5.10.6   | Đường cong hiệu quả mẫu . . . . .                                         | 77        |
| 5.10.7   | Giới hạn . . . . .                                                        | 78        |
| <b>6</b> | <b>Đôi chuẩn và kiểm chứng độc lập</b>                                    | <b>80</b> |
| 6.1      | Kết quả chạy đúng giao thức được đề nghị . . . . .                        | 80        |
| 6.2      | Kiểm chứng các con số tham chiếu . . . . .                                | 80        |
| 6.3      | Hai lỗi kỹ thuật trong mã đánh giá . . . . .                              | 81        |
| <b>7</b> | <b>Đóng góp C3 sau khi chạy prototype</b>                                 | <b>83</b> |
| 7.1      | Thiết kế thí nghiệm . . . . .                                             | 83        |
| 7.2      | Kết quả . . . . .                                                         | 84        |
| 7.3      | Đọc kết quả . . . . .                                                     | 85        |
| 7.4      | Vì sao topo thất bại ở đây . . . . .                                      | 86        |
| 7.5      | Giới hạn của thí nghiệm này . . . . .                                     | 87        |
| <b>8</b> | <b>Bản demo và đèn tin cậy</b>                                            | <b>88</b> |
| 8.1      | Bố cục . . . . .                                                          | 88        |
| 8.2      | Đèn tin cậy . . . . .                                                     | 90        |
| 8.3      | Đèn học được: thay luật cứng bằng bộ phân loại . . . . .                  | 92        |

|           |                                                                        |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.4       | Giao diện lập trình và đóng gói . . . . .                              | 93         |
| 8.5       | Kịch bản trình bày ba phút . . . . .                                   | 93         |
| <b>9</b>  | <b>Chỉ số lâm sàng: hệ thống này dùng được đến đâu ở giường bệnh</b>   | <b>94</b>  |
| 9.1       | Giao thức, khai báo trước khi chạy . . . . .                           | 94         |
| 9.2       | Biến thiên ngắn hạn kiểu Dawes–Redman . . . . .                        | 95         |
| 9.3       | Nhịp tim thai — đây là chỗ hệ thống thật sự dùng được . . . . .        | 97         |
| 9.4       | Độ phủ theo THỜI LƯỢNG, không theo bản ghi . . . . .                   | 98         |
| 9.5       | Khoá nhằm nhịp mẹ — chế độ hồng nguy hiểm nhất . . . . .               | 99         |
| 9.6       | Chọn kênh sửa được F1, nhưng không sửa được STV . . . . .              | 101        |
| 9.7       | Những gì mục này KHÔNG chứng minh được . . . . .                       | 101        |
| <b>10</b> | <b>Kiểm định lại toàn bộ thống kê ở mức chủ thể</b>                    | <b>103</b> |
| 10.1      | Lỗi đã sửa . . . . .                                                   | 103        |
| 10.2      | Bảng tổng hợp: mọi so sánh chính, tính lại ở mức chủ thể . . . . .     | 104        |
| 10.3      | Khoảng tin cậy cho các con số đặt trên tiêu đề . . . . .               | 105        |
| 10.4      | Họ kiến trúc: kiểm định tương đương (TOST), biên 1,0 điểm F1 . . . . . | 106        |
| 10.5      | Cổng từ chối: AUROC trong bản ghi mới là con số lâm sàng . . . . .     | 107        |
| 10.6      | Độ ổn định theo seed . . . . .                                         | 107        |
| 10.7      | Những gì KHÔNG kiểm chứng lại được từ artefact hiện có . . . . .       | 108        |
| 10.8      | Nguyên tắc chung cho mọi con số từ đây . . . . .                       | 109        |
| <b>11</b> | <b>Khảo sát ý tưởng hệ thống nhiều mô hình</b>                         | <b>110</b> |
| 11.1      | Nhận xét đầu tiên: pipeline hiện tại đã là hệ dị thể . . . . .         | 110        |
| 11.2      | Phân rã bảy nhiệm vụ con và mô hình tối ưu cho từng nhiệm vụ . . . . . | 110        |
| 11.3      | Y văn nói gì về hướng nhiều mô hình . . . . .                          | 111        |
| 11.4      | Còn bao nhiêu dư địa để cải tiến . . . . .                             | 111        |
| 11.5      | Rủi ro và khuyến nghị . . . . .                                        | 112        |
| <b>12</b> | <b>Những chỗ đề tài còn yếu</b>                                        | <b>113</b> |
| 12.1      | Đánh giá thẳng thắn ba đóng góp . . . . .                              | 115        |
| 12.2      | Nhóm đã đoán sai nguyên nhân hai lần trong một ngày . . . . .          | 116        |
| 12.2.1    | Lần một — “Power-MF hồng vì tham số 340 ms quá sát” . . . . .          | 116        |
| 12.2.2    | Lần hai — “quy tắc kênh 0 cố định tốt hơn quy tắc PSD” . . . . .       | 116        |
| 12.3      | Kiến trúc nhóm đã cân nhắc và loại . . . . .                           | 118        |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>13 Kế hoạch triển khai 24 tuần</b>            | <b>119</b> |
| 13.1 Mười hai giai đoạn . . . . .                | 119        |
| 13.2 Phân vai ba sinh viên . . . . .             | 120        |
| <b>14 Sản phẩm và công bố</b>                    | <b>121</b> |
| 14.1 Sản phẩm bàn giao . . . . .                 | 121        |
| 14.2 Kế hoạch công bố . . . . .                  | 121        |
| <b>15 Tài liệu tham khảo</b>                     | <b>123</b> |
| <b>Phụ lục A — Cách chạy lại toàn bộ kết quả</b> | <b>128</b> |
| <b>Phụ lục B — Cấu trúc thư mục bàn giao</b>     | <b>128</b> |

## Danh sách bảng

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Hai phương pháp theo dõi tim thai hiện hành và giới hạn của chúng. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| 2  | Các khó khăn của cấu hình đơn kênh, kèm hệ quả định lượng nhóm đo được trên ADFECGDB. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| 3  | Sáu câu hỏi nghiên cứu và thí nghiệm trả lời tương ứng. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |
| 4  | Giả thuyết kiểm định được và tiêu chí chấp nhận. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 5  | Ba mươi công trình nhóm đã đọc toàn văn, xếp theo họ phương pháp. Cột cuối cho biết giao thức đánh giá của bài đó có đối chiếu trực tiếp được với giao thức của nhóm hay không. . . . .                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| 6  | Năm công trình bổ sung và hệ quả với từng tuyên bố của nhóm. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 |
| 7  | Điều nhóm rút ra được từ từng công trình và điều đó đòi gì trong thiết kế của nhóm. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 |
| 8  | Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện khi đọc toàn văn. Đây là cơ sở để nhóm khẳng định các con số công bố trong y văn không so sánh trực tiếp được với nhau. . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 37 |
| 9  | Đặc tả FETALQRS-TCN. Mọi con số đều đo trực tiếp từ mã nguồn và checkpoint, không lấy lại từ tài liệu. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 |
| 10 | Đối chiếu hai hướng tiếp cận trên từng trục thiết kế. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 |
| 11 | Số liệu của hình 3. Một seed, ba epoch. Cột KTC 90% là bootstrap cụm ở <b>mức chủ thể</b> ( $n = 5$ ); cột TOST kiểm định tương đương với biên $\delta = 1,0$ điểm F1 (§10). Các trị số $p$ Wilcoxon của bản 3.2 tính trên 20 cặp (bản ghi $\times$ kênh) là giả lập và đã bị gỡ. . . . .                                                                                                             | 48 |
| 12 | Phân rã đóng góp ba tầng, tính lại ở <b>mức chủ thể</b> . Mọi trị số $p$ của bản 3.2 đã bị gỡ: chúng tính trên 20–60 hàng (bản ghi $\times$ kênh $\times$ seed), tức giả lập. Với $n = 5$ chủ thể, $p < 0,05$ là bất khả thi (§10). . . . .                                                                                                                                                           | 52 |
| 13 | Dải lọc đo trên <b>chính</b> FetalQRS-TCN: 22 chủ thể, 3 nếp gấp tách theo chủ thể, 4 epoch, seed 0, chọn kênh PSD mù nhãn, dung sai $\pm 50$ ms. Nguồn: pilot_evidence/band_tcn.json $\rightarrow$ pilot_evidence/band_tcn_stats.json. Thí nghiệm <b>đã chạy xong cả bốn dải</b> lúc 09:33 ngày 12/09/2026 (137,6 phút); vì mới <b>một seed</b> và 4 epoch nên vẫn là <b>kết quả sơ bộ</b> . . . . . | 54 |
| 14 | So sánh bốn quy tắc chọn kênh, mô hình 5 ca. Cột CinC 2013 đo trên <b>75 bản ghi set-a (đã rút ở bản 3.5</b> — trên 60 bản sạch: PSD 64,04, kênh 0 48,43, oracle 72,76, trung bình 4 kênh 56,00; §5.10.3); cột trong ngoặc là con số cũ trên mẫu 10 bản ghi, giữ lại để thấy mức lệch. . . . .                                                                                                        | 56 |
| 15 | Hiệu năng FETALQRS-TCN, tách theo bản ghi, dung sai $\pm 50$ ms. Mỗi bản ghi được chấm bằng checkpoint chưa từng nhìn thấy bản ghi đó. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 57 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | Ba baseline cổ điển. Siêu tham số của mỗi baseline được chọn <b>chỉ trên r01</b> rồi áp nguyên cho bốn bản ghi còn lại; cột “16 giữ lại” loại r01 khỏi phép tính. . . . .                                                                                                                   | 58 |
| 17 | Kết quả trên ADFECGDB, dung sai $\pm 50$ ms. Hiệu số và khoảng tin cậy tính ở <b>mức chủ thể</b> ( $n = 5$ sản phụ, trung bình 4 kênh trước). Các trị số $p$ của bản 3.2 tính trên 20 cặp (bản ghi $\times$ kênh) là <b>giả lập</b> và đã bị gỡ — xem §10. . . . .                          | 58 |
| 18 | F1 trung bình (%) trên 22 chủ thể, chấm bằng cùng một bộ chấm ( $\pm 50$ ms, ghép tham lam 1–1). Nguồn: baselines/powermf_fair_stats.json và baselines/powermf_1ch.json. Hai cột giữa là <b>cùng một thuật toán</b> , chỉ khác số đạo trình được dùng. . . . .                              | 62 |
| 19 | F1 từng chủ thể (%). Cột RELYFETAL là mô hình 22 ca, đánh giá bỏ-một-chủ-thể. Ba hàng in đậm là ba bản ghi RELYFETAL thua nặng. . . . .                                                                                                                                                     | 63 |
| 20 | Toàn bộ so sánh mức chủ thể. Hiệu số dương nghĩa là phương pháp bên trái cao hơn. T/H/Th = thắng/hòa/thua theo chủ thể. Nguồn: baselines/powermf_fair_stats.json. . . . .                                                                                                                   | 64 |
| 21 | Ba chủ thể RELYFETAL thua Power-MF đa kênh quá 9 điểm. Mọi chủ thể còn lại đều thắng, trừ B1_10 thua nhẹ. . . . .                                                                                                                                                                           | 65 |
| 22 | Kết quả kiểm tra rò rỉ. NCC là tương quan chéo chuẩn hoá cực đại. Cột “hạng nhì” là NCC với bản ghi B2 gần nhất còn lại, để thấy khoảng cách. . . . .                                                                                                                                       | 68 |
| 23 | Cùng một mô hình, cùng giao thức $\pm 50$ ms, trên năm cấu hình dữ liệu. “ $\geq 90$ ” và “ $< 50$ ” là số bản ghi có F1 (kênh PSD) trong khoảng đó. . . . .                                                                                                                                | 68 |
| 24 | Silesia B1 — thai kỳ, từng bản ghi. Mô hình chưa từng thấy bất kỳ dữ liệu thai kỳ nào. Cột “oracle” là kênh tốt nhất theo nhãn, chỉ để tham chiếu. . . . .                                                                                                                                  | 69 |
| 25 | Macro F1 (5 bản ghi $\times$ 4 kênh) theo SNR. Không nhiều: mô hình 97,45, TS-PCA 91,05. . . . .                                                                                                                                                                                            | 71 |
| 26 | Mô hình 5 ca so với mô hình 22 ca trên cùng chủ thể và cùng kênh. Hiệu số và khoảng tin cậy tính ở <b>mức chủ thể</b> (trung bình 4 kênh trước). Cột $p$ là Wilcoxon ghép cặp <b>trên chủ thể</b> , khác hẳn các trị số $p$ trên cặp (bản ghi $\times$ kênh) của bản 3.2 — xem §10. . . . . | 72 |
| 27 | PhysioNet/CinC 2013 set-a, zero-shot, toàn bộ 75 bản ghi. Hiệu số là mô hình 22 ca trừ mô hình 5 ca; KTC 95% bootstrap 10.000 lần, seed 0. Hàng in đậm là <b>số chính</b> : quy tắc chọn kênh mù nhãn theo mật độ phổ công suất. . . . .                                                    | 75 |
| 28 | Hình dạng phân bố trên 75 bản ghi, quy tắc PSD mù nhãn. Đây mới là thông tin lâm sàng, không phải trung bình. . . . .                                                                                                                                                                       | 75 |
| 29 | Cùng mô hình 22 ca, cùng checkpoint, cùng bộ chấm — chỉ đổi <b>số bản ghi được tính</b> . <b>Cả hai con số ở cột “mẫu 10 bản ghi” (69,31 và 90,34) đều ĐÃ BỊ RÚT</b> và chỉ giữ lại ở đây để đối chiếu với con số đúng trên toàn bộ 75 bản ghi. . . . .                                     | 76 |
| 30 | Hiệu quả mẫu trên ADFECGDB, 6 epoch, dung sai $\pm 50$ ms. . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 78 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 31 | Kiểm chứng từng tuyên bố về “kết quả đã công bố của DPSS”. Nguồn: Shokouhmand & Tavassolian, <i>IEEE Trans. Biomed. Eng.</i> 70(1):283–295, 2023, DOI 10.1109/TBME.2022.3189617. . . . .                                                                                                         | 81 |
| 32 | Đổi chuẩn sau khi đã sửa các con số tham chiếu. Đây là bảng nhóm sẽ dùng trong bài báo. . . . .                                                                                                                                                                                                  | 82 |
| 33 | Hai nhóm đặc trưng được so sánh. Mọi đặc trưng tính trên tín hiệu dư sau khử mẹ, 250 Hz, đoạn 4 giây, chuẩn hoá robust. Mã tại <code>fsqi/fsqi.py</code> . . . . .                                                                                                                               | 83 |
| 34 | Dự báo đoạn lỗi trên CinC 2013 (ngoài miền), bộ phân loại huấn luyện trên ADFECGDB. Cột cuối: macro F1 của các đoạn được giữ lại sau khi từ chối 20% đoạn kém tin cậy nhất. . . . .                                                                                                              | 84 |
| 35 | Bốn dấu hiệu của đèn tín cây phiên bản luật cứng. Trọng số cộng lại thành điểm 0–1; xanh nếu $\geq 0,75$ , vàng nếu $\geq 0,45$ , đỏ nếu thấp hơn. Có một luật ghi đề: nếu hơn 60% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ thì đèn đỏ bất kể điểm, vì đó là dấu hiệu bộ dò đang bám nhầm vào tim mẹ. . . . . | 91 |
| 36 | Đèn tín cây chấm trên 15 bản ghi có nhãn, kênh chọn tự động. ADFECGDB dùng checkpoint chưa thấy bản ghi; CinC 2013 dùng checkpoint production, zero-shot. . . . .                                                                                                                                | 91 |
| 37 | Tổng hợp theo màu đèn. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 |
| 38 | Hai chế độ đèn trên 32 bản ghi. “Nguy hiểm” là xanh nhưng $F1 < 90$ ; “thận trọng” là đỏ nhưng $F1 \geq 95$ . . . . .                                                                                                                                                                            | 92 |
| 39 | Kịch bản demo. Phút cuối là phần quan trọng nhất. . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 93 |
| 40 | STV nhãn so với STV mô hình. LoA là giới hạn đồng thuận Bland–Altman 95%. . . . .                                                                                                                                                                                                                | 95 |
| 41 | Sai số STV bám rất sát chất lượng dò nhịp. Đơn vị ms. . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 95 |
| 42 | Bảng quyết định ở ngưỡng lâm sàng TRUFFLE. . . . .                                                                                                                                                                                                                                               | 95 |
| 43 | Tập con hợp lệ nhất, và tại sao vẫn chưa đủ. . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 96 |
| 44 | Bland–Altman nhịp tim thai, cửa sổ 1 phút. Mẫu số là số cửa sổ nhãn hợp lệ; 260/260 cửa sổ đều ghép cặp được, không cửa sổ nào bị loại vì mô hình không tính nổi. . . . .                                                                                                                        | 97 |
| 45 | Quét độ dài cửa sổ. Bài DPSS không nêu độ dài cửa sổ dùng cho “FHR precision 88,61 %”; cửa sổ càng dài càng dễ, nên nhóm quét cả dài. Giá trị là % cửa sổ trong $\pm 5$ bpm. . . . .                                                                                                             | 97 |
| 46 | Độ phủ theo thời lượng và — quan trọng hơn — độ dài khoảng trống liên tục. . . . .                                                                                                                                                                                                               | 98 |
| 47 | Đối chiếu với chuẩn lâm sàng. <b>Các mốc CTG dưới đây do phản biện cung cấp và nhóm CHƯA đối chiếu bản gốc</b> — phải kiểm chứng trước khi đưa vào bài báo. . . . .                                                                                                                              | 98 |
| 48 | Cổng từ chối có phân tầng đúng không. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | 99 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 49 | Khoá nhịp mẹ, so với chính nhãn chuẩn của từng bản ghi. . . . .                                                                                                                                                                             | 99  |
| 50 | Hai bản ghi khoá nhằm nhịp mẹ. . . . .                                                                                                                                                                                                      | 100 |
| 51 | Bốn bản ghi CinC 2013 kém nhất: quy tắc PSD mù nhãn so với kênh 0 hậu kiểm.<br>STV tính bằng ms. . . . .                                                                                                                                    | 101 |
| 52 | Sáu thay đổi phương pháp. . . . .                                                                                                                                                                                                           | 103 |
| 53 | Quy ước hiệu số: $A - B$ với $A$ là đối tượng đứng đầu trong tên so sánh. Cột<br>“KTC 95% $t$ ” bảo thủ hơn; khi hai cột mâu thuẫn thì tin cột $t$ . . . . .                                                                                | 104 |
| 54 | Cột “KTC 95% $t$ trên %” là cột <b>đang có lỗi</b> trong các bản trước: nó <b>vượt 100%</b> .<br>Cột in đậm là cột phải dùng trong bảng kết quả chính. . . . .                                                                              | 105 |
| 55 | TOST với biên tương đương $\delta = 1,0$ điểm F1, $n = 5$ chủ thể, hiệu chỉnh Holm<br>cho họ 7 so sánh. . . . .                                                                                                                             | 106 |
| 56 | Cluster bootstrap theo <b>bản ghi</b> ( $n = 10$ cụm), không theo đoạn. . . . .                                                                                                                                                             | 107 |
| 57 | So sánh seed 0 với seed 1 trên 20 chủ thể chung, kênh PSD mù nhãn. . . . .                                                                                                                                                                  | 108 |
| 58 | Ba mục nhóm không thể tự kiểm chứng lại, và hệ quả. . . . .                                                                                                                                                                                 | 108 |
| 59 | Bảy nhiệm vụ con của bài toán và mô hình tối ưu theo bằng chứng từ y văn cùng<br>số đo của nhóm. . . . .                                                                                                                                    | 110 |
| 60 | Tiền lệ hợp nhất và nổi tăng trong y văn, kèm mức lợi ích công bố. . . . .                                                                                                                                                                  | 111 |
| 61 | Các điểm yếu nhóm tự xác định, mức nghiêm trọng và cách xử lý. . . . .                                                                                                                                                                      | 114 |
| 62 | Bốn quy tắc chọn kênh, mô hình 22 ca, trên mẫu 10 bản ghi so với toàn bộ 75<br>bản ghi. <b>Cột “mẫu 10 bản ghi” (69,31 và 90,34) là các con số ĐÃ BỊ RÚT</b> ,<br>giữ lại chỉ để đối chiếu. Nguồn: benchmark_dpss/eval_cinc75.json. . . . . | 117 |
| 63 | Các họ kiến trúc mới được cân nhắc và lý do loại. . . . .                                                                                                                                                                                   | 118 |
| 64 | Kế hoạch 12 giai đoạn trong 24 tuần, kèm hai cổng quyết định. . . . .                                                                                                                                                                       | 119 |
| 65 | Phân vai và trách nhiệm chính. . . . .                                                                                                                                                                                                      | 120 |
| 66 | Danh mục sản phẩm, kèm trạng thái hiện tại. . . . .                                                                                                                                                                                         | 121 |

## Danh sách hình vẽ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Pipeline RELYFETAL. Khối màu xanh lá là mạng học sâu. Các khối viền đỏ nét<br>đứt là nhánh độ tin cậy (đóng góp C3). Prototype của nhánh này đã chạy: phần<br><i>cổng từ chối</i> có tác dụng và đã vào demo; phần <i>đồng điều bền vững</i> cho kết quả<br>phủ định và được rút lại (§7). . . . . | 45 |
| 2 | Mười sáu kiến trúc, cùng dữ liệu và cùng ngân sách tham số. Persistence Image<br>kết hợp CNN 2D đứng cuối bảng. . . . .                                                                                                                                                                            | 47 |

- 3 Tám kiến trúc dưới giao thức trung thực. Hiệu số so với `cnr_dil` nằm trong khoảng  $-2,95$  đến  $+0,73$  điểm; với  $n = 5$  chủ thể nghiên cứu này **không đủ lực** để kết luận chúng tương đương (§10). Đường đứt xanh là mô hình chính (ngữ cảnh 4 giây, đầu ra từng mẫu) — cách xa cả nhóm. . . . . 48
- 4 Lợi ích của trường tiếp nhận bão hoà quanh 1,5 giây. Nhóm chọn 1.516 ms. . . 49
- 5 Chuỗi cải tiến đo được. Đường chấm đánh dấu chỗ **đổi giao thức** từ 2 sang 4 đạo trình — hai bên đường này không trừ trực tiếp cho nhau được, nên mức tăng  $+11,00$  chỉ tính trong phần bên trái. Nhãn dưới mỗi cột ghi **phạm vi đo**, không ghi trị số  $p$ : mọi  $p$  của bản 3.2 tính trên hàng (bản ghi  $\times$  kênh  $\times$  seed) nên là giả lập và đã bị gỡ (§10). Dòng chú dưới hình ghi kết quả **sơ bộ** khi lặp lại bước  $+11,00$  trên chính TCN (§5.2.1). . . . . 51
- 6 Phân rã đóng góp ba tầng. Trên bộ học cửa sổ 300 ms, front-end tín hiệu vẫn là tầng lớn nhất, và khoảng cách so với tầng ngữ cảnh là 2,4 lần chứ không phải 30 lần như bản đề cương trước phát biểu. Thanh gạch chéo là bản **lặp lại tầng 1 trên chính TCN**: chỉ  $+2,44$  điểm với KTC  $[-0,04; +6,29]$  chạm số không — **kết quả sơ bộ**, xem §5.2.1. . . . . 52
- 7 Khảo sát tám dải thông **trên gradient boosting, cửa sổ 300 ms**, mỗi dải là một lần chạy tách theo bản ghi đầy đủ. Chênh lệch giữa dải tốt nhất và kém nhất là 18,89 điểm F1 — lớn hơn toàn bộ khác biệt giữa 16 kiến trúc học sâu. **Cảnh báo phạm vi**: độ lớn này *không* chuyển sang TCN — xem §5.2.1. . . . . 53
- 8 Dải lọc đo trên chính TCN, cả bốn dải. (A) macro F1 theo quy tắc chọn kênh PSD mù nhãn. (B) hiệu số từng chủ thể giữa 10–60 Hz và 1–45 Hz: 19 trong 22 chủ thể nằm sát số không, toàn bộ hiệu ứng do ba chủ thể tô đỏ tạo ra. Dòng chú dưới hình ghi thêm kết quả trên thang đo **trung bình 4 kênh**, nơi hiệu số bằng không với khoảng hẹp. . . . . 54
- 9 Chuyển sang PhysioNet/CinC 2013 mà không tinh chỉnh, **mẫu 10 bản ghi đầu tiên**. Phân bố **lượng cực**: bốn bản ghi hoàn hảo, ba bản ghi sụp dưới 50. Hình dạng này giữ nguyên trên toàn bộ 75 bản ghi (hình 13A) — ở đó 22/75 bản ghi dưới 50 với mô hình 5 ca. . . . . 57
- 10 (A) F1 từng chủ thể ở ba cấu hình, cùng bộ chấm  $\pm 50$  ms. Ba chủ thể có dấu sao là ba bản ghi RELYFETAL thua nặng — và Power-MF-1ch cũng sụp ở đúng ba chỗ đó. (B) Hiệu số ghép cặp và KTC 95% cluster bootstrap theo tập con, cho cả ba phép so sánh. . . . . 65
- 11 (A) Macro F1 theo SNR, mô hình so với TS-PCA, nhiễu hỗn hợp và trung bình ba loại. (B) Mô hình theo từng loại nhiễu: trôi nền gần như vô hại, nhiễu cơ hại nhất. (C) Quy tắc chọn kênh PSD mù nhãn dưới nhiễu, kèm số bản ghi giữ nguyên kênh đã chọn so với khi không nhiễu. . . . . 70

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | Cùng chủ thể, cùng giao thức, chỉ đổi mô hình. Cột CinC 2013 trong hình vẽ trên <b>75 bản ghi</b> (đã rút ở bản 3.5; số đúng trên 60 bản sạch là 64,04 → 74,28, §5.10.3); bản 3.2 dùng 90,34 — kênh 0 hậu kiểm trên 10 bản ghi, cũng đã rút. Lợi ích tập trung đúng ở hai chỗ yếu: thai kỳ và hệ ghi khác; hai nhóm bên trái có $n$ quá nhỏ để kết luận. . . . . | 73  |
| 13 | (A) Phân bố F1 từng bản ghi trên toàn bộ 75 bản ghi set-a — vẫn <b>lượng cực</b> : một đỉnh ở 90–100 và một đỉnh dưới 30. Mô hình 22 ca đẩy khối lượng sang phải nhưng <b>không xoá</b> đỉnh thấp. (B) Mẫu 10 bản ghi cũ so với toàn bộ. . . . .                                                                                                                 | 76  |
| 14 | (A) Macro F1 trên chủ thể giữ lại theo số chủ thể huấn luyện; dải mờ là min–max của 5 lần chạy. (B) Ảnh hưởng của quy tắc chọn ngưỡng. Với $k = 1$ không có chủ thể validation nên dùng ngưỡng cố định 0,45; với $k = 2$ ngưỡng chọn trên một chủ thể trong tập huấn luyện — cả hai đều được ghi rõ. . . . .                                                     | 78  |
| 15 | Đổi chuẩn trên giao thức kênh lâm sàng tốt nhất, dung sai $\pm 50$ ms. Đường đứt đỏ là con số <b>thật</b> mà bài DPSS công bố cho nhóm chuyển dạ. . . . .                                                                                                                                                                                                        | 80  |
| 16 | Đường cong rủi ro–độ phủ trên CinC 2013. Đường topo (xanh dương) gần như nắm sát đường từ chối ngẫu nhiên (xám) trên toàn bộ dải độ phủ. Đường cổ điển (cam) tách rõ và tiến về oracle (đứt). . . . .                                                                                                                                                            | 84  |
| 17 | Tương quan Spearman của từng chỉ số với F1 đoạn, kèm khoảng tin cậy bootstrap 95%. Trái: trong miền. Phải: ngoài miền. Các chỉ số cổ điển (cam) <b>mạnh lên</b> khi ra ngoài miền; các chỉ số topo (xanh) <b>yếu đi</b> và nhiều chỉ số đổi dấu. . . . .                                                                                                         | 85  |
| 18 | Ảnh chụp giao diện thật trên r01, kênh chọn tự động, checkpoint chưa thấy r01. Năm tầng tín hiệu, 644 nhịp, đèn xanh, 690 ms xử lý cho 5 phút tín hiệu. . . . .                                                                                                                                                                                                  | 89  |
| 19 | Ảnh chụp trên a02, bản ghi tệ nhất của CinC 2013, zero-shot. Đèn <b>đỏ</b> vì 97% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ. Đồ thị nhịp tim cho thấy đúng cơ chế thất bại: đường mô hình bám ở nhịp mẹ ( $\approx 126$ ) trong khi nhân ở $\approx 160$ nhịp/phút. Hệ thống tự phát hiện và từ chối, thay vì báo sai. . . . .                                                 | 90  |
| 20 | (a) STV nhân so với STV mô hình, phóng to vùng lâm sàng (vùng đỏ là bệnh lý). (b) Bland–Altman cho STV. (c) Bland–Altman cho nhịp tim thai, cửa sổ 60 giây. Nguồn: analysis/clinical.py. . . . .                                                                                                                                                                 | 96  |
| 21 | (a) % thời lượng trả lời từng bản ghi so với mốc CTG. (b) Phân bố độ dài khoảng trống, thang log, mốc 90 giây. (c) Khoá nhịp mẹ so với nhân chuẩn và phân phối rộng. . . . .                                                                                                                                                                                     | 100 |

# 1. Tóm tắt

Theo dõi tim thai không xâm lấn bằng **một** điện cực dán trên bụng mẹ là cấu hình rẻ nhất và dễ đeo nhất cho giám sát tại nhà, đồng thời là cấu hình khó nhất về mặt xử lý tín hiệu. Sóng tim thai bị sóng tim mẹ lớn gấp nhiều lần che khuất, hai nguồn trùng phổ tần số, và khi chỉ có một kênh thì không dùng được các phương pháp tách nguồn mù đa kênh vốn cho kết quả tốt nhất.

Hai mươi năm nghiên cứu đã sinh ra hàng chục phương pháp với F1 công bố trải từ 77% đến 99,7%. Nhóm đã đọc toàn văn 30 công trình và kết luận rằng **phần lớn các con số đó không so sánh được với nhau**, vì chúng khác nhau ở cách tách chủ thể, dung sai ghép cặp, số kênh thực sự dùng, và việc có tinh chỉnh trên tập đích hay không. Chi tiết ở §3.

Trước khi viết đề cương này, nhóm đã chạy một loạt thí nghiệm tiền khả thi. Ba kết quả định hình toàn bộ phần còn lại của tài liệu.

1. **Front-end tín hiệu là tầng lớn nhất trên bộ học cửa sổ 300 ms — nhưng trên chính TCN thì chưa xác lập được.** Chỉ đổi dải thông từ 1–45 Hz sang 10–60 Hz nâng macro F1 thêm **11,00 điểm** trong cùng một thí nghiệm có kiểm soát — **đo trên gradient boosting, cửa sổ 300 ms**. Trong khi đó, khi giữ cố định ngưỡng cảnh thời gian, việc thay gradient boosting bằng mạng học sâu chỉ đáng **+0,41 điểm**. Ở mức chủ thể, hiệu số giữa bảy kiến trúc phi tuyến nằm trong khoảng  $-2,95$  đến  $+0,73$  điểm (§10). **Cập nhật 12/09/2026 — kết quả sơ bộ, và nó đi ngược độ lớn cũ:** nhóm đã lặp lại đúng thay đổi dải đó trên **chính TCN**, 22 chủ thể, và chỉ thu được **+2,44 điểm** (98,07 so với 95,63), với KTC 95% cluster bootstrap mức chủ thể  $[-0,04; +6,29]$  — **chạm số không**. Nghĩa là ở  $n = 22$ , hiệu ứng dải lọc trên TCN **chưa được xác lập**; con số **+11,00 không chuyển sang TCN ở cùng độ lớn**. Và nếu bỏ bước chọn kênh, lấy trung bình cả bốn kênh, thì hiệu số là **-0,07 điểm** với KTC  $[-0,51; +0,39]$  — **bằng không**. Chi tiết và các giới hạn ở §5.2.1. Dải 10–60 Hz **không phải phát hiện của nhóm**: nhóm lấy nó từ Xu và cộng sự 2026; đóng góp ở đây là **đo nó** trong cùng một thí nghiệm có kiểm soát với hai tầng còn lại.
2. **Biểu diễn topo không phù hợp cho bài toán này, ở cả hai vai trò nhóm đã thử.** Làm đặc trung dò đỉnh: Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng **cuối cùng trong 16 kiến trúc** ở cùng ngân sách tham số (F1 27,42 so với 97,14). Làm chỉ số chất lượng tín hiệu: đặc trưng đồng điều bền vững dự báo lỗi mô hình với AUROC **0,566** ngoài miền, so với **0,929** của chỉ số cổ điển gộp trên 10 bản ghi (0,721 nếu chỉ tính *trong* từng bản ghi — §10), và gộp vào còn làm giảm. Nhóm cũng chứng minh bằng số rằng  $H_0$  của lọc dưới mức **trùng khớp 100%** với độ nhô đỉnh cổ điển.
3. **Dữ liệu là độn bầy lớn nhất, nhưng chưa đủ, và độ tin cậy là rào cản thật.** Mô hình học trên 5 ca đạt macro F1 **99,21** trên ADFECGDB khi tách theo bản ghi, nhưng khi chuyển sang một hệ ghi khác (PhysioNet/CinC 2013, **60 bản ghi set-a không phải bản sao ADFECGDB**) chỉ còn **64,04** với phân bố tách đôi: 22 trên 60 bản ghi sụp

dưới 50. Huấn luyện lại trên **22 sản phụ** — thêm 17 ca cùng bệnh viện, trong đó 10 ca thai kỳ — nâng thai kỳ từ 93,30 lên **97,15** và nâng CinC 2013 từ 64,04 lên **74,28** (hiệu số +10,24; KTC 95% [+7,13; +13,60]; thắng 52 thua 3 trên 60 bản ghi sạch; benchmark\_dpss/eval\_cinc60\_sach.json). Nhưng **vẫn còn 16 bản ghi dưới 50**, và hệ thống vẫn cần biết khi nào nó sai. (*Bản 3.4 ghi 71,21 → 79,40 trên 75 bản; đã rút vì 15 bản là bản sao dữ liệu huấn luyện — §5.10.3.*)

### Bản 3.3 sửa gì so với bản 3.2 — đọc trước khi đọc phần còn lại

1. **CinC 2013:** mọi con số cũ (59,15 / 69,31 / 77,34 / 90,34) đo trên **mẫu 10 bản ghi** của một tập có 75 bản ghi. Mẫu đó lệch, và lệch theo *hai hướng ngược nhau* tùy quy tắc chọn kênh. Bản 3.4 thay bằng 79,40 trên 75 bản; **bản 3.5 rút tiếp con số đó:** 15/75 bản là bản sao ADFECGDB (ban tổ chức đã ghi nhận từ 2013), số đúng là **74,28** trên 60 bản sạch. Kết luận cũ “không còn bản ghi nào dưới 50” **sai** (§5.10.3).
2. **Power-MF:** bản 3.2 ghi “không chạy lại được”. Sai — đã chạy qua GNU Octave. **Và bản 3.3 cũng sai:** mọi con số Power-MF của nó (94,87 / 98,38) đúng trên một bản Octave hòng vì lỗi cổng chuyển của nhóm, đã rút hết. Số đúng: Power-MF đa kênh 98,83, RELYFETAL 97,56 — không phân biệt được; Power-MF **cùng một đạo trình** chỉ đạt 86,71 (§5.7).
3. **Thông kê:** đơn vị phân tích cũ là cặp (bản ghi × kênh), tức giả lập. Mọi  $p$  trên 5 sản phụ đã bị gỡ. Tuyên bố “8 kiến trúc không phân biệt được” đổi thành “không đủ lực để phân biệt” — TOST cho 0/7 tương đương (§10).
4. **Lâm sàng:** hệ thống là một bộ đếm nhịp tim thai tốt nhưng **không** dùng được làm máy đo biến thiên ngắn hạn (§9).

Từ ba quan sát đó, đề tài đề xuất RELYFETAL: một bộ dò QRS thai đơn kênh **kèm cổng từ chối trả lời**, cho phép hệ thống nói “không đọc được” khi tín hiệu không đủ tin cậy, thay vì im lặng đưa ra một nhịp tim sai. Prototype của cổng này đã chạy: trên CinC 2013, từ chối 20% đoạn kém tin cậy nhất nâng F1 phần còn lại thêm +7,49 điểm (KTC 95% cụm [+2,94; +11,54]), và bản demo bắt đúng hai bản ghi tệ nhất mà không bỏ lọt bản ghi tốt nào.

### Ba tuyên bố “đầu tiên” mà nhóm RÚT LẠI trong bản 3.3

Rà soát y văn vòng ba (survey/scout\_novelty.md) cho thấy ba điểm mà bản 3.2 ngầm nhận là mới thì thực ra **đã có chủ**:

- **“Front-end quan trọng hơn kiến trúc”** — Andreotti và cộng sự 2016 (*Physiol Meas* 37(5):627) đã chứng minh *định tính* rằng lựa chọn tiền xử lý **đạo thứ hạng** các thuật toán trích fECG. Nhóm chỉ thêm **con số** trên dữ liệu thật.
- **Quét trường tiếp nhận / lịch giãn nở** — Fotiadou và cộng sự 2021 (*Physiol Meas* 42(4):045007) đã quét dilation cho fHR và kết luận dilation quan trọng hơn kích thước hạt nhân.
- **Bản đồ nhiệt theo từng mẫu** — Zahid và cộng sự 2022 (*IEEE TBME* 69(1):119) đã phát biểu lại dò đỉnh R thành bài toán phân đoạn 1 chiều theo từng mẫu. Gaussian  $\sigma = 12$  ms là **làm mượt nhân**, không phải phát biểu bài toán mới.

- **Cổng từ chối cho fECG** — Andreotti và cộng sự 2017 (*IEEE TBME*, DOI 10.1109/TBME.2017.2675543) đã có chỉ số chất lượng fSQI cho chính bài toán này.

Nhóm **định vị lại đề tài là TIẾP NỐI** Andreotti 2016/2017 và Behar 2014, không phải phản bác họ.

### Ba đóng góp, phát biểu lại cho đúng phạm vi

Một trục duy nhất: **phân rã có kiểm soát + đối chuẩn công bằng + kết quả phủ định được công bố nguyên trạng.**

#### C1 — **Đối chuẩn công bằng, không rò rỉ, ở cấu hình đơn kênh.**

So sánh năm họ biểu diễn tín hiệu dưới cùng một giao thức, cùng bộ phân loại, cùng ngân sách huấn luyện, với quy tắc chọn kênh **mù nhãn** đăng ký trước — và, mới trong bản 3.3, **một baseline hiện đại chạy lại thật** (Power-MF, §5.7) thay vì trích con số đã công bố — chạy ở **cả hai cấu hình đạo trình**, để đo được tách nguồn đa kênh đáng bao nhiêu điểm F1. Không phải “đối chuẩn đầu tiên”; kho `mad-lab-fau/fecg-benchmarking` đã tồn tại.

#### C2 — **Phân rã đóng góp ba tầng, định lượng, trên dữ liệu thật.**

Front-end / ngữ cảnh / họ kiến trúc trong **một** thí nghiệm duy nhất, cùng giao thức, ở mức chủ thể. Andreotti 2016 nói định tính trên dữ liệu tổng hợp; Fotiadou 2021 chỉ quét một tầng. **Chưa ai ghép ba tầng vào một thí nghiệm trong fECG** — đây là đóng góp vững nhất, và cũng là đóng góp duy nhất nhóm còn dám gọi là mới.

#### C3 — **Đánh giá cổng từ chối XUYÊN HỆ GHI, kèm kết quả phủ định có kiểm soát về đồng điều bền vững.**

Cơ chế từ chối **không mới** (Andreotti 2017, Shi 2023, Baldazzi 2023); cái mới là đánh giá nó **zero-shot sang một hệ ghi khác** kèm đường cong rủi ro–độ phủ, và báo cáo thẳng rằng AUROC **trong** bản ghi chỉ là 0,721 chứ không phải 0,929 (§10). Phân topo là thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên của phân tích dữ liệu topo trên tín hiệu tim thai mà nhóm tìm được, kết quả là **không có lợi ích**, và được công bố nguyên trạng.

## 2. Đặt vấn đề

### 2.1. Bối cảnh lâm sàng

Nhịp tim thai và hình thái phức bộ QRS thai là cửa sổ chính để phát hiện suy thai, thiếu oxy và một số bất thường tim bẩm sinh. Hai phương pháp đang dùng trên lâm sàng đều có hạn chế rõ ràng.

**Bảng 1:** Hai phương pháp theo dõi tim thai hiện hành và giới hạn của chúng.

| Phương pháp                 | Ưu điểm                   | Giới hạn                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tim thai đồ / Doppler (CTG) | Không xâm lấn, phổ biến   | Chỉ cho nhịp, không cho hình thái. Cần kỹ thuật viên đặt đầu dò. Không dùng liên tục tại nhà được. |
| Điện cực xoắn da đầu thai   | Chuẩn vàng, tín hiệu sạch | Xâm lấn. Chỉ dùng được sau khi đã chuyển dạ và vỡ ối. Không dùng cho theo dõi thai kỳ.             |

Điện tim thai không xâm lấn từ điện cực ổ bụng cho phép theo dõi liên tục, tại nhà, chi phí thấp, và cho cả hình thái sóng chứ không chỉ nhịp. Cấu hình **đơn kênh** là rẻ nhất và dễ tích hợp vào đai đeo nhất, nhưng cũng loại bỏ luôn khả năng dùng tách nguồn mù đa kênh — vốn là họ phương pháp đạt độ chính xác cao nhất trong đối chuẩn tổng hợp của Andreotti và cộng sự.

### 2.2. Vì sao đơn kênh khó

Bảng dưới đây là các con số nhóm **tự đo được** trên ADFECGDB, không phải trích từ y văn.

**Bảng 2:** Các khó khăn của cấu hình đơn kênh, kèm hệ quả định lượng nhóm đo được trên ADFECGDB.

| Thách thức                                  | Hệ quả định lượng                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biên độ sóng thai nhỏ hơn sóng mẹ nhiều lần | Tỉ số RMS giữa vùng QRS thai và nền chỉ <b>1,24</b> ở dải 1–45 Hz; lên <b>1,64</b> ở dải 15–60 Hz |
| Trùng phổ tần số trong khoảng 0,5–40 Hz     | Lọc tuyến tính không tách được nếu không làm méo sóng thai                                        |
| Nhịp mẹ và nhịp thai trùng pha              | <b>17–19%</b> nhịp thai nằm trong $\pm 60$ ms của một nhịp mẹ                                     |
| Không có đa dạng không gian                 | Không dùng được tách nguồn mù đa kênh (ICA, PCA, $\pi$ CA)                                        |
| Chất lượng kênh biến thiên cực lớn          | F1 theo từng kênh dao động từ <b>85,03</b> đến <b>100,00</b> trên cùng một bản ghi                |
| Dữ liệu có nhãn rất ít                      | ADFECGDB chỉ có 5 sản phụ; chia ngẫu nhiên là ròi dữ liệu                                         |



## 2.3. Ba khoảng trống trong y văn

Nhóm đã tải và đọc **toàn văn 30 công trình** (danh mục đầy đủ ở §3 và Phụ lục). Ba khoảng trống được xác nhận.

### G1 — Không có so sánh công bằng giữa các họ biểu diễn tín hiệu.

Mỗi công trình dùng một biểu diễn riêng (tín hiệu thô, ma trận trễ, phổ đồ thời gian–tần số, đặc trưng topo) trên dữ liệu riêng với giao thức riêng. Chưa có công trình nào giữ cố định đồng thời bộ phân loại, dữ liệu, giao thức và ngân sách huấn luyện để so các biểu diễn. Hệ quả là cộng đồng không biết cải tiến đến từ biểu diễn hay đơn giản là từ tiền xử lý tốt hơn.

### G2 — Không có đánh giá độ tin cậy ở mức bản ghi.

Mọi công trình đều báo cáo một con số F1 trung bình. Không công trình nào trả lời câu hỏi lâm sàng thật sự: “*với bản ghi cụ thể đang nằm trước mặt, đầu ra này có đáng tin không?*” Đo đạc của nhóm cho thấy phân bố hiệu năng là **lưỡng cực**, nên chính con số trung bình đang che giấu thông tin quan trọng nhất.

### G3 — Chưa có công trình nào áp dụng đồng điều bền vững cho tín hiệu tim thai.

Nhóm truy vấn có cấu trúc trên Europe PMC REST, Semantic Scholar, OpenAlex và arXiv API với tổ hợp (“persistent homology” OR “topological data analysis” OR “persistence image”) AND (fetal OR foetal OR “abdominal ECG” OR cardiotocography), tìm bổ sung bằng tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Không có kết quả nào là công trình về tín hiệu thai. Kết quả gần nhất là biến thiên nhịp tim nhi khoa, mà chính tác giả nêu “*mở rộng khung này sang fetal HRV*” là hướng tương lai.

## 2.4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

**Bảng 3:** Sáu câu hỏi nghiên cứu và thí nghiệm trả lời tương ứng.

| Mã  | Câu hỏi                                                                                                                                                          | Thí nghiệm |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RQ1 | Dưới một giao thức không rò rỉ, họ biểu diễn tín hiệu nào cho hiệu năng dò fQRS đơn kênh tốt nhất khi giữ cố định bộ phân loại và ngân sách huấn luyện?          | E1         |
| RQ2 | Trong toàn bộ pipeline, tầng nào đóng góp nhiều nhất: front-end tín hiệu, độ dài ngữ cảnh, họ kiến trúc, hay hậu xử lý?                                          | E2         |
| RQ3 | Chỉ số chất lượng dựa trên đồng điều bền vững có dự báo được khi nào bộ dò sẽ sai, và có tốt hơn các chỉ số cổ điển (SampEn, bSQI, kurtosis, entropy phổ) không? | E3         |
| RQ4 | Cơ chế từ chối trả lời nâng độ tin cậy lên bao nhiêu, đánh đổi bằng bao nhiêu phần trăm dữ liệu bị loại?                                                         | E4         |
| RQ5 | Hiệu năng suy giảm thế nào khi chuyển miền và khi tỉ số tín hiệu trên nhiễu giảm?                                                                                | E5, E6     |
| RQ6 | Tiền huấn luyện trên dữ liệu tổng hợp rồi tinh chỉnh trên dữ liệu thật có cải thiện khả năng tổng quát hoá không?                                                | E7         |

**Bảng 4:** Giả thuyết kiểm định được và tiêu chí chấp nhận.

| <b>Mã</b> | <b>Giả thuyết</b>                                                                                                                                                    | <b>Tiêu chí chấp nhận</b>                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1        | Bộ dò RELYFETAL đạt $F1 \geq 95\%$ trên ADFECGDB khi tách theo bản ghi, với quy tắc chọn kênh mù nhãn                                                                | <b>Hiệu số ghép cặp ở mức chủ thể</b> so với nền trừ mẫu kết hợp PCA, kèm KTC 95% bootstrap cụm <b>loại trừ 0</b> . Không dùng ngưỡng $p$ : với $n = 5$ chủ thể, $p < 0,05$ là bất khả thi (§10) |
| H2        | Front-end tín hiệu đóng góp nhiều hơn họ kiến trúc ít nhất 5 lần về điểm F1                                                                                          | So sánh hai hiệu ứng chính, kèm khoảng tin cậy bootstrap                                                                                                                                         |
| H3        | fSQI topo có tương quan Spearman $ \rho  \geq 0,6$ với F1 thực theo bản ghi, và không kém SampEn                                                                     | Bootstrap CI cho hiệu số $\rho$                                                                                                                                                                  |
| H4        | Từ chối 20% dữ liệu có fSQI thấp nhất nâng F1 trên phần còn lại thêm $\geq 8$ điểm                                                                                   | Đường cong rủi ro–độ phủ, so với cổng từ chối ngẫu nhiên                                                                                                                                         |
| H5        | Tiền huấn luyện FECGSYNDB nâng F1 xuyên bộ dữ liệu thêm $\geq 5$ điểm                                                                                                | Hiệu số ghép cặp trên <b>75 bản ghi</b> CinC 2013 kèm KTC bootstrap; đây là tập duy nhất đủ lực để dùng $p$                                                                                      |
| H0        | <b>Giả thuyết phủ định vẫn có giá trị:</b> nếu H3–H5 không đạt, thì đối chuẩn cộng phân rã đóng góp cộng kết quả phủ định có kiểm định vẫn là một bài báo hoàn chỉnh | —                                                                                                                                                                                                |

### 3. Nhóm đã đọc gì và so với ai

Phần này trả lời trực tiếp câu hỏi mà một hội đồng sẽ đặt ra đầu tiên: *nhóm đã đọc những gì, và mô hình của nhóm đứng ở đâu so với các công trình đó?*

#### 3.1. Cách nhóm chọn và đọc

Nhóm tải về và đọc **toàn văn 30 công trình**, không dừng ở phần tóm tắt. Danh mục được chọn theo bốn tiêu chí: các công trình được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực dò QRS thai; các công trình mới nhất giai đoạn 2024–2026; các công trình mô tả bộ dữ liệu và thử thách chuẩn; và toàn bộ nền tảng lý thuyết của phân tích dữ liệu topo mà bản đề cương đầu tiên của nhóm dựa vào.

Khi đọc, nhóm ghi lại bảy điểm cho từng bài, vì đây là những chỗ quyết định một con số công bố có so sánh được hay không.

1. Giao thức tách dữ liệu: tách theo chủ thể, tách theo bản ghi, hay chia ngẫu nhiên? Chia ngẫu nhiên trên cùng một bệnh nhân là **rò rỉ dữ liệu**.
2. Dung sai ghép cặp nhịp: 50 ms là quy ước CinC 2013, 150 ms là chuẩn AAMI EC57 cho người lớn. Nói dung sai làm con số đẹp lên mà không cần cải tiến gì.
3. Dùng thật sự một kênh hay gộp nhiều kênh? Nhiều công trình tự nhận “đơn kênh” nhưng thực tế gộp bốn kênh ở bước cuối.
4. Có tinh chỉnh trên tập đích không? Nếu có thì không so được với mô hình không tinh chỉnh.
5. Dải thông dùng là gì? Theo thực nghiệm của nhóm, đây là biến quan trọng nhất.
6. Độ dài cửa sổ ngữ cảnh là bao nhiêu giây?
7. Có báo cáo chi phí tính toán không? Nếu không thì công trình đó không tái lập được về mặt kỹ thuật.

#### 3.2. Kết quả tổng hợp

Trong 30 công trình, chỉ **bốn** công trình có giao thức đối chiếu trực tiếp được với giao thức của nhóm. Phần lớn còn lại rơi vào một trong các trường hợp: chia ngẫu nhiên trong cùng chủ thể, dung sai rộng hơn, gộp nhiều kênh, tinh chỉnh trên tập đích, hoặc đơn vị phân tích là cửa sổ tín hiệu thay vì nhịp tim.

##### Phát hiện đáng chú ý nhất khi đọc y văn

Công trình học sâu nền tảng của lĩnh vực (Zhong và cộng sự 2018) báo cáo F1 77,85%. Nhưng khi đọc kỹ, con số đó là F1 của bài toán **phân loại nhị phân cửa sổ 100 ms trên tập đã cân bằng lớp nhân tạo**, không phải F1 dò nhịp theo chuẩn CinC 2013. Nhiều công trình về sau trích lại con số này như thể nó là F1 dò nhịp. Đây là một lỗi trích dẫn mang

tính hệ thống của cả lĩnh vực, và nhóm sẽ nêu rõ trong bài báo.

Công trình đó cũng dùng dải thông 0,5–100 Hz — chính là dải cho kết quả **thấp nhất** trong khảo sát tám dải của nhóm (72,17 so với 91,06 của dải 10–60 Hz, chênh 18,89 điểm).

**Bảng 5:** Ba mươi công trình nhóm đã đọc toàn văn, xếp theo họ phương pháp. Cột cuối cho biết giao thức đánh giá của bài đó có đối chiếu trực tiếp được với giao thức của nhóm hay không.

| Mã              | Công trình                                                                                                              | Mô hình                                                                                                                                                                                                            | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | So được?    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Học sâu dò fQRS |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| p01             | Zhong 2018                                                                                                              | CNN 1D nông gồm 3 khối tích                                                                                                                                                                                        | CNN đề xuất đạt Precision 75,33%,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | một<br>phần |
|                 | Đây là công trình đầu tiên (theo tuyên bố của chính tác giả) dùng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để dò phức bộ QRS thai... | chập (Conv1 → BatchNorm → ReLU; Conv2 → Dropout → MaxPool → ReLU; Conv3 → Dropout → MaxPool → ReLU) với 64/128/256 bộ lọc, độ dài bộ lọc bằng 3 cho cả ba lớp (tác giả nói đã thử bộ...                            | Recall 80,54%, F-measure (F1) 77,85% và Accuracy 77,38%; so sánh accuracy bốn bộ phân lớp (Bảng 1): KNN 68,76%, Naive Bayes 55,52%, SVM 70,65%, CNN 77,38%. Bước SQI chỉ nâng accuracy từ 76,52%...<br><i>Chia cổ định theo bản ghi một lần duy nhất, không phải tách theo bản ghi (leave-one-record-out), không phải tách theo chủ thể, cũng không phải...</i>                                    |             |
| p09             | Xu 2026                                                                                                                 | IMFClassifier1D là CNN 1 chiều nhận đầu vào 1 kênh dài 10.000 mẫu (10 giây ở 1000 Hz), gồm 5 khối conv-BatchNorm-ReLU-pooling với kích thước nhân giảm dần [31, 21, 15, 11, 7] và số kênh đặc trưng hình kim tự... | Bộ phân lớp IMF đạt AUC trung bình 0,9282 ± 0,0189 qua tách theo chủ thể trên 20 đối tượng và 3 lần chạy (cao nhất r08 0,9840 ± 0,0035 và Case 12 0,9647; thấp nhất r07 0,8550 ± 0,0161 và Case 9 0,8840), còn cấu hình mạng tốt...<br><i>Tách theo chủ thể chỉ được áp cho bộ phân lớp IMF chứ không cho bước dò đỉnh R đầu-cuối: 20 đối tượng (15 mô phỏng và 5 lâm sàng), mỗi fold giữ 1...</i> | không       |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                                 | Mô hình                                                                                                                                                                                                                  | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | So được?     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| p10 | Esmaeili 2025<br>Bài dò QRS thai nhi trực tiếp từ ECG bụng mà không khử ECG mẹ, và không coi đây là bài toán tìm vị trí đỉnh mà là phân... | CNN 1 chiều nhận đầu vào 4 (kênh) $\times$ 1000 (mẫu), tức đoạn 1 giây ở 1 kHz, gồm 5 lớp tích chập (lớp 1 và 2 dùng stride 2), 7 lớp batch normalization, 3 lớp dropout và 3 lớp fully-connected, kích hoạt ReLU sau... | Phương án 1 (25 bản ghi, hàm MAPE, 100 epoch, ngưỡng 0,5) cho kết quả cao nhất: Accuracy $98,36 \pm 0,07$ ; Sensitivity $98,79 \pm 0,13$ ; Specificity $96,85 \pm 0,43$ ; Precision $99,09 \pm 0,12$ ; F1 $96,35 \pm 0,16$ ; MSE $0,01 \pm 0$ .<br>Phương án 5 (60...<br><i>Không phải tách theo chủ thể cũng không phải tách theo bản ghi, mà là chia ngẫu nhiên 80-20% (hoặc 33-67% ở phương án 3), và bài tự mâu thuẫn: Bảng...</i> | <b>không</b> |
| p12 | Wahbah 2024<br>Bài báo xây dựng một khung học sâu phát hiện trực tiếp đỉnh R của thai nhi từ tín hiệu ECG bụng 12 kênh, không tách...      | Kiến trúc gồm 3 lớp BiLSTM, 2 lớp dropout (0,5) xen giữa, 1 lớp fully connected 2 đầu ra, softmax và lớp phân loại, với đầu vào chuỗi 12 đặc trưng tương ứng 12 kênh bụng. Số tham số tổng: bài không nêu; ngoài...      | Subject-dependent 5-fold (có rò rỉ): accuracy từng fold $92,5 / 93,4 / 93,5 / 93,2 / 92,6$ , trung bình $93,0\%$ với $F1 = 0,96$ ; sau khi thêm FECGPP đạt accuracy $94,2\%$ , $F1 = 0,97$ và độ nhạy tăng từ $81\%$ lên $85,8\%$ . Tách theo chủ thể trên...<br><i>Bài chạy hai giao thức và báo cáo cả hai: (A) subject-dependent với 5-fold cross-validation, là rò rỉ dữ liệu vì cùng một bệnh nhân xuất hiện ở cả...</i>          | <b>không</b> |

Tách nguồn / tái tạo dạng sóng

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                                      | Mô hình                                                                                                                                                                                                             | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | So được?     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| p03 | Mohebbian 2022<br><br>Bài coi việc tách ECG thai nhi khỏi ECG bụng mẹ là bài toán chuyển đổi tín hiệu sang tín hiệu, dùng CycleGAN một chiều... | CycleGAN 1D có chú ý: bộ sinh gồm MultiHead self-attention (2 đầu, số chiều nhúng bằng kích thước cửa sổ) → chuẩn hóa và cắt ngưỡng [0,8; 1] → nhân phần tử → Conv1D 13 bộ lọc kernel 3, Conv1D 7 bộ lọc kernel...  | Chất lượng tái tạo tín hiệu trên A&D FECG (Bảng I, tách theo chủ thể):<br>R-squared trung bình 98% [CI 95%: 97–99%], theo từng đối tượng R-squared = 0,99 / 0,98 / 0,96 / 0,98 / 0,98; ICC = 0,99 / 0,99 / 0,98 / 0,99 / 0,99; WEDD =...<br><br><i>Bài dùng ba giao thức có chất lượng rất khác nhau: trên A&amp;D FECG là tách theo chủ thể thật sự, lặp 5 lần cho 5 đối tượng — giao thức sạch và là giao...</i> | <b>có</b>    |
| p04 | Basak 2024<br><br>Bài cũng dùng CycleGAN một chiều để chuyển ECG bụng mẹ thành ECG thai nhi, nhưng mục tiêu khác hẳn các bài chi dò...          | CycleGAN 1D với bộ sinh kiểu ResNet: cấu hình tốt nhất là ResNet 13 khối gồm 3 lớp Conv1D hạ mẫu kích thước 16, 32, 64 (mỗi lớp kèm BatchNorm + Dense + ReLU) → n khối ResNet (mỗi khối 2 đơn vị, mỗi đơn vị gồm... | Chất lượng tái tạo fECG theo hệ số tương quan Pearson (Bảng 1, trung bình 5 fold): ResNet 13 khối + Basic 0,882 (tốt nhất), ResNet 13 khối + Self 0,871, ResNet 9 khối + Basic 0,864, ResNet 9 khối + Self 0,855, Unet 256 + Basic...<br><br><i>Kiểm định chéo 5-fold trên dữ liệu gộp của cả hai bộ, mô tả nguyên văn chỉ gồm một câu duy nhất "The datasets were split using the 5-Fold..."</i>                  | <b>không</b> |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                            | Mô hình                                                                                                                                                                                                              | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | So được? |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| p05 | Arash 2023<br>Bài giải bài toán tách nguồn mù từ một kênh ECG bụng duy nhất, đồng thời tách tín hiệu trộn AECG thành ECG mẹ (MECG)... | DPSS (Dual-Path Source Separation) gồm khối khử nhiễu LSCGAN (bộ sinh DP-LSTM và bộ phân biệt ResBlock) ghép với khối tách nguồn dựa trên mặt nạ (Inception và 3 khối DP-LSTM).<br>Số tham số, kích thước mô hình... | Trên FECGSYNDB (tách theo chủ thể, cùng phân phối), F1 trung bình đạt 99,03% ( $\pm 0,39$ ) và SI-SNR +14,92 dB ( $\pm 1,02$ ), tốt nhất là chủ thể 8 với F1 99,35% và SI-SNR +15,94 dB, yếu nhất là chủ thể 2 với F1 98,24%. Kiểm thử zero-shot...<br><i>Mô hình được huấn luyện bằng xác thực chéo tách theo chủ thể chỉ trên FECGSYNDB (9 chủ thể tổng hợp để huấn luyện, 1 chủ thể giữ lại kiểm thử, lặp...</i> | một phần |
| p06 | Lin 2025<br>Bài xây dựng một mạng hình chữ W gồm hai mạng Attention R2U-Net song song, trong đó nhánh phải tái tạo ECG mẹ, nhánh...   | Attention R2W-Net gồm hai mạng Attention R2U-Net 1D ghép chữ W, dùng khối tích chập hồi quy có dư (RRC) và cổng chú ý, với số kênh các tầng ghi trong bài là "64, 128, 256, 512, 256 và 1024". Số tham số, kích...   | Về chất lượng tái tạo tín hiệu, FECGSYN đạt MSE $0,096 \pm 0,016$ và MAE $0,082 \pm 0,006$ (theo kịch bản: C0 MSE 0,079 / C1 0,083 / C2 0,081 / C3 0,122 / C4 0,114 / C5 0,097), còn ADFECGDB đạt MSE $0,025 \pm 0,004$ , MAE $0,013 \pm 0,003$ và...<br><i>Đây là điểm yếu nghiêm trọng nhất của bài: trên FECGSYNDB chỉ có một lần chia duy nhất — dữ liệu của đối tượng thử 10 làm tập kiểm thử, các đối...</i>  | không    |

tiếp trang sau



Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                               | Mô hình                                                                                                                                                                                                           | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | So được?  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| p07 | Amirreza 2025<br>Bài chuyển tín hiệu một kênh thành ảnh hai chiều bằng phép nhúng trễ (time-delay embedding, dựa trên định lý Takens)... | SCTD-Net gồm SCTD-1Net (chi Ursa-Net 2D) và SCTD-2Net (U-Net 1D trích MECG kết hợp Ursa-Net 2D trích FECG). Bảng 3 báo cáo đầy đủ: SCTD-1Net có 7,68 triệu tham số, dung lượng 92,78 MB và 3,91 GFLOPs mỗi lần... | SCTD-2Net đánh giá zero-shot đạt Se 97,19% / PPV 98,80% / F1 97,97% trên PCDB (80 kênh) và Se 95,17% / PPV 97,94% / F1 96,52% trên ADFECGDB (17 kênh), vượt SCTD-1Net ở cả ba chỉ số, rõ nhất ở độ nhạy với mức cao hơn khoảng 1,10...<br><i>Đây là giao thức sạch nhất trong ba bài và cũng là giao thức duy nhất có thể đối chiếu công bằng: huấn luyện 100% trên dữ liệu tổng hợp FECGSYN...</i>                                      | một phần  |
| p11 | Orvas 2025<br>Bài tách tín hiệu ECG thai nhi từ ECG bụng đơn kênh thu bằng điện cực vải khô - loại không dùng gel, thoải mái khi đeo...  | Complex UNet (CUNet) là một UNet giả trị phức chạy trên phổ đồ STFT phức. Bài không nêu số tham số, không nêu FLOPs, không nêu độ trễ suy luận, không nêu kích thước mô hình, không nêu số lớp m, kích thước...   | Trên 100 đối tượng mô phỏng (Bảng II), CUNet đạt PRD $26,2 \pm 11,6$ ; PCC $95,9 \pm 5,7$ ; F-score $99,8 \pm 0,2$ ; SE $99,6 \pm 0,4$ ; HRerr $0,40 \pm 0,81$ bpm, so với UNet F-score $99,3 \pm 1,6$ / PCC 77,4; AttUNet $98,4 \pm 10,1$ / PCC 77,4; SVD $92,0 \pm \dots$<br><i>Không phải tách theo chủ thể cũng không phải tách theo bản ghi, nhưng cũng không cần, vì tập huấn luyện là mô phỏng còn tập đánh giá là dữ liệu...</i> | <b>CÓ</b> |

Xử lý tín hiệu cổ điển

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                               | Mô hình                                                                                                                                                                                                           | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | So được?     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| p16 | Niknazar 2013<br>Bài giải quyết bài toán tách ECG thai khỏi tín hiệu bụng khi chỉ có một điện cực duy nhất, bằng cách mở rộng vector...  | Đây không phải mạng nơ-ron mà là bộ lọc Kalman mở rộng dựa trên mô hình động phi tuyến; bài không nêu tổng số tham số một cách tường minh, cũng không nêu độ trễ, thời gian chạy hay kích thước mô hình. Suy...   | Mọi con số định lượng đều là mức cải thiện SNR/SIR trên dữ liệu tổng hợp chứ không phải độ chính xác phát hiện đỉnh: khi hỗn hợp gần như sạch (công suất nhiễu -30 dB), mức cải thiện SNR tối thiểu của fECG là 40 dB, và ngay cả...<br><i>Bài không nêu dung sai khớp nhịp vì chưa bao giờ đo độ chính xác phát hiện đỉnh: không có Se, không có PPV, không có F1 và không có MAE trên bất kỳ...</i>   | <b>không</b> |
| p17 | Castillo 2018<br>Bài đo nhịp tim thai từ một kênh ECG bụng duy nhất, với điểm độc đáo là không khử ECG mẹ: thay vì tách fECG khỏi hỗn... | Đây không phải mô hình học sâu và không có tham số huấn luyện theo nghĩa mạng nơ-ron, mà là chuỗi xử lý tín hiệu kết hợp gom cụm không giám sát, cài đặt bằng MATLAB ở mức chứng minh khái niệm; bài không nêu... | Trên ADFECGDB với dung sai 50 ms: toàn bộ 17 tín hiệu (10.839 fQRS, 10.000 TP, 839 FN, 413 FP) đạt Se 92,26%, PPV 96,03%, Acc 88,87%, F1 94,11%; riêng Nhóm 1 gồm 11 tín hiệu sạch (6.990 fQRS, 175 FN tức 2,50%, 98 FP tức 1,40%)...<br><i>Dung sai khớp nhịp là 50 ms (nguyên văn: mọi ứng viên lệch quá 50 ms so với nhãn tham chiếu đều bị coi là FP), trùng khớp hoàn toàn với dung sai của...</i> | <b>có</b>    |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã                                   | Công trình                                                                                                                               | Mô hình                                                                                                                                                                                                                                                  | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | So được?        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| p19                                  | Eleonora 2020<br>Bài không đề xuất mô hình mới mà trả lời một câu hỏi kỹ thuật hẹp: khi dùng bộ lọc thích nghi để xóa ECG mẹ khỏi tín... | Bộ lọc thích nghi QRD-RLS, không phải mạng nơ-ron và không dùng học sâu, với hệ số quên $\lambda = 0,999$ và số tập $N = 20$ cho mỗi kênh, nghĩa là MR có 60 hệ số còn SR có 20 hệ số. Bài không nêu số tham số của...                                   | Trên dữ liệu thật (trung vị), độ chính xác phát hiện fQRS của SR so với MR là 0,62 so với 0,85 ở kênh ngang, 0,69 so với 0,92 ở kênh dọc, 0,61 so với 0,89 ở kênh chéo và 0,70 so với 0,86 ở kênh đơn cực, dẫn đến kết luận SR chỉ...<br><i>Không có chia train/test, không tách theo chủ thể, không tách theo bản ghi và không k-fold vì đây không phải bài học máy; tuy nhiên <math>\lambda</math>, <math>N</math> và...</i>             | <b>không</b>    |
| <b>Đôi chuẩn, dữ liệu, thử thách</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| p13                                  | Behar 2014<br>Đây là luận án Tiến sĩ 249 trang, tài liệu nền tảng của lĩnh vực fECG không xâm lấn và là nguồn gốc của chuẩn đánh giá...  | Luận án không dùng mạng học sâu; các mô hình có tham số gồm ESN với bể chứa $M = 90$ nơ-ron, độ thừa $\psi = 20\%$ , bán kính phổ $\rho = 0,4$ , hệ số rò rỉ $\alpha = 0,4$ và input scaling $\gamma = 1$ , LMS với $N = 20$ và $\mu = 0,1$ , RLS với... | Chương 5: bSQI đơn lẻ tốt nhất với $Ac = 0,969$ (trên pcaSQI 0,950, sSQI 0,892, kSQI 0,879, qSQI 0,766, pSQI 0,752, basSQI 0,626), kết hợp 6 chỉ số cho $Ac$ kiểm thử 0,985, nhưng trên MIMIC II hoàn toàn độc lập thì tụt còn $Ac = \dots$<br><i>Dùng sai khớp nhịp là <math>\pm 50</math> ms, ghi rõ tại trang 59 và nhắc lại ở mục 9.2.2 — đây chính là nguồn gốc chuẩn mà nhóm đang dùng — với <math>Se = TP/(TP+FN), \dots</math></i> | <b>một phần</b> |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                                   | Mô hình                                                                                                                                                                                                             | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | So được? |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| p14 | Behar 2014<br><br>Chương này so sánh công bằng 15 phương pháp tách fECG trên cùng một bộ dữ liệu, cùng bộ tiền xử lý, cùng bộ dò đỉnh và...  | Không có mạng nơ ron và không có học sâu — toàn bộ là xử lý tín hiệu cổ điển kết hợp tối ưu siêu tham số, nên số tham số huấn luyện được: không áp dụng. Hệ thống chỉ có 6 con số toàn cục (nbC = 20, nbPC = 2,...  | Trên set-a với fb = 10 Hz, thứ hạng F1 là FUSE-SMOOTH 96,0% (Se 95,9, PPV 96,0, HRE 19,1, RRE 6,3), FUSE 95,0, TSpc-ICA 93,0, TSc-ICA 92,6, ICA-TSpc-ICA 92,4, TS-ICA 92,0, TSm-ICA 91,2, ICA-TSpc 89,2, TSlp-ICA 88,4, TSpc-...<br><br><i>Dung sai khớp nhịp là <math>\pm 50</math> ms, và hai hệ thống chấm điểm chạy song song không trùng nhau: F1 kèm Se và PPV được tính trên set-a, tức trong mẫu vì...</i>               | một phần |
| p15 | Andreotti 2016<br><br>Bài này không đề xuất mô hình mới mà xây dựng một bộ khung kiểm thử chuẩn (stress-testing) cho lĩnh vực đo ECG thai... | Không có mạng nơ-ron nào được huấn luyện (ngoại trừ AMesn là mạng echo state, nhưng bài không nêu số nơ-ron hay số tham số của nó); đây là 8 thuật toán xử lý tín hiệu cổ điển và bài không nêu số tham số, kích... | Thí nghiệm 1 (số kênh cho BSS): với 8 kênh, F1 trung bình đạt 97,46% (BSSica-JADE), 97,40% (BSSpc) và 97,22% (FAST-ICA); khi Nch = 16, bước giảm chiều bằng PCA nâng F1 trung bình của ICA từ 95,3% lên 97,3%, và F1 gần như bão...<br><br><i>Không có chia huấn luyện/kiểm thử vì cả 8 phương pháp đều là xử lý tín hiệu không giám sát chạy trực tiếp trên từng bản ghi, nên không tồn tại khái...</i>                         | một phần |
| p20 | Gari 2014<br><br>Đây là bài xã luận mở đầu số đặc biệt về cuộc thi PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2013, không phải bài đề...    | Bài không đề xuất mô hình nào vì đây là xã luận, và không nêu số tham số hay kích thước mô hình của bất kỳ thuật toán nào. Bài chỉ mô tả vắn tắt năm thuật toán của các đội dẫn đầu: Andreotti (ICA cộng bộ lọc...  | 53 đội quốc tế tham gia, sinh ra 208 bộ nhân và 93 bài dự thi mã nguồn mở, với điểm tốt nhất từng sự kiện là E1 = 179,439 (nhịp/phút) <sup>2</sup> , E2 = 20,793 ms, E4 = 18,083 (nhịp/phút) <sup>2</sup> và E5 = 4,337 ms; Andreotti thắng E2 và E5, còn...<br><br><i>Đây là giao thức thi đấu chứ không phải kiểm chứng chéo: thí sinh huấn luyện trên Set A có nhãn công khai, ban tổ chức chấm trên Set B và Set C mà...</i> | một phần |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã                   | Công trình                                                                                                                             | Mô hình                                                                                                                                                                                                                  | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | So được? |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| p21                  | Adam 2020<br>Đây là bài mô tả dữ liệu (Data Descriptor) trong đó nhóm Ba Lan công bố công khai hai bộ tín hiệu điện tim thai nhi do... | Bài không đề xuất mô hình học máy nào và không nêu số tham số của mô hình nào, vì đây là bài mô tả dữ liệu. Các thuật toán được nhắc đến (trừ mẫu PQRST, lọc phối hợp chuẩn hóa, Pan-Tompkins sửa đổi, PCA, ICA,...      | Phần Technical Validation trích lại kết quả của chính nhóm trên bộ dữ liệu này, tất cả với dung sai $\pm 40$ ms: toàn bộ chuỗi xử lý tín hiệu bụng đạt PI tốt nhất 81,4% nhưng khác biệt rất lớn giữa các chuyển đạo bụng (từ 70,4% đến...<br><i>Bài không định nghĩa giao thức train/test nào, không tách theo chủ thể, không tách theo bản ghi và không chia ngẫu nhiên, vì đây là bài công bố dữ...</i> | một phần |
| <b>Lý thuyết TDA</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| p22                  | Jose 2013<br>Bài xây dựng khung lý thuyết đo tính tuần hoàn của chuỗi thời gian bằng cách kết hợp những cửa sổ trượt (time-delay...    | Bài không nêu số tham số vì đây không phải mô hình học máy và không có tham số huấn luyện; chỉ có siêu tham số hình học gồm số chiều những $M+1$ , bậc cắt cụt Fourier N, trường hệ số $F_p$ và số chu kỳ giả định L,... | Thí nghiệm 1 xếp hạng 10 tín hiệu theo điểm tuần hoàn: SW1PerS cho điểm từ 0,9488 (cosin thuần) giảm dần qua 0,8810 (ba tín hiệu), 0,8132, 0,7455, 0,6777, 0,6770 xuống 0,4066 (hai tín hiệu cuối), trong khi JTK_CYCLE trả p-value...<br><i>Không có chia train/test, không có tách theo chủ thể, không có tách theo bản ghi, vì SW1PerS không học tham số nào mà chỉ tính một điểm số rồi vẽ...</i>      | không    |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                                | Mô hình                                                                                                                                                                                                             | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | So được?     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| p23 | Henry 2017<br>Sơ đồ bền vững là một đa tập điểm trong mặt phẳng với số điểm thay đổi tùy mẫu, không cộng trừ được nên không dùng...       | Đây không phải mạng nơ-ron mà là một phép trích xuất đặc trưng; các bộ phân loại đặt bên trên PI gồm K-medoids với K = 6 và 1.000 lần khởi tạo ngẫu nhiên (cải thiện bằng lặp Voronoi), SVM tuyến tính chính quy... | Bảng 1 (ma trận khoảng cách 150×150, phân cụm K-medoids, độ chính xác và thời gian, mức nhiễu 0,05 và 0,1): sơ đồ gốc PD H0 với L1 đạt 96,0% trong 37.346 s và 96,0% trong 42.613 s, PD H0 L2 đạt 91,3% trong 24.656 s, PD H0 L $\infty$ đạt...<br><i>Đây là điểm yếu nhất của bài: thí nghiệm chính (mục 6.1, Bảng 1) dùng K-medoids, tức phân cụm không giám sát chạy trên cả 150 đám mây mà không có...</i>                | <b>không</b> |
| p24 | Mathieu 2020<br>Bài có hai đóng góp; thứ nhất là định nghĩa PersLay, một lớp mạng nơ-ron khả vi tự động nhận đầu vào là sơ đồ bền vững... | Mạng rất nhỏ, chỉ dùng 2 lớp (PersLay cộng một lớp fully-connected sau chuẩn hóa batch), và tác giả nói rõ chọn kiến trúc đơn giản để tạo ra hiểu biết chứ không nhằm đạt điểm cao nhất; cấu hình từng kênh được... | Bảng 1 (ORBIT, độ chính xác $\pm$ độ lệch chuẩn): trên ORBIT5K, Persistence Scale Space Kernel đạt 72,38 ( $\pm 2,4$ ), Persistence Weighted Gaussian Kernel 76,63 ( $\pm 0,7$ ), Sliced Wasserstein Kernel 83,6 ( $\pm 0,9$ ), Persistence Fisher Kernel...<br><i>ORBIT5K và ORBIT100K chia ngẫu nhiên 70% huấn luyện và 30% kiểm thử rồi báo cáo độ chính xác kiểm thử trung bình trên 100 lần chạy (làm giống Le và...</i> | <b>không</b> |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                               | Mô hình                                                                                                                                                                                                             | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | So được?     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| p25 | Anirudh 2020<br>Bài giải quyết nút thắt lớn nhất của TDA khi dùng trong học sâu: việc tính Persistence Diagram rồi chuyển thành...       | Signal PI-Net gồm 4 lớp Conv1D với 128, 256, 512 và 1024 bộ lọc, hạt nhân 3, kèm BatchNorm, ReLU và MaxPool, kết thúc bằng global-average-pooling và lớp Dense kích thước 2500 x n rồi reshape thành 50 x 50 x...   | F1 có trọng số trên GENEactiv với khung 250 bước: MLP-PI 46,45 ± 0,32; MLP-Signal PI-Net 49,47 ± 0,69; MLP-SF 41,70 ± 0,41; CNN 1D 53,56 ± 0,31; CNN 1D + PI 54,28 ± 0,23; CNN 1D + Signal PI-Net 54,41 ± 0,21; với khung 500 bước,...<br><i>Giao thức không đồng nhất giữa hai bộ dữ liệu và đây là điểm yếu nghiêm trọng nhất: với GENEactiv, khoảng 75% khung được dùng để huấn luyện và phần...</i> | <b>không</b> |
| p26 | Renata 2023<br>Đây là bài tự phân biện mạnh nhất trong cộng đồng TDA: đồng điều bền vững (PH) đã được dùng thành công ở hàng trăm ứng... | PH không phải mạng neural nên không có số tham số; bộ phân loại và hồi quy là SVM/SVR của sklearn với C thuộc {0,001; 1; 100}, tìm tham số bằng GridSearchCV 3 fold. Các đường cơ sở gồm SVM trên ma trận khoảng... | Đếm số lỗ hổng, độ chính xác trên dữ liệu gốc: PH 1,00; PH simple 0,94; ML 0,67; NN nông 0,53; NN sâu 0,50; PointNet 1,00 — nhưng khi tịnh tiến, PointNet sụp còn 0,20 trong khi PH giữ 1,00, khi xoay PointNet còn 0,74, và với...<br><i>Vì là dữ liệu tổng hợp nên không có khái niệm chủ thể hay bệnh nhân và không có nguy cơ rò rỉ dữ liệu kiểu tách theo chủ thể; họ chia ngẫu nhiên...</i>       | <b>không</b> |

**Nhúng trể và chọn tham số**

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                                 | Mô hình                                                                                                                                                                                                               | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | So được? |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| p27 | Quoc 2019<br><br>Đây là bài TDA cho chuỗi thời gian 1 chiều, gần với miền dữ liệu của nhóm nhất trong ba bài: để dùng TDA cho chuỗi...     | Không phải mạng neural mà là SVM trên hạt nhân PD ba chiều, nên không có tham số học được theo nghĩa mạng, và bài không nêu số tham số cũng không nêu kích thước mô hình. Siêu tham số gồm $K = 10$ giá trị độ trễ... | Độ chính xác phân loại (%) của delay-variant so với single-delay: ECG200 90,0 so với 87,0 (1NN Euclid và 1NN DTW cùng 88,0); ECG5000 93,6 so với 92,1; ECGFiveDays 99,9 so với 92,0; TwoLeadECG 99,4 so với 94,0; EigenWorms 83,1 so...<br><br><i>Với Hes1, họ chia ngẫu nhiên 50/50, lặp 100 lần chia và báo cáo độ chính xác trung bình — hợp lệ vì 1.000 tế bào là các mô phỏng độc lập; với tám bộ...</i>                | một phần |
| p28 | Eugene 2023<br><br>Đây là bài tổng quan kèm đề xuất phương pháp thuộc lĩnh vực hệ động lực phi tuyến, không phải công trình y sinh: khi... | SToPS bản thân không phải mô hình học máy mà là thuật toán chọn tham số, không có tham số huấn luyện; bộ dữ báo dùng để kiểm chứng là mạng truyền thẳng 4 lớp với kiến trúc 3:128:128:3, kích hoạt ReLU,...           | Về phát hiện thang thời gian: với chuỗi tổng sóng sin (kỳ vọng $\tau = 250, 50, 8$ ), thông tin tương hỗ chỉ tìm được thành phần tần số cao nhất, PECUZAL chỉ ra một độ trễ sai $\tau = 341$ và MDOP ra $\tau = (241, 42, 271, 180)$ với chỉ hai giá...<br><br><i>Không có khái niệm tách theo chủ thể hay tách theo bản ghi vì không có đối tượng, chỉ có ba chuỗi tín hiệu; giao thức là dùng nửa đầu chuỗi để huấn...</i> | không    |

TDA cho tín hiệu tim

tiếp trang sau



Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                                  | Mô hình                                                                                                                                                                                                            | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | So được? |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| p29 | Yonglian 2023<br>Bài giải bài toán đánh giá chất lượng tín hiệu ECG cho thiết bị đeo, tức phân loại nhị phân một đoạn ECG là ”chấp nhận...” | GoogLeNet (Inception v1) dùng học chuyển tiếp; bài không nêu số tham số. Bài cũng không nêu số epoch, learning rate, batch size, bộ tối ưu, cách thay lớp đầu ra, số lớp đóng băng, thư viện tính đồng điều bền... | Trên bộ 12 chuyển đạo, SubLevel-Set tốt nhất với mAcc $98,04 \pm 0,11$   F1 $98,40 \pm 0,06$   Se $97,15 \pm 0,11$   Sp $98,93 \pm 0,23$ (Acc 97,70), còn Vietoris-Rips giảm dần theo cửa sổ từ mAcc $95,16 \pm 0,20$ ở 1 giây xuống $93,11 \pm 0,19$ ; 91,75...<br><i>Kiểm định chéo 10 mảnh với nguyên văn ”All the segments were randomly divided into 10 groups”, tức chia ngẫu nhiên theo đoạn, không tách theo chủ...</i> | một phần |
| p30 | Meryll 1906<br>Bài giải bài toán phát hiện và phân loại loạn nhịp tim từ ECG người lớn, với trọng tâm không phải điểm số mà là khả...       | Mạng nơ-ron mô-đun đa kênh gồm các kênh CNN 1 chiều và MLP nối vào một mạng kết nối đầy đủ chung, cộng một bộ tự mã hóa 6 lớp ẩn (đầu vào 400, không gian ẩn 20); bài không nêu số tham số. Bài cũng không nêu...  | Mọi con số đều là độ chính xác có trọng số chứ không phải F1: phát hiện loạn nhịp nhị phân đạt 98% trên tập kiểm định và 90% trên bệnh nhân mới, còn phân loại 13 lớp đạt 97,3% kiểm định và 80,5% kiểm tra — khoảng cách 8 điểm và...<br><i>Điểm mạnh nhất của bài là kiểm định chéo theo bệnh nhân: tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra là các bệnh nhân khác nhau và được hoán vị qua toàn...</i>                          | một phần |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình                                                                                                                                   | Mô hình                                                                                                                                                                                                                    | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | So được? |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| p31 | Yu-Min 1908<br><p>Bài đặt câu hỏi liệu có thể dùng đồng điều bền vững để định lượng biến thiên nhịp tim (HRV) hay không: nhóm tác giả...</p> | <p>SVM nhân tuyến tính, dùng hàm fitcsvm mặc định của Matlab 2014b; khi có hơn 2 lớp thì dùng ECOC một-đối-một qua hàm fitcecoc mặc định. Đây không phải mạng nơ-ron nên không có khái niệm "số tham số huấn luyện..."</p> | <p>Bài toán Thức vs Ngủ, huấn luyện trên CGMH-training (Bảng 1): trên CGMH-validation đạt <math>SE\ 70,9 \pm 16,0\%</math>, <math>SP\ 78,9 \pm 5,4\%</math>, <math>Acc\ 75,8 \pm 4,4\%</math>, <math>PR\ 38,1 \pm 19,6\%</math>, <math>F1\ 0,452 \pm 0,140</math>, <math>AUC\ 0,824 \pm 0,090</math>, <math>Kappa\ 0,322 \pm 0,123</math>; trên DREAMS đạt...<br/> <i>Kiểm định chéo cơ sở dữ liệu (cross-database validation) — mạnh hơn cả tách theo chủ thể: huấn luyện trên một cơ sở dữ liệu và kiểm tra trên toàn bộ...</i></p> | một phần |
| p32 | Andy 2025<br><p>Đây là một nghiên cứu mô tả chứ không phải bài toán học máy: nhóm tác giả nhúng chuỗi khoảng RR của trẻ em từ 1 tháng...</p> | <p>Bài không có mô hình học máy nào: không có mạng nơ-ron, không có bộ phân loại, không có số tham số. Toàn bộ "mô hình" chỉ là Ripser (Python) tính sơ đồ bền vững cùng persistence landscape và các kiểm định...</p>     | <p>Chỉ số HRV cổ điển (Bảng 2, trung vị [khoảng tứ phân vị]): Mean RR tăng đơn điệu từ 404 ms [395-417] ở sơ sinh lên 674 ms [669-680] ở thiếu niên, SDNN từ 62,9 ms [57-66] ở sơ sinh xuống thấp nhất 36,7 ms ở nữ nhi muộn rồi lên...<br/> <i>Bài không có giao thức đánh giá học máy: không chia train/test, không tách theo chủ thể, không tách theo bản ghi, không chia ngẫu nhiên — đơn giản...</i></p>                                                                                                                         | không    |

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình   | Mô hình                                                                                                                                                                                                                       | Kết quả và giao thức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | So được?    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| p33 | Alperen 2021 | Bốn bộ phân loại cổ điển từ<br>scikit-learn: Random Forest và<br>AdaBoost Decision Tree với 100<br>cây và độ sâu tối đa 5; Support<br>Vector Classifier nhân tuyến tính<br>với tham số điều chuẩn $C = 0,1$ ;<br>và Linear... | WESAD ba lớp (Bảng 2, tách theo<br>chủ thể, cửa sổ 60 giây): gộp tất cả<br>kênh với SVC và dùng tất cả sơ đồ đạt<br>81,35% độ chính xác, F1 73,44% (bản<br>gốc WESAD 79,57%); riêng từng kênh<br>thì ECG 76,27% (nhúng trễ) và 72,72%<br>(tất cả sơ...<br><i>Tách theo chủ thể</i><br><i>(leave-one-subject-out</i><br><i>cross-validation)</i> cho tất cả các bộ<br>dữ liệu — huấn luyện trên tất cả mọi<br>người trừ một, kiểm tra trên người... | một<br>phần |

3.3. Đối thủ mạnh nhất mà nhóm phải nêu

Trong quá trình rà soát, nhóm phát hiện một công trình **chưa có trong danh mục ban đầu** và phải bổ sung, vì nó là đối thủ trực tiếp mạnh nhất:

Jaeger KM, Nissen M, Rahm S, Titzmann A, Fasching PA, Beilner J, Eskofier BM, Leutheuser H. **Power-MF: robust fetal QRS detection from non-invasive fetal electrocardiogram recordings.** *Physiological Measurement* 45(5):055009, 2024. DOI 10.1088/1361-6579/ad4952. Mã nguồn mở tại [github.com/mad-lab-fau/fecg-benchmarking](https://github.com/mad-lab-fau/fecg-benchmarking).

Power-MF đạt F1 **99,5% ± 0,5%** trên ADFECG B1 (thai kỳ) và **98,0% ± 3,0%** trên ADFECG B2 (chuyển dạ), cùng dung sai 50 ms. Đáng chú ý, đây là phương pháp **xử lý tín hiệu cổ điển** chứ không phải học sâu: lọc đạo hàm, khử ECG mẹ bằng SVD và ICA, chọn kênh theo mật độ phổ công suất, rồi dò bằng bộ lọc phù hợp.

Vì sao Power-MF không đối chiếu trực tiếp được, và điều nhóm đã học từ họ

Power-MF dùng **bốn kênh** (cần đa kênh để chạy SVD/ICA khử mẹ) trên bộ Silesia B1/B2 ở 500 Hz với 10 và 12 bản ghi. Mô hình của nhóm là **đơn kênh** trên 5 bản ghi ADFECGDB công khai ở 1000 Hz. Khác cả cấu hình đầu vào lẫn tập dữ liệu, nên không đặt cạnh nhau được.

Nhưng nhóm đã **mượn và kiểm chứng** quy tắc chọn kênh theo mật độ phổ công suất của họ. Kết quả ở §5.3 là một trong những phát hiện quan trọng nhất của đề cương này.

**Cập nhật bản 3.4:** Power-MF **đã được chạy lại thật** qua GNU Octave và đặt cạnh mô hình của nhóm trên **cả 22 chủ thể** với cùng bộ chấm — xem §5.7. Hơn nữa, nhóm tự cài lại Power-MF ở chế độ **đơn kênh**, để lần đầu có một so sánh trong đó *chỉ* thuật toán lỗi khác nhau. Đoạn “không đối chiếu trực tiếp được” ở trên chỉ còn đúng với **con số đã công bố**, không còn đúng với thuật toán.

### 3.4. Năm công trình bổ sung trong vòng rà soát thứ ba, và điều chúng buộc nhóm phải sửa

Vòng rà soát ngày 11–12/09/2026 (survey/scout\_novelty.md) tìm thêm năm công trình mà bản 3.2 **không** trích dẫn. Bốn trong số đó **chiếm mất** một phần tuyên bố “đầu tiên” của nhóm. Nhóm bổ sung và định vị lại.

**Bảng 6:** Năm công trình bổ sung và hệ quả với từng tuyên bố của nhóm.

| Công trình                                                                                                                          | Nội dung liên quan                                                                                                                            | Hệ quả với đề tài                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andreotti, Behar, Zaunseder, Oster, Clifford 2016, <i>Physiol Meas</i> 37(5):627. DOI 10.1088/0967-3334/37/5/627                    | Stress-test 145,8 giờ tín hiệu tổng hợp; chứng minh lựa chọn tiền xử lý <b>đảo thứ hạng</b> các thuật toán trích fECG                         | <b>Luận điểm “front-end quan trọng hơn” đã có từ 2016</b> , ở dạng định tính. Nhóm <b>tiếp nối</b> và thêm con số trên dữ liệu thật                                                                 |
| Andreotti và cộng sự 2017, <i>IEEE TBME</i> . DOI 10.1109/TBME.2017.2675543                                                         | Chỉ số chất lượng tín hiệu fECG (fSQI) cho chính bài toán này                                                                                 | <b>Công từ chối KHÔNG phải ý tưởng mới của nhóm</b> . Điểm mới còn lại: đánh giá <b>xuyên hệ ghi</b> , zero-shot, kèm đường cong rủi ro–độ phủ                                                      |
| Fotiadou, van Sloun, van Laar, Vullings 2021, <i>Physiol Meas</i> 42(4):045007. DOI 10.1088/1361-6579/abf7db                        | CNN-LSTM giãn nở kiểu inception cho nhịp tim thai; <b>quét tốc độ giãn nở</b> (1, 4, 8), kết luận đối giãn nở tốt hơn đối kích thước hạt nhân | <b>“Trường tiếp nhận là biến kiến trúc quan trọng nhất” đã có</b> , trong chính lĩnh vực fECG và chính tạp chí nhóm nhắm tới                                                                        |
| Zahid, Kiranyaz, Ince và cộng sự 2022, <i>IEEE TBME</i> 69(1):119–128. DOI 10.1109/TBME.2021.3088218                                | Phát biểu lại dò đỉnh R thành <b>phân đoạn 1 chiều theo từng mẫu</b> : ánh xạ ECG sang chuỗi xung, mỗi xung tâm tại đỉnh R                    | <b>Đầu ra theo từng mẫu đã có</b> . Gaussian $\sigma = 12$ ms là <b>làm mượt nhãn</b> , không phải phát biểu bài toán mới                                                                           |
| Huang, Zhang, Li và cộng sự 2025 (TCGAN), <i>IEEE JBHI</i> . DOI 10.1109/JBHI.2024.3524085                                          | Mạng đối sinh tích chập theo thời gian, <b>đơn kênh bụng</b> , dò fQRS; báo PPV 99,02 % trên dữ liệu thật                                     | <b>Đối thủ trực tiếp nhất, đang đúng tạp chí mục tiêu, và bản 3.2 không trích dẫn</b> . Không dùng làm baseline được (đầu ra là dạng sóng, không phải vị trí fQRS) nhưng <b>bắt buộc phải trích</b> |
| Baldazzi & Pani 2023, chương <i>Open Data: Valuable Resources and Opportunities...</i> , Springer. DOI 10.1007/978-3-031-32625-7_12 | Nêu rõ bộ dữ liệu của Matonia và cộng sự “ <i>shares signals with ADFECGDB</i> ”                                                              | <b>Sự kiện trùng lặp ADFECGDB ↔ Silesia đã in trong sách</b> . Cái mới của nhóm chỉ là <b>định danh từng bản ghi</b> bằng tương quan chéo (§5.8)                                                    |

**Nhóm định vị lại đề tài: TIẾP NÓI, không phản bác**

Bản 3.2 viết như thể đề tài “phản bác cách làm của cả một dòng công trình”. Sau vòng rà soát này, phát biểu đó **bị rút**. Andreotti 2016 và Behar 2014 đã nói đúng điều nhóm đo được, chỉ là nói định tính và trên dữ liệu tổng hợp. Đề tài này **tiếp nối** họ:

- Từ Andreotti 2016 (tiền xử lý đảo thứ hạng, định tính, tổng hợp) → nhóm: **phân rã ba tầng định lượng, dữ liệu thật, cùng một giao thức, mức chủ thể**.

- Từ Andreotti 2017 (fSQI trong miền) → nhóm: **cổng từ chối đánh giá xuyên hệ ghi, zero-shot, kèm đường cong rủi ro–độ phủ và AUROC trong bản ghi.**
- Từ Behar 2014 (cổng bSQI, hợp nhất) → nhóm: cùng cơ chế, ở cấu hình **đơn kênh.**

Điều duy nhất nhóm còn gọi là **mới**: chưa công trình nào ghép **ba tầng** front-end / ngữ cảnh / kiến trúc vào **một** thí nghiệm duy nhất trong fECG. Đó là C2, và đó là trục của bài báo.

### 3.5. Nhóm học được gì từ từng công trình

**Bảng dưới đây giữ nguyên *nhận xét* của vòng đọc đầu, nhưng số đã rút thì đã sửa**

Bảng “bài học từng công trình” là bản ghi chép tại thời điểm đọc (tháng 9/2026, bản 3.1). Nhóm **giữ nguyên phần nhận xét** để thấy được nhóm đã nghĩ gì ở từng thời điểm, nhưng **đã thay mọi con số đã bị rút** bằng con số đúng (sửa ngày 12/09/2026, bản 3.4) — một bảng lịch sử không được phép trở thành chỗ trú cho số liệu sai. Ba điểm phải đọc kèm:

- Con số **77,34** cho CinC 2013 mà vòng đọc đầu dùng là con số trên **mẫu 10 bản ghi** với quy tắc kênh 0 hậu kiểm, và nó **đã bị rút**. Con số đúng là **71,21** (mô hình 5 ca) và **79,40**  $\pm 29,18$  (mô hình 22 ca) trên toàn bộ 75 bản ghi, quy tắc PSD mù nhãn — §5.10.3. Các ô liên quan trong bảng dưới đã được thay bằng 79,40 ở bản 3.4; **bản 3.5 rút tiếp con số 79,40** (15/75 bản là bản sao ADFECGDB — số đúng 74,28 trên 60 bản sạch, hợp đầu §5.10.3); các ô 75 bản trong bảng lịch sử này giữ nguyên để đối chiếu.
- So sánh với Orvas 2025 (CUNet,  $77,8 \pm 18,6$ ) **vẫn không đối chiếu được**: hai bên không cùng số bản ghi và không cùng giao thức. Chênh lệch 1,60 điểm ghi trong bảng chỉ là chênh lệch số học, không phải kết luận hơn kém. Phải chạy lại so sánh đó trên cùng tập trước khi dùng.
- Kiểm tra chồng lán ADFECGDB  $\leftrightarrow$  CinC 2013 mà nhiều dòng trong bảng yêu cầu: **đã làm** cho Silesia (§5.8), **chưa làm** cho CinC 2013. Đây là việc còn nợ.

**Bảng 7:** Điều nhóm rút ra được từ từng công trình và điều đó đòi hỏi trong thiết kế của nhóm.

| Mã              | So với mô hình của nhóm | Bài học áp dụng |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Học sâu dò fQRS |                         |                 |

*tiếp trang sau*

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã  | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p01 | Không so sánh trực tiếp được ở mức con số vì đơn vị phân tích khác hẳn: Zhong tính F1 trên cửa sổ 100 ms đã cân bằng lớp, còn FetalQRS-TCN tính F1 trên nhịp tim với khớp $\pm 50$ ms; dù vậy bài vẫn là mốc đối chiếu quan trọng theo ba hướng. Về kiến trúc, Zhong dùng CNN 1D ba lớp với bộ lọc dài 3 nên tổng trường tiếp nhận chỉ vài chục mili giây trên đầu vào 100 ms, trong khi mô hình của nhóm có trường tiếp nhận 1.516 ms và khảo...  | Áp dụng: đưa Zhong 2018 vào bài báo của nhóm như bằng chứng nguồn gốc cho luận điểm "tiền xử lý quan trọng hơn kiến trúc" (họ dùng 0,5–100 Hz, dài mà khảo sát của nhóm cho thấy mất 18,89 điểm F1 so với 10–60 Hz), học cách họ liệt kê rõ bản ghi của từng tập (a01–a07 kiểm thử, a08–a13 validation, 55 bản ghi còn lại huấn luyện) để nhóm cũng liệt kê bản ghi của từng fold tách theo bản ghi, và coi ý tưởng dùng SampEn làm chỉ số...     |
| p09 | Không so sánh trực tiếp được: họ có dùng ADFECGDB nhưng chỉ để tính AUC mức IMF (0,9282) và không bao giờ báo cáo F1 dò đỉnh R thai trên bộ này, nên không có con số nào đối chiếu được với macro F1 97,43 (tách theo bản ghi, 4 kênh) hay 99,18 (kênh tốt nhất) của mô hình của nhóm; hơn nữa họ không nêu dung sai ms nên dù có số cũng không biết họ đo ở $\pm 50$ ms hay rộng hơn. Về quy mô đánh giá và chi phí tính toán thì mô hình của...  | Nên trích dẫn bài này làm bằng chứng độc lập cho luận điểm "tiền xử lý quan trọng hơn kiến trúc": họ khởi đầu bằng dải thông rộng 0,1–100 Hz nhưng đầu ra cuối cùng lại là Butterworth bậc 4 zero-phase 10–60 Hz, đúng dài mà nhóm chọn sau khi quét 8 dải (10–60 Hz thắng với 91,06), và họ cũng ghi nhận năng lượng QRS thai tập trung khoảng 8–45 Hz - khác biệt là một bài Sensors 2026 tìm ra dải này bằng tay còn nhóm chứng minh định...   |
| p10 | Không so sánh trực tiếp được, và mô hình của nhóm mạnh hơn rõ rệt ở mọi trục quan trọng: đơn vị phân tích khác hẳn (họ đánh giá trên ô 100 ms có tính cả ô âm, nhóm đánh giá trên nhịp với dung sai $\pm 50$ ms, nên 96,79% accuracy của họ và macro F1 97,43 của nhóm là hai đại lượng khác loại, đặt cạnh nhau là nguy hiểm), họ dùng 4 kênh đồng thời còn nhóm dùng 1 kênh nên bài toán của nhóm khó hơn hẳn, họ chia ngẫu nhiên có xáo trộn... | Bài này là ví dụ để nhóm viết một đoạn về "tại sao giao thức đánh giá quan trọng hơn con số" trong phần Related Work hoặc Discussion, nêu đích danh rằng một bài Scientific Reports 2025 báo cáo 98,36% accuracy nhưng đầu vào là 4 kênh chứ không phải 1 kênh, cửa sổ chồng lấp 90% rồi xáo trộn trước khi chia, và đơn vị là ô 100 ms chứ không phải nhịp; đồng thời nên chỉ rõ rằng dùng khung 100 ms để xấp xỉ dung sai $\pm 50$ ms là một... |

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã                             | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p12                            | Không so sánh trực tiếp được vì bốn lý do độc lập: họ dùng 12 kênh đồng thời còn nhóm dùng 1 kênh; họ phân loại nhị phân đoạn 65 ms còn nhóm định vị định với dung sai $\pm 50$ ms nên bài toán của nhóm khó hơn; nhân chuẩn của họ là đầu ra thuật toán BSSR còn nhóm dùng ECG da đầu của ADFECGDB là tiêu chuẩn vàng thực sự; metric của họ là accuracy trên tập mất cân bằng chứ không phải macro F1 của lớp đỉnh. Nếu buộc phải đặt cạnh...          | Nên sao chép cách phân tầng kết quả của họ (theo tuổi thai, BMI mẹ, có hay không biến chứng mẹ), bổ sung phân tích Bland-Altman kèm tương quan Pearson cho nhịp tim thai vì nhóm sẽ dễ dàng vượt xa $r = 0,56$ , thêm hậu xử lý lọc nhịp kiểu SD-ROM lên chuỗi RR, và làm nổi bật việc nhóm báo cáo 113.481 tham số, 0,48 MB, 4,35 ms trong khi bài Q1 năm 2024 này không báo cáo gì về chi phí tính toán. Phải tránh việc dùng accuracy làm...                                                             |
| Tách nguồn / tái tạo dạng sóng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| p03                            | Trên cùng bộ ADFECGDB và cùng kiểu giao thức bỏ một đối tượng, họ đạt F1 $99,7 \pm 0,4\%$ ở dung sai 30 ms, còn nhóm đạt 99,18% (Se 99,59, PPV 98,79) trên kênh lâm sàng tốt nhất và $97,43 \pm 4,37\%$ trên toàn bộ 4 kênh ở dung sai 50 ms; vì mỗi bản ghi ADFECGDB là một sản phụ nên tách theo bản ghi của nhóm tương đương tách theo chủ thể của họ, do đó họ nhìn hơn nhóm (khoảng 0,5 điểm trên kênh tốt nhất, khoảng 2,3 điểm trên trung bình... | Áp dụng ngay: bổ sung báo cáo kết quả ở dung sai 30 ms bên cạnh 50 ms cho tất cả thực nghiệm để đặt cạnh trực tiếp con số 99,7% và 94,7% của họ (nếu chỉ báo cáo 50 ms, phản biện Q1 sẽ nói nhóm chọn dung sai để đẹp số), bổ sung khoảng tin cậy 95% cho macro F1 theo chuẩn STARD/TRIPOD thay vì chỉ có trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn, đưa con số 94,7% xuyên bộ dữ liệu của họ vào bảng so sánh và giải thích thẳng thắn vì sao 79,40 % (75 bản ghi; con số 77,34 trên mẫu 10 bản ghi đã bị rút) của... |
| p04                            | Không so sánh trực tiếp được vì ba lý do độc lập mà mỗi lý do đều đủ phá vỡ phép so sánh: họ dùng 4 kênh bụng làm đầu vào bộ sinh còn FetalQRS-TCN dùng đơn kênh, nên 96,4% của họ là kết quả của một bài toán dễ hơn hẳn; giao thức 5-fold không nêu cách nhóm và bằng chứng số học ở Bảng 5 (nhịp thật giống hệt nhau ở cả 5 fold) chỉ rất mạnh tới việc chia ngẫu nhiên theo đoạn trên dữ liệu gộp, tức là có rò rỉ dữ liệu, trong khi...             | Áp dụng: dùng con số 0,762 triệu tham số của họ làm mốc đối chiếu chính cho luận điểm hiệu quả tính toán của nhóm (FetalQRS-TCN chỉ bằng 1/3 một bộ sinh của họ và 1/6,7 toàn mạng mà vẫn không cần fECG da đầu làm nhân), học cách họ báo cáo chi phí tính toán với phần cứng cụ thể (Xeon 4 nhân 8 luồng 2,0 GHz, 25 GB RAM, Tesla T4 16 GB), số tham số tách riêng từng thành phần và thông lượng (1.740 giây tín hiệu / 73 giây) rồi bỏ...                                                              |

tiếp trang sau



Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã  | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p05 | Không so sánh trực tiếp được hoàn toàn, nhưng đây là công trình gần nhất với giao thức của nhóm ta và là mốc so sánh đáng tin nhất trong ba bài: cùng dung sai 50 ms, cùng cửa sổ 4 giây (họ tìm ra 4 giây là tối ưu bằng thực nghiệm, trùng khớp với kết quả quét trường tiếp nhận của nhóm ta là bảo hoà quanh 1,5 s), cùng định hướng một kênh và cùng cách chọn kênh tốt nhất. Hai con số không thể đặt cạnh nhau vì khác tập dữ liệu và...       | Nên chạy ngay thí nghiệm ưu tiên số một là huấn luyện chính FetalQRS-TCN trên FECGSYNDB (145,8 giờ, 250 Hz, đúng tần số nhóm ta đang dùng nên không cần lấy mẫu lại) rồi đo trên ADFECGDB và CinC 2013 mà không tinh chỉnh, kèm ba kiểu tăng cường dữ liệu của họ (jittering với công suất nhiễu thấp hơn năng lượng QRS thay 3 dB, cắt ngẫu nhiên theo phân phối Beta, che thời gian–tần số chỉ trên các ô dưới 50 Hz) vốn mang lại +4,35...           |
| p06 | Không so sánh trực tiếp được, vì con số 99,17% trên ADFECGDB của họ được tạo ra sau khi tinh chỉnh trên chính bộ ADFECGDB, còn $97,43 \pm 4,37$ (toàn bộ 4 kênh) và 99,18 (kênh tốt nhất) của nhóm ta là kết quả tách theo bản ghi, trong đó mọi bản ghi kiểm thử đều chưa từng xuất hiện khi huấn luyện; đặt hai con số cạnh nhau là so một kết quả có thể có rõ ràng với một kết quả sạch, về nguyên tắc không được làm. Thêm ba khác biệt: dung... | Nên học ba điểm: báo cáo kết quả theo từng bản ghi như Bảng 2 và Bảng 5 của họ (R01, R04, R07, R08, R10 riêng từng dòng) thay vì chỉ báo cáo macro F1 $97,43 \pm 4,37$ vì độ lệch chuẩn 4,37 đang giấu đi bản ghi yếu; báo cáo F1 ở cả ba mức dung sai — 50 ms (chuẩn CinC, để so sánh), 31,25 ms (để đối chiếu với bài này) và 150 ms (AAMI EC57) — thành một bảng độ nhảy theo dung sai, vì với jitter chỉ 3,05 ms của FetalQRS-TCN thì nhóm...       |
| p07 | Đây là mốc so sánh tốt nhất trong ba bài và đối chiếu được một phần, vì bốn tham số trùng khớp hoàn toàn với FetalQRS-TCN: dung sai 50 ms, đầu vào một kênh, cửa sổ khoảng 4 giây và tần số làm việc 250 Hz. Khác biệt nằm ở nguồn huấn luyện và đơn vị phân tích: họ huấn luyện 100% trên dữ liệu tổng hợp rồi kiểm thử zero-shot còn nhóm ta huấn luyện tách theo bản ghi trong nội bộ ADFECGDB, nên 96,52% của họ và $97,43 \pm 4,37$ của...       | Thí nghiệm ưu tiên số một là huấn luyện FetalQRS-TCN trên dữ liệu tổng hợp FECGSYN theo đúng công thức của bài này — 55.000 đoạn chia theo SINR thành ba nhóm (20.000 chất lượng cao với SINR_f trong $[-5; 0]$ , 25.000 trung bình với SINR_f trong $[-15; -5]$ , 10.000 thấp với SINR_f trong $[-25; -15]$ ), các kịch bản sinh lý và nhiễu MA/BW/EM, trong đó nhóm ta có thể dùng cả 7 kịch bản của FECGSYNDB thay vì 3 (thêm co thắt tử cung C3,... |

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã                            | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p11                           | <p>Đây là bài duy nhất trong ba bài so sánh trực tiếp được với mô hình của nhóm, và kết quả gần như ngang nhau: CUNet đạt F-score <math>77,8 \pm 18,6</math> trên CinC 2013 zero-shot không tinh chỉnh, còn nhóm đạt <math>79,40 \pm 29,18</math> trên <b>toàn bộ 75 bản ghi</b> CinC 2013 set-a, xuyên bộ dữ liệu không tinh chỉnh (con số <math>77,34 \pm 28,54</math> của các bản trước đo trên mẫu 10 bản ghi và <b>đã bị rút</b>), chênh lệch 1,60 điểm — nhưng độ lệch chuẩn của nhóm lớn gần gấp đôi nên không kết luận được hơn kém, với các điều kiện khớp nhau về dung sai <math>\pm 50</math> ms, đơn vị phân tích là nhịp, công thức <math>F\text{-score} = 2TP/(2TP+FN+FP)</math>, đầu vào...</p> | <p>Đây là mốc chuẩn chính xác nhất mà nhóm cần: hãy đưa con số <math>77,8 \pm 18,6</math> của Orvas 2025 vào bảng so sánh của nhóm ngay cạnh <math>79,40 \pm 29,18</math> (75 bản ghi), kèm ghi chú rõ ràng là cùng <math>\pm 50</math> ms, cùng đơn kênh, cùng zero-shot trên CinC 2013 - điều này biến con số 79,40 từ chỗ "có vẻ thấp" thành "ngang bằng trình độ hiện tại năm 2025", đồng thời nên bổ sung chỉ số HRerr (bpm) vì đó là sai số nhịp tim thai mà bác sĩ thực sự quan tâm và cho phép so...</p> |
| <b>Xử lý tín hiệu cổ điển</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| p16                           | <p>Không so sánh được, và lý do rất quan trọng về mặt khái niệm vì đây không phải cùng một bài toán: FetalQRS-TCN là bộ dò đỉnh (đầu vào là tín hiệu, đầu ra là vị trí FQRS, đo bằng F1 với dung sai 50 ms) còn par-EKS là bộ tách/tăng cường tín hiệu cần sẵn vị trí đỉnh R thay làm đầu vào, nên mô hình của nhóm có thể dùng làm đầu vào cho par-EKS chứ không cạnh tranh với nó; nếu phản biện hỏi vì sao không so với Niknazar 2013 thì...</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Dùng bài này làm ví dụ điển hình trong phần tổng quan về việc phần lớn công trình đơn kênh không báo cáo chỉ số phát hiện đỉnh chuẩn hóa, với cách viết bám sát văn bản gốc rằng Niknazar và cộng sự (2013) báo cáo mức cải thiện SNR trên 20 dB trên dữ liệu tổng hợp nhưng không báo cáo Se/PPV/F1 trên dữ liệu lâm sàng, khiến kết quả của họ không thể đối chiếu trực tiếp với các bộ dò đỉnh; đồng thời khai thác hướng mở rộng ghép...</p>                                                              |
| p17                           | <p>Đây là bài so sánh trực tiếp được nhất trong ba bài vì cùng bộ dữ liệu ADFECGDB, cùng dung sai 50 ms, cùng công thức F1 và thực sự đơn kênh: trên ADFECGDB với tất cả các kênh, Castillo đạt 94,11% (17/20 tín hiệu, trong mẫu) so với <math>97,43 \pm 4,37</math> của FetalQRS-TCN (tách theo bản ghi, 20 đánh giá trên đủ 4 kênh) nên nhóm cao hơn khoảng 3,3 điểm và giao thức của nhóm nghiêm ngặt hơn, còn ở kênh tốt nhất là 98,63% so với 99,18 của...</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Nên đưa bài này vào bảng so sánh chính với chú thích đầy đủ (Castillo 2018, ADFECGDB, đơn kênh, dung sai 50 ms, F1 98,04% trên 11 tín hiệu do bác sĩ chọn và 94,11% trên 17 tín hiệu, không tách theo bản ghi) vì đây là baseline cổ điển mạnh nhất và sát nhất với bài toán của nhóm, đồng thời bắt chước cách báo cáo ba tầng của họ (toàn bộ, nhóm sạch, kênh tốt nhất) kèm thêm cột tỉ lệ đoạn được chấp nhận, thêm bước sửa FP/FN theo...</p>                                                            |

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã                                   | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p19                                  | <p>Không so sánh trực tiếp được, vì bốn lý do độc lập: họ dùng NInFEA riêng tư với 20 thai phụ tuần 21-27 và nhân chuẩn từ Doppler xung còn nhóm dùng ADFECGDB với 5 sản phụ chuyển dạ và nhân chuẩn từ điện cực da đầu thai nhi; độ đo của họ là <math>Acc = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)</math> không rõ cách đếm TN trong khi nhóm báo cáo macro F1, Se và PPV; họ không nêu dung sai khớp nhịp nên không biết khoan dung hơn hay chặt hơn mức <math>\pm 50</math> ms của nhóm;...</p>                | <p>Trích dẫn bài này làm mốc đối chứng cho luận điểm ”1 kênh cộng học sâu” trong phần Related Work (lọc thích nghi đơn tham chiếu chỉ đạt khoảng 68% độ chính xác trên dữ liệu thật dù đã thêm điện cực ngực, trong khi nhóm đạt 97,43% F1 mà không cần điện cực ngực nào), dùng bề rộng QRS thai 40 ms và QRS mẹ 100 ms mà họ dẫn từ Taylor 2003 và Surawicz 2009 để biện minh cho <math>\sigma = 12</math> ms của nhân Gaussian (khoảng <math>\pm 2</math> sigma bằng 48...</p>                              |
| <b>Đôi chuẩn, dữ liệu, thử thách</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| p13                                  | <p>Điểm chung quan trọng nhất là cùng dung sai <math>\pm 50</math> ms và cùng công thức <math>F1 = 2TP/(2TP+FN+FP)</math>, nên con số của Behar và của nhóm nằm trên cùng một thang đo — điều mà rất ít bài trong danh sách đạt được. Tuy vậy chỉ so sánh được một phần:</p> <p>Chương 6 dùng 1 kênh bụng nhưng cộng thêm 1 kênh ngực mẹ còn Chương 7 dùng 4 kênh bụng nên đều nhiều thông tin hơn nhóm; Behar không bao giờ báo cáo F1 riêng cho ADFECGDB vì 25 bản ghi ADFECGDB...</p>          | <p>Việc phải làm ngay là kiểm tra chồng lấn giữa ADFECGDB (r01, r04, r07, r08, r10) và CinC 2013 set-a bằng tương quan chéo tín hiệu hoặc chuỗi RR tham chiếu trước khi công bố con số 79,40 (con số 77,34 trên mẫu 10 bản ghi đã bị rút), vì nếu không kiểm tra thì reviewer Q1 có thể tự phát hiện và bài sẽ bị từ chối vì rò rỉ dữ liệu. Nên trích dẫn Behar làm căn cứ cho dung sai <math>\pm 50</math> ms (AAMI EC57 cho phép 150 ms nhưng đó là ngưỡng cho ECG người lớn, còn nhịp thai nhanh gấp...</p> |
| p14                                  | <p>Bài cùng thang đo với nhóm ở một điểm quan trọng là dung sai <math>\pm 50</math> ms và công thức F1 giống hệt, nhưng chỉ so sánh được một phần vì Behar dùng 4 kênh bụng cộng 5 phương pháp tách chạy song song và cơ chế chọn kênh trong khi nhóm dùng 1 kênh và 1 mô hình duy nhất — đó là lợi thế cấu trúc chứ không phải lợi thế thuật toán — và vì <math>F1 = 96,0\%</math> của ông là trong mẫu trên chính tập quét tham số còn <math>97,43 \pm 4,37</math> tách theo bản ghi của...</p> | <p>Áp dụng ngay với chi phí thấp: hậu xử lý làm mượt RR của Behar (lấy trung vị RR của 5 nhịp trước, chỉ làm mượt khi trung vị nằm trong 110–170 bpm, xoá nhịp cách nhịp trước &lt; 70% trung vị RR và chèn nhịp khi &gt; 175% trung vị RR), cơ chế BCM để loại chuỗi nhịp mẹ bị nhận nhầm thành nhịp thai, notch có điều kiện cho dữ liệu trộn nguồn 50/60 Hz, và hiệu chỉnh đỉnh R mẹ theo từng kênh trong <math>\pm 30</math> ms trước khi trừ mẫu trung vị. Khi...</p>                                     |

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã  | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p15 | Không so sánh trực tiếp được về con số, và đây là điều phải nói rõ trong bài của nhóm: họ đo trên dữ liệu mô phỏng còn nhóm đo trên ADFECGDB lâm sàng thật, F1 99,9% của BSSica là cận trên oracle sau khi chọn kênh tốt nhất theo nhãn chuẩn trong 8 kênh, và BSS cần 8 kênh còn AM cần thêm kênh tham chiếu mẹ trong khi FetalQRS-TCN chỉ cần 1 kênh bụng. Tuy vậy vẫn có những trực so sánh được và có lợi cho nhóm: cùng dung sai 50 ms...                                         | Nên tải FECGSYNDB (miễn phí trên PhysioNet, tần số 250 Hz trùng khớp với tần số đích của pipeline nên nạp thẳng không cần lấy mẫu lại) để chạy FetalQRS-TCN trên 7 kịch bản phi dừng $\times$ 5 mức SNR, luôn báo cáo F1 kèm MAE/jitter thành cặp đúng như tác giả khuyến nghị, báo cáo tỉ lệ đoạn bị loại theo tiền lệ 69,7% xuống 11,6% của họ, và trích dẫn bài này vừa để biện minh cho dung sai 50 ms vừa làm căn cứ cho ý tưởng fSQI (họ viết...                                                                                                                                                                             |
| p20 | So sánh được một phần và theo hướng ngoài ý muốn: bộ dữ liệu thì so sánh được vì đây chính là tập nhóm dùng để đo xuyên bộ dữ liệu ( $79,40 \pm 29,18$ F1 trên toàn bộ 75 bản ghi), nhưng con số thì không so sánh được vì tiêu chí chính thức của CinC 2013 là lỗi FHR tính bằng (nhịp/phút) <sup>2</sup> và lỗi RR tính bằng ms chứ không phải F1 với dung sai 50 ms. Điểm phải sửa ngay trong bài của nhóm là giá định "50 ms là chuẩn CinC 2013" không được bài xã luận gốc này... | Việc đầu tiên là kiểm tra chồng lấn giữa ADFECGDB và CinC 2013 bằng cách đối chiếu từng bản ghi trong tập đang test với 25 bản ghi ADFECGDB có trong cuộc thi, loại bỏ mọi bản ghi trùng rồi tính lại con số $79,40 \pm 29,18$ , và nếu không loại được thì phải ghi rõ cảnh báo trong bài kèm trích dẫn chính câu của Clifford về trường hợp Rodrigues; đồng thời sửa cách trích dẫn dung sai 50 ms sang đúng nguồn (benchmark của Behar) hoặc... <b>[Sửa vòng 7: đã kiểm — 15/75 bản set-a là bản sao ADFECGDB; 79,40 đã rút, số đúng 74,28 trên 60 bản sạch; chính câu cảnh báo của Clifford ở đây là điều nhóm đã bỏ sót.]</b> |
| p21 | So sánh được một phần và đây là bài quan trọng nhất trong ba bài đối với nhóm, vì bộ B2_Labour chứa chính 5 bản ghi ADFECGDB mà nhóm đang dùng (r01, r04, r07, r08, r10), cùng điều kiện chuyển dạ và cùng nhãn chuẩn là FECG trực tiếp từ đầu thai nhi: con số gần nhất để đối chiếu là PCA đạt F1 = 98,56% và ICA đạt F1 = 98,55% trên toàn bộ 12 bản ghi B2 với dung sai $\pm 40$ ms, trong khi mô hình của nhóm đạt macro F1 = $97,43 \pm 4,37$ ...                                | Ưu tiên cao nhất là tải bộ B2 đầy đủ 12 bản ghi từ figshare (DOI 10.6084/m9.figshare.c.4740794, giấy phép CC BY 4.0) để lấy 7 bản ghi chuyển dạ chưa từng nằm trong ADFECGDB làm tập kiểm tra ngoài lý tưởng (cùng phân bố lâm sàng nên loại bỏ được yếu tố khác bộ dữ liệu, nhưng mô hình chưa từng thấy), và tải bộ B1 gồm 10 bản ghi thai kỳ 20 phút tuần 32-42 để mở rộng phạm vi ứng dụng từ chuyển dạ sang trước sinh, với điều kiện...                                                                                                                                                                                      |

## Lý thuyết TDA

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã  | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p22 | Không so sánh trực tiếp được vì ba lý do: bài toán khác hẳn (họ chấm điểm tuần hoàn toàn cục cho cả đoạn tín hiệu, còn nhóm làm định vị đỉnh từng mẫu theo kiểu sequence-to-sequence), dữ liệu khác hẳn (tổng hợp 50 mẫu vô thứ nguyên, không phải ADFECGDB hay CinC 2013), và không có Se/PPV/F1 theo nhịp, không có dung sai $\pm 50$ ms, không có giao thức tách theo bản ghi. Tuy nhiên đây là cơ sở lý thuyết mạnh nhất để bảo vệ phát hiện... | Nên áp dụng: nếu dùng TDA làm chỉ số chất lượng tín hiệu thai (fSQI) thì phải đặt kích thước cửa sổ trượt xấp xỉ một chu kỳ RR thai (khoảng 400-500 ms, tương ứng khoảng 100-125 mẫu ở 250 Hz) chứ không được ngắn hơn — căn cứ là Corollary 6.10 và Prop 5.5 — đồng thời chọn số chiều nhúng $M \geq 2N$ với $N$ là bậc hai cao nhất muốn giữ, chọn số nguyên tố $p > N$ khi tính đồng điều bền vững để tránh hiện tượng xoắn kiểu Möbius, bắt buộc...      |
| p23 | Không so sánh trực tiếp được với FetalQRS-TCN vì miền dữ liệu hoàn toàn khác (đám mây điểm tổng hợp và mặt PDE, không phải ECG bụng), không có Se/PPV/F1 theo nhịp, không có dung sai ms, không có giao thức tách theo bản ghi hay tách theo chủ thể. Tuy nhiên đây là bài báo gốc của biểu diễn mà nhóm đã thử nghiệm và chốt bảng (cnn2d_PersistenceImage đạt 27,42 so với 97,14 của CNN 1D cùng ngân sách tham số), và điểm mẫu chốt để...       | Nên áp dụng: nếu vẫn dùng PI cho fSQI thì phải đóng khung lại thành bài toán một nhãn cho một cửa sổ đúng thiết kế gốc của PI chứ không dùng cho sequence-to-sequence, đồng thời nối PI của H0 và H1 lại với nhau vì bài chứng minh lợi ích lớn (82,5% so với 49,8% khi chỉ H0 và 65,7% khi chỉ H1 trên linked twist map; 97,3% so với 94,7% và 93,3% trên aKS), không cần quét siêu tham số lớn mà có thể cố định $20 \times 20$ và $\sigma = 0,1$ do độ... |
| p24 | Không so sánh trực tiếp được với FetalQRS-TCN vì miền dữ liệu hoàn toàn khác (đồ thị mạng xã hội, phân tử hóa học, quỹ đạo hệ động lực — không có tín hiệu sinh lý), không có Se/PPV/F1 theo nhịp, không có dung sai $\pm 50$ ms, không có tách theo bản ghi hay tách theo chủ thể, và không có số tham số để đối chiếu với 113.481 tham số của nhóm. Ý nghĩa gián tiếp lại rất lớn cho lập luận của nhóm: PersLay là nỗ lực mạnh nhất hiện nay...  | Nên áp dụng: nếu nhóm quay lại TDA cho fSQI thì PersLay là lựa chọn đúng đắn hơn Persistence Image cố định vì lưới trọng số học được còn cho phép diễn giải vùng nào của sơ đồ quan trọng sau huấn luyện (Hình 5 phụ lục) — rất có giá trị cho bài báo Q1 — đồng thời nên xét dùng bền vững mở rộng thay vì bền vững thường vì nó bắt được cả nhánh hướng lên chứ không chỉ đỉnh và mọi điểm có tọa độ hữu hạn (chênh lệch 14,9 điểm trên...                 |

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã                               | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p25                              | Không so sánh trực tiếp được vì khác bài toán (nhận dạng hoạt động và phân loại ảnh chứ không phải dò đỉnh fQRS), khác dữ liệu (gia tốc kế đeo tay và ảnh CIFAR/SVHN, không có ECG bụng), khác chỉ số (F1 có trọng số đa lớp so với macro F1 khớp nhịp $\pm 50$ ms) và không có khái niệm dung sai ms. Tuy vậy bài củng cố gián tiếp kết quả của nhóm: ngay trong một công trình chủ trương dùng TDA, PI dùng một mình (MLP-PI 46,45) vẫn thua xa... | Nếu nhóm vẫn giữ một nhánh TDA cho fSQI thì không nên tính PI bằng thư viện giải tích trong vòng lặp huấn luyện mà tính trực tiếp peak prominence (tương đương H0 lọc theo tập mức), đồng thời có thể mượn cách họ giảm chiều PI bằng PCA xuống 32 chiều rồi nối vào đầu ra global-average-pooling để đưa điểm fSQI vào FetalQRS-TCN mà không làm phồng số tham số. Bảng thời gian của họ (3567 ms cho một ảnh 32 x 32) là bằng chứng định...                    |
| p26                              | Không so sánh trực tiếp được về con số vì khác hoàn toàn bài toán (phân loại hình dạng từ đám mây điểm, không có ECG, không có đỉnh, không có dung sai ms, không có bệnh nhân). Nhưng đây là căn cứ quan trọng nhất để biện minh cho quyết định chuyển hướng của nhóm: bộ hướng dẫn của họ liệt kê đúng ba loại tín hiệu mà PH làm tốt — số chu trình k chiều (lọc alpha, khoảng dài nhất), độ cong (Victoris-Rips, nhiều khoảng ngắn) và...         | Trích bộ hướng dẫn và phân kết luận của Turkes và cs. làm căn cứ học thuật chính thức cho luận điểm "TDA không phù hợp với bài toán dò vị trí đỉnh", đồng thời áp dụng đúng khung ba bước đó cho nhánh fSQI: xác định tín hiệu (có tồn tại vòng lặp tuần hoàn ứng với nhịp tim thai hay không), chọn phép lọc (nhúng trễ để biến tính chu kỳ thành vòng lặp H1), chọn đặc trưng (max persistence hoặc tổng life-time của H1), và dùng lọc...                     |
| <b>Nhúng trễ và chọn tham số</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| p27                              | Chỉ so sánh được một phần: họ có dùng hai bộ ECG thai nhi (NonInvasiveFetalECGThorax1 và Thorax2, mỗi bộ 3.765 chuỗi dài 750 mẫu) và đạt 91,8% và 93,0%, nhưng đó là phân loại 42 lớp hình thái do chuyên gia gán nhãn trên toàn bộ đoạn chuỗi chứ không phải dò vị trí phức bộ QRS thai nhi, không có dung sai ms, không có Se/PPV theo nhịp, không có jitter và không có khái niệm khử ECG mẹ, nên 91,8% của họ và 99,18% macro F1 của...          | Áp dụng trực tiếp cho fSQI: thay vì chọn một độ trễ, hãy quét tau qua một dải rồi xếp chồng thành PD ba chiều — với ECG bụng 250 Hz và nhịp tim thai 120–160 lần/phút (chu kỳ khoảng 375–500 ms, tương ứng 94–125 mẫu), dải tau nên phủ từ khoảng 1/10 đến 1/2 chu kỳ này, cửa sổ phải bao ít nhất 2 chu kỳ (khớp với cửa sổ 4 giây đang dùng), và nên dùng kết hợp hạt nhân $K = \alpha_0 \cdot K_0 + \alpha_1 \cdot K_1$ với $\alpha_0$ chọn bằng kiểm định... |

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

| Mã                          | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p28                         | Không so sánh được về số liệu với mô hình của nhóm vì bài không làm dò đỉnh, không có ECG, không có F1/Se/PPV, không có dung sai theo ms và không có chủ thể để tách theo bản ghi, nhưng lại rất có giá trị làm cơ sở lý thuyết cho quyết định chuyển hướng. Bài chứng minh bằng chính cấu trúc thuật toán rằng muốn có lỗi H1 trong những trẻ 2 chiều thì đoạn tín hiệu phải dài ít nhất $l = 4\tau$ , tức khoảng một chu kỳ đầy đủ, và còn phải... | Nên trích dẫn rằng bước độ dài strand $l = 4\tau$ và rằng bước $N_{hole} \geq 8$ làm căn cứ học thuật cho lập luận "cửa sổ ngắn hơn một chu kỳ tim thì không thể chứa vòng nhịp" khi giải thích vì sao Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng chót bảng (27,42 so với 97,14), đồng thời dùng Bảng I về thời gian tính toán làm dẫn chứng số thật cho phần chi phí; theo heuristic một phần tư chu kỳ, chu kỳ tim thai khoảng 430 ms cho $\tau$ khoảng 107 ms,...  |
| <b>TDA cho tín hiệu tim</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| p29                         | So sánh được một phần và là bài tham chiếu quan trọng nhất cho hướng fSQI, nhưng không so được về con số với FetalQRS-TCN vì nhiệm vụ khác hẳn (họ phân loại chất lượng đoạn 10 giây, nhóm định vị từng đỉnh fQRS với dung sai $\pm 50$ ms), đối tượng khác (ECG người lớn, không có thai nhi và không có bài toán khử ECG mẹ), chỉ số khác (F1 phân loại nhị phân trên đoạn so với F1 dò nhịp có dung sai thời gian), và họ có rò rỉ dữ liệu...     | Nên trích dẫn bài này làm nền cho hướng fSQI vì nó cho thấy đồng điều bền vững có giá trị thật cho bài toán đánh giá chất lượng (mAcc 98,04 bằng SubLevel-Set) trong khi thất bại cho bài toán định vị đỉnh, đồng thời bắt chước cấu trúc bảng đối chiếu với các chỉ số chất lượng kinh điển (bSQI, MS-QI, picaSQI, kSQI, pSQI) và ghi nhận rằng SubLevel-Set — loại lọc nhóm đã chứng minh tương đương peak prominence — vẫn đủ mạnh (97,25...                  |
| p30                         | So sánh được một phần vì cùng lĩnh vực ECG và cùng dùng đồng điều bền vững lọc sublevel-set, nhưng không so được về con số: họ phân loại nhân của một nhịp đã biết vị trí còn nhóm định vị vị trí đỉnh chưa biết, họ không dò đỉnh nên không có dung sai $\pm 50$ ms và không có Se hay PPV theo nghĩa dò nhịp, chỉ số của họ là độ chính xác có trọng số còn của nhóm là macro F1 dò nhịp (hai đại lượng không quy đổi được), và đối tượng là...    | Nên trích dẫn định lý bất biến đường cong Betti làm lập luận trung tâm giải thích vì sao Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng chót bảng 16 kiến trúc (27,42 so với 97,14), học cách trình bày điểm kiểm định tách biệt điểm kiểm tra theo bệnh nhân để phơi bày đúng độ lớn khác biệt cá thể (tương ứng với nhóm là $97,43 \pm 4,37$ khi tách theo bản ghi so với $79,40 \pm 29,18$ khi chạy xuyên bộ dữ liệu CinC 2013, 75 bản ghi), bắt chước ý tưởng kênh... |

tiếp trang sau

*Bảng 7 (tiếp theo)*

| Mã  | So với mô hình của nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bài học áp dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p31 | Không thể so sánh trực tiếp về con số vì đây là bài toán khác hẳn — phân loại giai đoạn ngủ của người lớn từ chuỗi HRV đã có sẵn, đo bằng Acc/Kappa/AUC trên epoch 30 giây — trong khi nhóm dò đỉnh fQRS từ ECG bụng thai nhi và đo bằng F1 khớp nhịp với dung sai $\pm 50$ ms; nhưng nếu đọc về mức độ thành công thì F1 cao nhất của họ là 0,510 (REM/NREM) và 0,452 (Thức/Ngủ), so với $97,43 \pm 4,37$ macro F1 của FetalQRS-TCN, cho thấy TDA... | Nên áp dụng: trích dẫn bài này (Frontiers in Physiology 2021) làm tiền lệ cho giao thức kiểm định chéo cơ sở dữ liệu không tinh chỉnh mà nhóm đã chạy trên CinC 2013, nhấn mạnh trong phần Methods rằng chính họ tuyên bố trừ bài [50] ra thì không ai báo cáo cross-database; mượn nguyên 16 persistence statistics (trung bình, độ lệch chuẩn, độ lệch, độ nhọn, phân vị 25/50/75, entropy bền vững trên cả hai tập M và L) làm ứng viên...                        |
| p32 | Không thể so sánh trực tiếp, lý do rất đơn giản: bài không có một con số hiệu năng nào để đặt cạnh macro F1 $97,43 \pm 4,37$ của FetalQRS-TCN vì họ không dò đỉnh, không phân loại, không có tập kiểm tra, toàn bộ kết quả là p-value và hệ số tương quan mức nhóm; nhiệm vụ cũng khác hẳn — mô tả sự trưởng thành hệ thần kinh tự chủ ở trẻ em từ chuỗi RR sạch đã được chuyên gia sửa tay, trong khi nhóm làm việc với ECG bụng đơn kênh đầy...     | Nên áp dụng: trích dẫn bài này (PLoS One tháng 12/2025, Universidad Politecnica de Madrid) làm khoảng trống nghiên cứu cho phần Giới thiệu vì chính họ tuyên bố mở rộng TDA sang HRV thai nhi là việc chưa ai làm — đúng chỗ đứng của nhóm, với dữ liệu ADFECGDB sẵn có; mượn cách trình bày minh bạch về tham số nhúng (báo cáo cả kết quả AMI với $\tau$ tối ưu 7-12 nhịp, FNN $d \approx 6$ , tiêu chí Cao $d \approx 9$ rồi mới nói chọn gì và vì sao, dù lựa... |
| p33 | Không thể so sánh trực tiếp về con số: đây là bài toán phân loại trạng thái căng thẳng trên cửa sổ 60 giây của người lớn, đo bằng độ chính xác và F1 ở mức cửa sổ, còn FetalQRS-TCN là bài toán dò đỉnh fQRS trên ECG bụng thai nhi đo bằng F1 khớp nhịp với dung sai $\pm 50$ ms, không có điểm chung nào về nhãn hay dung sai. Nhưng về giao thức thì đối chiếu được một phần và rất có giá trị: tách theo chủ thể của họ tương đương tách theo...  | Nên áp dụng: trích dẫn cặp số 96% (nội bộ đối tượng) so với 81% (tách theo chủ thể), $p < 0,05$ , WESAD ba lớp làm viện dẫn tốt nhất trong cả ba bài để biện minh vì sao nhóm bắt buộc dùng tách theo bản ghi và tách theo chủ thể, và vì sao con số 91% trong README cũ là không hợp lệ — nên đưa thẳng vào phần Methods hoặc Discussion; mượn kỹ thuật subwindowing kèm công thức cập nhật tăng dần $\mu_{\{N+1\}} = \mu_N + (f_{\{M+1\}} - f_1)/M$ cho...         |

3.6. Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện

Bảng dưới đây là cơ sở để nhóm khẳng định rằng các con số công bố trong y văn không so sánh trực tiếp được với nhau, và do đó đóng góp C1 (đối chuẩn không rõ ri) là cần thiết.



**Bảng 8:** Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện khi đọc toàn văn. Đây là cơ sở để nhóm khẳng định các con số công bố trong y văn không so sánh trực tiếp được với nhau.

| Mã  | Công trình     | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p01 | Zhong 2018     | Nghiêm trọng nhất, chỉ số F1 77,85% không phải là F1 dò nhịp theo chuẩn CinC 2013 mà là F1 của bài toán phân loại cửa sổ 100 ms trên tập đã cân bằng lớp nhân tạo, trong khi toàn bộ văn liệu về sau (kể cả Mohebbian 2022 và Basak 2024 trong bảng so sánh của họ) đều trích con số này như F1 dò fQRS — một lỗi trích dẫn hệ thống của cả lĩnh vực. Không có hậu xử lý lấy đỉnh và không áp thời gian trễ nên một phức bộ QRS thật có thể sinh ra nhiều cửa sổ dương liên tiếp mà không bị tính là FP; chỉ có một lần chia cổ định với 7 bản ghi kiểm thử, không lặp lại,...          |
| p03 | Mohebbian 2022 | Nghiêm trọng nhất, với NI-FECG và CinC Challenge, tín hiệu fECG đích dùng để huấn luyện được tự sinh từ chuỗi R-R đáp án bằng wavelet Daubechies: mạng được dạy để tạo ra một tín hiệu mà các đỉnh nằm đúng vị trí đáp án, sau đó lại lấy đỉnh trên chính tín hiệu đó bằng Pan-Tompkins rồi so với đáp án, nên nếu có bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào giữa fold huấn luyện và fold kiểm thử (điều bài không chứng minh là không có) thì con số 99,3% sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Bài không nêu cách chia 4 fold theo bản ghi hay theo cửa sổ ngẫu nhiên — đây là thông tin bắt buộc phải...         |
| p04 | Basak 2024     | Nghiêm trọng nhất, bài chỉ nói ”5-fold cross-validation” mà không nêu cách chia fold, trong khi có một dấu hiệu suy luận rất mạnh cho thấy fold được chia ngẫu nhiên theo đoạn chứ không theo chủ thể: ở Bảng 5, thống kê của chính dữ liệu thật (nhân chuẩn) gần như y hệt nhau ở cả 5 fold, với $muy\_RR = 473,19 / 473,18 / 473,19 / 473,18 / 473,20$ ms và $muy\_HR = 128,52 / 128,52 / 128,51 / 128,52 / 128,53$ bpm, mà nếu mỗi fold kiểm thử chứa những thai nhi khác nhau thì nhịp tim thật trung bình phải khác nhau rõ rệt vì mỗi thai nhi có nhịp riêng — đây là rò rỉ dữ... |
| p05 | Arash 2023     | Bài không nêu số tham số, kích thước mô hình và số FLOPs nên không thể tái lập chính xác kiến trúc cũng như không so sánh được ngân sách tính toán, đồng thời tồn tại nhiều mâu thuẫn nội tại: mục IV-C ghi 6 bộ lọc độ dài ”1, 3, 5, 7, 9 và 11” trong khi mục IV-E ghi ”1, 3, 5, 7, 9 và 13”; dòng trung bình Bảng II ghi Se 86,23% và PPV 95,75% nhưng F1 tương ứng phải khoảng 90,72% chứ không phải 93,43%, và trung bình của 97,7% với 95,3% cũng không thể ra 93,43%; Hình 9(a) ghi F1 tốt nhất 98,37% tại 4 giây trong khi Bảng I ghi 99,03% cho cùng cấu hình. Việc...         |

*tiếp trang sau*

Bảng 8 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình    | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p06 | Lin 2025      | Rò rỉ dữ liệu tiềm ẩn nghiêm trọng trên ADFECGDB: mô hình được tinh chỉnh trên một phần ADFECGDB rồi báo cáo kết quả trên cả 5 bản ghi của chính bộ đồ mà không ghi rõ cách chia, nên con số 99,17% không được coi là kết quả ngoài mẫu — chính bài p07 (Asadi 2025) đã chỉ đích danh điều này khi viết rằng ”một phần bộ ADFECGDB đã được dùng để huấn luyện trong các mô hình này, điều nhiều khả năng đã góp phần làm tăng hiệu năng của chúng trên bộ dữ liệu này”, và Attention R2W-Net được nêu tên trong nhóm đó. Bài không nêu số tham số, kích thước mô hình hay số...   |
| p07 | Amirreza 2025 | Kết quả tuyệt đối trên ADFECGDB (F1 96,52%) thấp hơn đáng kể các bài có tinh chỉnh — chính nhóm tác giả thừa nhận thua TCGAN, CBLS-CycleGAN, Improved CycleGAN, DAW-Net, Attention R2W-Net và dual-branch Transformer-CNN trên bộ này, tuy lập luận (đúng) rằng đó là do khác biệt quy trình huấn luyện chứ không phải do mô hình kém; ngoài ra mô hình rất nặng, 9,22 triệu tham số và 111,79 MB cho một bài toán một kênh nên không thể triển khai trên thiết bị đeo, và bài báo cáo FLOPs nhưng không đo độ trễ thực tế (ms) trên bất kỳ CPU nào nên không biết có chạy...     |
| p09 | Xu 2026       | Lỗi hồng tái lập nghiêm trọng nhất là bài không nêu dung sai khớp nhịp tính bằng ms, khiến mọi con số F1 không thể đối chiếu với bất kỳ công trình nào khác; bài cũng không viết công thức F1, cột ”Accuracy” ở Bảng 8 ghi 0,0172 và 0,0152 cho DaISy là vô nghĩa và không định nghĩa được, còn Hình 11 ghi độ rộng QRS 28 ms với sóng T chỉ cách S 16 ms - theo suy luận của tôi là bất khả thi về sinh lý (QRS thai bình thường khoảng 50-60 ms) nên rất có thể đó là dao động của bộ lọc 10-60 Hz bị đọc nhầm thành sóng P và T. Cỡ mẫu đánh giá quá nhỏ: mỗi bản ghi DaISy... |
| p10 | Esmacili 2025 | Mâu thuẫn số học nghiêm trọng (suy luận của tôi, đã kiểm chứng bằng tính toán): từ Sensitivity, Specificity và Precision họ báo cáo, giải ngược ra tỷ lệ lớp dương là 77,6% ở phương án 1 và 77,3% ở phương án 5, tính lại Accuracy từ tỷ lệ đó cho 0,9836 và 0,9675 - khớp chính xác với con số bài ghi (0,9836 và 0,9679) - nhưng với 10 ô mỗi giây và nhịp thai 110-160 bpm thì chỉ khoảng 20-27% số ô có QRS thai, không thể là 77%, nên các chỉ số này được tính với lớp dương là ô KHÔNG có QRS thai, tức ”Sensitivity 97,91%” trong tóm tắt thực chất là độ nhạy của...    |

tiếp trang sau

Bảng 8 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình  | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p11 | Orvas 2025  | Mất đối xứng nghiêm trọng giữa mô phỏng và thực tế: F-score tụt từ 99,8 trên mô phỏng xuống 77,8 trên CinC 2013 thật, mất 22 điểm, mà bản thân bài không nhấn mạnh dù dữ liệu của chính họ cho thấy rõ; Bảng I cũng đáng ngờ khi F-score gần như bất biến 99,79-99,84 trên toàn dải SNR từ -25 dB đến 0 dB trong khi PCC rơi từ 97,80 xuống 64,65 và PRD tăng từ 21,89 lên 80,39 - suy luận của tôi là dữ liệu fecgsyn có nhịp R hoàn toàn xác định và tuần hoàn nên mạng có thể học "nhịp điệu" của bộ sinh thay vì học hình dạng QRS, đúng kiểu ngộ nhận mà nhóm đã tự phát...                       |
| p12 | Wahbah 2024 | Mô hình dùng đồng thời 12 kênh bụng nên không thể so với mô hình đơn kênh, và nhân chuẩn là đầu ra thuật toán BSSR chứ không phải ECG đa đầu, nghĩa là mô hình chỉ học bắt chước một thuật toán khác mà không ai biết BSSR chính xác đến đâu — đây là điểm yếu nghiêm trọng nhất về mặt khoa học. Bài không có dung sai khớp nhịp, dùng accuracy trên tập mất cân bằng làm metric chính (từ $w1 = 3,17$ suy ngược ra lớp đỉnh R chỉ chiếm khoảng 15,8% số đoạn), và $F1 = 0,96/0,97$ chắc chắn không phải F1 của lớp đỉnh R vì với $Se = 0,858$ thì giải $2 \cdot Se \cdot PPV / (Se + PPV) = 0,97...$ |
| p13 | Behar 2014  | Chương 7 báo cáo F1 trong mẫu vì mọi tham số đều quét trên set-a rồi F1 cuối cùng cũng tính trên set-a, còn tập giấu chỉ được chấm bằng điểm Challenge kiểu RMS; nhân chuẩn của CinC 2013 lại không đồng nhất (một phần từ ECG đa đầu, một phần gán tay, một phần suy từ kênh bụng mẹ, một phần từ tham số mô phỏng) và chính tác giả thừa nhận một số lỗi nhân vẫn còn tồn tại, bên cạnh việc loại 7 bản ghi khỏi set-a bằng quan sát mắt thường sau khi đã nhìn dữ liệu. Không có bất kỳ con số chi phí tính toán nào trong 249 trang; chương chỉ số chất lượng tín hiệu...                          |
| p14 | Behar 2014  | Con số $F1 = 96,0\%$ là trong mẫu vì mọi tham số quét trên set-a rồi F1 cũng báo cáo trên set-a, tập giấu chỉ có điểm Challenge kiểu RMS; thêm vào đó bài loại 7/75 bản ghi vì nhân tham chiếu không chính xác xác định bằng quan sát mắt thường — quyết định chủ quan và làm sau khi đã nhìn dữ liệu — rồi còn cắt 2 giây đầu và cuối mỗi đoạn. Bốn ngưỡng SMI 29 bpm, BCM 0,4, SMI > 26 và nhịp hằng số 143 bpm đều đo bằng thực nghiệm trên set-a mà không có cơ sở lý thuyết, còn FUSE-CHALL được chính tác giả gọi là làm lệch về phía hệ thống chấm điểm của Challenge nên...                    |

tiếp trang sau

Bảng 8 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình     | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p15 | Andreotti 2016 | Toàn bộ đánh giá thực hiện trên dữ liệu mô phỏng và chính tác giả thừa nhận F1 cao một phần là do sự đơn giản của mô hình lưỡng cực trong fecgsyn, với khoảng FQT mô phỏng thấp hơn khoảng sinh lý thật (200-340 ms), tức dữ liệu tổng hợp chưa đúng về mặt hình thái. Việc chọn kênh kiểu oracle khiến mọi con số chỉ là cận trên lý thuyết chứ không phải hiệu năng của một hệ thống tự động; nhóm AM tuy được tuyên là đơn kênh nhưng trên lâm sàng vẫn phải dán thêm điện cực ngực, còn nhóm BSS cần 8 kênh đồng thời nên hoàn toàn không phải bài toán đơn kênh. Bài...      |
| p16 | Niknazar 2013  | Bài không có một con số F1/Se/PPV nào nên không thể tái lập về mặt số học và không thể đặt vào bảng so sánh dò đỉnh, đồng thời bài không nêu dung sai khớp nhịp vì không đo khớp nhịp. Tồn tại một vòng lặp con gà - quả trứng: par-EKS cần vị trí đỉnh R thai làm đầu vào để khớp tham số mô hình, trong khi chính tác giả viết rằng phần cốt tủy của par-EKS đề xuất là việc dò đỉnh R — nghĩa là đây không phải bộ dò đỉnh mà là bộ tách/tăng cường tín hiệu, bắt buộc phải có một bộ dò đỉnh khác đi trước; tuyên bố đơn kênh cũng bị phá vỡ ở ca song thai khi nhân chuẩn... |
| p17 | Castillo 2018  | Điểm yếu lớn nhất là việc lọc bản ghi bằng bác sĩ: chỉ dùng 26/75 bản ghi Challenge Set A (khoảng 35%) và loại 3/20 kênh ADFECGDB, mà chính các bản ghi bị loại mới là các bản ghi khó, nên F1 98,07% không phải hiệu năng trên toàn bộ Set A mà là hiệu năng trên một tập con đã được làm sạch thủ công — bài có ghi rõ điều này nhưng phần tóm tắt và bảng so sánh lại không mang theo cảnh báo đó. Không có tách theo chủ thể hay tách theo bản ghi nên con số ADFECGDB là con số trong mẫu, và con số tổng bộ 94,11% (vốn vẫn đã loại 3 tín hiệu) bị lu mờ trước con số...    |
| p19 | Eleonora 2020  | Bài không nêu dung sai khớp nhịp bằng ms nên không thể tái lập con số độ chính xác, lại dùng công thức Acc có chứa TN mà không định nghĩa TN cho bài toán phát hiện đỉnh, khiến kết quả khó diễn giải và khó đối chiếu với F1/Se/PPV của các công trình khác. Siêu tham số lambda, N và lựa chọn bộ phát hiện jqrs đều được tinh chỉnh trên chính bộ dữ liệu thật được báo cáo, trong khi bộ dữ liệu đó lại riêng tư, chỉ 20 thai phụ, tuổi thai 21-27 tuần và mỗi bản ghi chỉ 10 giây, nên không tái lập độc lập được và không suy rộng cho theo dõi liên tục hay giai đoạn...   |

tiếp trang sau

Bảng 8 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p20 | Gari 2014  | Nhân tham chiếu giai đoạn cuối được tạo bằng cách hợp nhất nhân gốc với nhân của chính các thuật toán dự thi nên một phần nhân là sản phẩm của thuật toán chứ không phải nhân chuẩn độc lập, và tác giả thừa nhận vẫn còn lỗi; bài cũng không nêu dung sai khớp nhịp nên không thể tái lập. Bản ghi chỉ dài 1 phút nên không đánh giá được độ ổn định dài hạn, các tiêu chí chấm điểm theo $(\text{nhịp/phút})^2$ và ms không đối chiếu được với F1/Se/PPV của đa số bài báo hiện đại khiến kết quả cuộc thi gần như không so sánh được với y văn sau này, còn sự kiện E3 kém tin cậy... |
| p21 | Adam 2020  | Số đối tượng rất nhỏ, chỉ 10 thai phụ ở B1 và 12 sản phụ ở B2, nên phương sai giữa các lần gấp khi tách theo bản ghi sẽ rất lớn (đây chính là lý do sai số chuẩn của nhóm là $\pm 4,37$ điểm), còn bản ghi B2 chỉ dài 5 phút và bản ghi B2_Labour_03 mất tới 27,5% tín hiệu nên không đánh giá được độ ổn định dài hạn. Nhân tham chiếu của B1 mang tính vòng tròn vì được suy ra từ chính tín hiệu bụng bằng thuật toán tự động cộng chuyên gia sửa tay, không có nhân chuẩn độc lập và chính tác giả thừa nhận nhân này chỉ "chính xác ở mức độ giới hạn", thêm 130 phức bộ...         |
| p22 | Jose 2013  | Toàn bộ là dữ liệu tổng hợp với mỗi tín hiệu chỉ 50 mẫu và không có bất kỳ kiểm chứng nào trên tín hiệu sinh lý thật, trong khi chi tiết cài đặt đồng điều bền vững được hên sang một bài chưa công bố ([23]) nên không tái lập được nguyên vẹn. Điểm số phụ thuộc việc đoán đúng số chu kỳ L trong cửa sổ và thí nghiệm 1 thử ba giá trị L rồi lấy kết quả tốt nhất ngay trên tập đánh giá; ngoài ra bài thua Lomb-Scargle ở dạng cosin và có xu thế, tức với tín hiệu gần hình sin thì phương pháp cổ điển vẫn tốt hơn. Ràng buộc $M \geq 2N$ cùng cửa sổ khoảng một chu kỳ làm...     |
| p23 | Henry 2017 | Thí nghiệm chính (Bảng 1) không phải phân loại có giám sát mà là phân cụm K-medoids không giám sát trên toàn bộ 150 mẫu, con số báo cáo lại là lần tốt nhất trong 1.000 khởi tạo nên không có tập kiểm thử độc lập và con số mang tính lạc quan; mục 6.4.1 cùng phần PI của mục 6.4.2 không nêu giao thức chia dữ liệu (số fold, tỷ lệ train/test) nên không tái lập được; và tham số b của hàm trọng số lấy từ độ dài bền vững lớn nhất của tất cả các lần thử kể cả dữ liệu đánh giá nên có rò rỉ dữ liệu nhẹ. Tính ổn định chỉ đúng với 1-Wasserstein, còn Remark 6 khẳng định...     |

tiếp trang sau

Bảng 8 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình   | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p24 | Mathieu 2020 | Bài báo cáo cột "Max" là kết quả 10-fold tốt nhất trong 10 lần lặp rồi đối chiếu với con số một lần của đối thủ nên đây là so sánh không đối xứng và thiên lệch lạc quan (con số trung thực là cột "Mean"), đồng thời Bảng 6 và Hình 8 chọn siêu tham số (kích thước lưới, $\varphi$ , $\sigma$ , tham số t) dựa trên độ chính xác trên tập kiểm thử. Bài không nêu số tham số huấn luyện, không nêu kích thước mô hình và không nêu độ trễ suy luận một mẫu mà chỉ có thời gian chạy tổng của một lần thí nghiệm; đồng thời thua xa các phương pháp phi-tô-pô trên các bộ có nhãn đỉnh (NC11... |
| p25 | Anirudh 2020 | Rò rỉ dữ liệu ở GENEactiv (chia 75/25 theo khung trên 152 người) cộng với số tuyệt đối rất thấp (F1 chỉ 46–58% cho nhận dạng hoạt động) khiến mọi chênh lệch vài điểm trên nền 54% đều kém thuyết phục. Lợi ích của PI là biên: CNN 1D tăng từ 53,56 lên 54,41, tức 0,85 điểm, trong khi độ lệch chuẩn là 0,21–0,31 và bài không nêu p-value cho phần chuỗi thời gian; chính tác giả viết rằng việc hợp nhất PI chỉ cải thiện "marginally". Bài không báo cáo số tham số của bất kỳ mạng nào nên không thể biết phần cải thiện đến từ thông tin tô-pô hay chỉ từ việc thêm...                    |
| p26 | Renata 2023  | Toàn bộ thí nghiệm chính là dữ liệu tổng hợp trong $R^2$ và $R^3$ , dữ liệu thật duy nhất là ảnh lá cây FLAVIA; không có chuỗi thời gian, không có tín hiệu sinh lý, không có dữ liệu 1 chiều. Các đường cơ sở bị làm yếu một cách hệ thống: MLP chỉ huấn luyện 2 epoch cho mỗi cấu hình, ML và NN chỉ nhận ma trận khoảng cách của 100 điểm lấy mẫu con trong khi PH nhìn toàn bộ 1.000 hoặc 5.000 điểm, và PointNet không được tăng cường dữ liệu dù bài gốc của nó có dùng; chính tác giả thừa nhận họ không nhằm chứng minh PH vượt trội so với state-of-the-art. Kết quả tính...            |
| p27 | Quoc 2019    | Bài không báo cáo chi phí tính toán dưới bất kỳ dạng nào — không có số giây, số tham số hay dung lượng bộ nhớ — dù phải tính 10 filtration Vietoris-Rips cho mỗi chuỗi, chắc chắn rất chậm nhưng không biết chậm bao nhiêu. Các đường cơ sở 1NN, EE và LS không được chạy lại mà lấy số từ tài liệu tham khảo, trong khi họ có hạ mẫu với hệ số 2, 2, 3 và 2 cho bốn bộ mà không giải thích lý do, nên so sánh không hoàn toàn đồng nhất; thêm vào đó tau của single-delay được chọn bằng giá trị lớn nhất trên tập kiểm tra. Không có kiểm định thống kê nên chênh lệch 90,0...                 |

tiếp trang sau

Bảng 8 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình    | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p28 | Eugene 2023   | Bài hoàn toàn không có dữ liệu ECG, không có bệnh nhân và không có chỉ số y sinh nên mọi con số không chuyển thẳng sang bài toán fQRS; việc chọn đỉnh phổ làm thủ công bằng mắt và chưa được tự động hóa. Bộ trung vị lỗi dự báo của tôm hùm trùng khít với bộ của Lorenz (0,106   0,122   0,112) khiến phần kết quả định lượng chính không kiểm chứng được, và phần khảo sát nhiễu mẫu thuận nội bộ (phần chữ nói năm mức nhưng liệt kê bốn, còn Hình 14 hiện sáu mức 40/37/30/27/20/17 dB). Không có kiểm định thống kê, không lặp seed, không khoảng tin cậy nên khẳng định... |
| p29 | Yonglian 2023 | Rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng ở hai tầng — chia ngẫu nhiên 10 mảnh không tách bệnh nhân hay bản ghi, cộng với việc lớp "unacceptable" phần lớn là bản sao có nhiễu của chính các tín hiệu "acceptable" trong cùng bộ dữ liệu — nên con số 98,55% gần như chắc chắn lạc quan quá mức; bài toán còn bị làm dễ đi vì 88,9% lớp âm là nhiễu tổng hợp cộng ở -10 dB, khiến mạng chỉ cần học có nhiễu bw/em/ma/Gauss hay không chứ không phải học chất lượng lâm sàng thật, với chỉ 988 mẫu xấu thật. Nhãn 12 chuyển đạo không nhất quán theo thừa nhận của chính tác giả, quy trình tự... |
| p30 | Meryll 1906   | Bài có mâu thuẫn nội bộ về số bệnh nhân giữ lại để kiểm tra (5 hay 15) và về tổng số bệnh nhân (240 trong phần chữ, 241 khi cộng Bảng 1), đồng thời không có kiểm định thống kê cho tuyên bố TDA cải thiện dù chỉ đưa ra 10 cặp số thô, không tính trung bình, không tính độ lệch chuẩn và TDA thua ở 4 trên 10 thí nghiệm phát hiện. Bài không tái lập được vì không nêu số tham số, kích thước mô hình, độ trễ suy luận, kiến trúc chi tiết từng kênh, số epoch tổng, batch size hay thư viện học sâu, và cũng không nêu độ dài cửa sổ theo giây do cắt theo số nhịp ("as...    |
| p31 | Yu-Min 1908   | Bài không nêu dài lọc thông dải cho ECG — toàn bộ khâu tiền xử lý chỉ được dẫn chiếu sang bài [50] — nên khâu quan trọng nhất theo thực nghiệm của nhóm là không tái lập được; bài cũng không nêu số tham số mô hình, độ trễ suy luận hay kích thước mô hình, chỉ có thời gian huấn luyện 5-7 phút và thời gian chạy Ripser. Hiệu năng tuyệt đối rất thấp: F1 phát hiện trạng thái Thức chỉ 0,41-0,45, Kappa 0,24-0,32 (mức đồng thuận yếu), độ chính xác dương tính chỉ 34-38% nghĩa là cứ 3 epoch báo "Thức" thì 2 sai, và bảng số thô cho thấy FP dao động 126-175 epoch...    |

tiếp trang sau


Bảng 8 (tiếp theo)

| Mã  | Công trình   | Hạn chế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p32 | Andy 2025    | Bài không có bài toán dự đoán nào — không train/test, không mô hình, không độ chính xác/F1/AUC — nên chỉ chứng minh các chỉ số tô-pô khác nhau giữa các nhóm tuổi chứ không chứng minh chúng dự đoán được tuổi hay bệnh lý của một cá thể mới, đó là khoảng cách rất lớn giữa ”có ý nghĩa thống kê” và ”dùng được trong lâm sàng”. Nghiêm trọng hơn là mâu thuẫn nội tại: phần Tóm tắt và Thảo luận viết rằng sơ sinh và nhũ nhi có số lượng và cường độ đặc trưng bền vững cao hơn (N1 cao), trong khi mục Kết quả 4.2 viết ngược lại rằng sơ sinh có N1 và PE1 thấp hơn có ý... |
| p33 | Alperen 2021 | Con số đẹp nhất là kết quả gộp đa kênh chứ không phải đơn kênh: 94,46% và 81,35% trên WESAD là gộp toàn bộ 10 kênh ngực và cổ tay (ACC, RESP, ECG, EDA, EMG, TEMP, BVP), trong khi riêng ECG một kênh chỉ đạt 88,70% (hai lớp) và 76,27% (ba lớp), còn trên DriveDB ECG một kênh chỉ 65,74% và 53,32% tức gần như vô dụng — ai trích dẫn ”98,07%” mà không nói rõ đó là tín hiệu hô hấp (RESP) chứ không phải ECG là trích dẫn sai. Có một lỗi phương pháp xử lý tín hiệu thực sự: hạ mẫu 700 Hz xuống 100 Hz bằng cách lấy mỗi phần tử thứ 7 mà không lọc chống chồng phổ...     |



## 4. Mô hình của nhóm và lý do chọn

### 4.1. Toàn cảnh pipeline



**Hình 1:** Pipeline RELYFETAL. Khối màu xanh lá là mạng học sâu. Các khối viền đỏ nét đứt là nhánh độ tin cậy (đóng góp C3). Prototype của nhánh này đã chạy: phần *cổng từ chối* có tác dụng và đã vào demo; phần *đồng điều bền vững* cho kết quả phù định và được rút lại (§7).

4.2. Mô hình: FETALQRS-TCN

**Bảng 9:** Đặc tả FETALQRS-TCN. Mọi con số đều đo trực tiếp từ mã nguồn và checkpoint, không lấy lại từ tài liệu.

| Thuộc tính               | Giá trị                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiền xử lý               | Butterworth 10–60 Hz pha không (zero-phase) + chặn dải 50 Hz ( $Q = 30$ ), hạ tần số về 250 Hz                                                   |
| Khử ECG mẹ               | Dò QRS mẹ ở dải 8–25 Hz với RR tối thiểu 350 ms; mẫu trung vị cửa sổ $[-150, +300]$ ms; trừ theo hệ số bình phương tối thiểu riêng cho từng nhịp |
| Đầu vào mạng             | $2 \times 1000$ : tín hiệu dư sau khử mẹ và tín hiệu gốc, đoạn 4 giây ở 250 Hz                                                                   |
| Thân mạng                | Conv1d( $k = 7$ ) + 5 khối dư giãn nở với hệ số 1, 2, 4, 8, 16                                                                                   |
| Trường tiếp nhận         | 379 mẫu = <b>1.516 ms</b>                                                                                                                        |
| Đầu ra                   | Một logit cho <b>từng mẫu</b> ; nhân là bản đồ nhiệt Gauss $\sigma = 12$ ms                                                                      |
| Hậu xử lý                | Lấy đỉnh với ngưỡng $\tau$ và thời gian trễ 250 ms                                                                                               |
| Tham số huấn luyện được  | <b>113.481</b>                                                                                                                                   |
| Kích thước checkpoint    | 0,48 MB                                                                                                                                          |
| Độ trễ một cửa sổ 4 giây | <b>4,35 ms</b> trên CPU (hệ số thời gian thực 920 $\times$ )                                                                                     |


4.3. Vì sao chọn mô hình này, và vì sao đây không phải bắt chước

Câu hỏi này quan trọng vì trong nhóm có một thành viên khác đang làm hướng Persistence Image kết hợp CNN hai nhánh. Nhóm khẳng định lựa chọn của mình đến từ thực nghiệm, và trên thực tế nó **bác bỏ** chính giả thuyết trung tâm của hướng kia.

**Bảng 10:** Đối chiếu hai hướng tiếp cận trên từng trục thiết kế.

| Trục thiết kế         | Hướng Persistence Image            | FETALQRS-TCN (nhóm)                       |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Biểu diễn đầu vào     | Ảnh bền vững 2 chiều từ nhúng trễ  | Tín hiệu 1 chiều thô + tín hiệu dư        |
| Dạng bài toán         | Phân loại cửa sổ có/không có QRS   | Hồi quy bản đồ nhiệt theo từng mẫu        |
| Dải thông             | 1–45 Hz                            | <b>10–60 Hz</b>                           |
| Ngưỡng cảnh thời gian | 300 ms                             | <b>4 giây</b> , trường tiếp nhận 1.516 ms |
| Vai trò của topo      | Đặc trưng chính để dò đỉnh         | Chỉ số chất lượng, quyền từ chối (C3)     |
| Tham số               | 1.522.476 (đo thật trong mã nguồn) | <b>113.481</b>                            |

Ba thí nghiệm có kiểm soát dưới đây là cơ sở của lựa chọn.




**Hình 2:** Mười sáu kiến trúc, cùng dữ liệu và cùng ngân sách tham số. Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng cuối bảng.

### Thí nghiệm 1 — so 16 kiến trúc ở cùng ngân sách tham số.

**Bảng 2 là bảng cũ và lạc quan — giữ lại để minh bạch**

Bảng đó chạy ở dải 3–90 Hz, trên một bản ghi validation, một seed, và F1 là giá trị lớn nhất quét trên 18 ngưỡng ngay trên bản ghi đánh giá. Nhóm đã **chạy lại** với giao thức đúng; kết quả ở ngay dưới. Bảng cũ chỉ còn giá trị ở một điểm: Persistence Image thua ở mức không thể cứu (27,42), và điều đó không đổi dưới bất kỳ giao thức nào.

**Bảng kiến trúc chạy lại đúng giao thức.** Dải 10–60 Hz, tách theo bản ghi 5 fold, ngưỡng chọn **trên bản ghi validation riêng** rồi áp cố định sang bản ghi test, 20 đánh giá (bản ghi × kênh), Wilcoxon ghép cặp so với cnn\_dil. Cửa sổ 300 ms như bảng cũ, để so được với nó. Mã tại `pilot_evidence/arch_loro.py`.

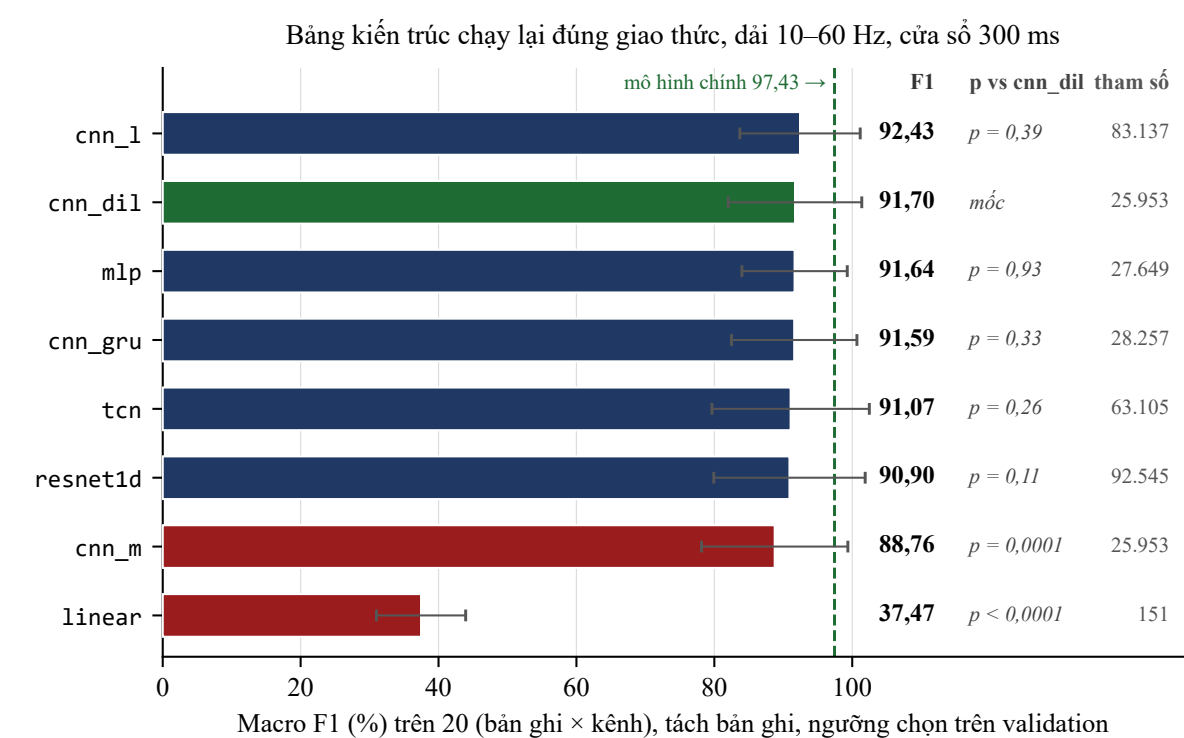

**Hình 3:** Tám kiến trúc dưới giao thức trung thực. Hiệu số so với `cnn_dil` nằm trong khoảng  $-2,95$  đến  $+0,73$  điểm; với  $n = 5$  chủ thể nghiên cứu này **không đủ lực** để kết luận chúng tương đương (§10). Đường đứt xanh là mô hình chính (ngữ cảnh 4 giây, đầu ra từng mẫu) — cách xa cả nhóm.


**Bảng 11:** Số liệu của hình 3. Một seed, ba epoch. Cột KTC 90% là bootstrap cụm ở **mức chủ thể** ( $n = 5$ ); cột TOST kiểm định tương đương với biên  $\delta = 1,0$  điểm F1 (§10). Các trị số  $p$  Wilcoxon của bản 3.2 tính trên 20 cặp (bản ghi × kênh) là giả lập và đã bị gỡ.

| Hạng | Kiến trúc | Tham số | Macro F1      | Hiệu số | KTC 90% bootstrap | Kết luận TOST            |
|------|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 1    | cnn_l     | 83.137  | 92,43 ± 8,73  | +0,73   | [+0,18; +1,22]    | không kết luận được      |
| 2    | cnn_dil   | 25.953  | 91,70 ± 9,68  | mốc     | —                 | —                        |
| 3    | mlp       | 27.649  | 91,64 ± 7,64  | −0,07   | [−3,47; +3,52]    | không kết luận được      |
| 4    | cnn_gru   | 28.257  | 91,59 ± 9,10  | −0,12   | [−0,72; +0,54]    | không kết luận được      |
| 5    | tcn       | 63.105  | 91,07 ± 11,41 | −0,64   | [−1,13; −0,11]    | không kết luận được      |
| 6    | resnet1d  | 92.545  | 90,90 ± 10,98 | −0,81   | [−1,79; +0,09]    | không kết luận được      |
| 7    | cnn_m     | 25.953  | 88,76 ± 10,61 | −2,95   | [−4,55; −1,47]    | <b>KÉM HƠN vượt biên</b> |
| 8    | linear    | 151     | 37,47 ± 6,47  | −54,24  | [−56,41; −50,49]  | khác biệt vượt biên      |

Ba điều bảng này nói, rõ hơn bảng cũ rất nhiều:

1. **Họ kiến trúc đóng góp ít — nhưng “ít” không phải “bằng không”, và nghiên cứu này không đủ lực để nói chúng bằng nhau.** Mạng dư 92 nghìn tham số, TCN 63 nghìn, GRU, và cả một MLP 27 nghìn tham số đều nằm trong 0,9 điểm của CNN giãn nở 26 nghìn tham số. Quán quân cũ (resnet1d) rơi xuống hạng 6. Với  $n = 5$  chủ thể, TOST biên 1,0 điểm cho 0/7 kiến trúc tương đương và 6/7 không kết luận được (§10): kết luận đúng là **thiếu lực phân biệt**, không phải “không phân biệt được”.
2. **Giãn nở có quan trọng.** cnn\_m và cnn\_dil có cùng 25.953 tham số, chỉ khác lịch giãn nở, chênh **2,95 điểm** với KTC 90% bootstrap  $[-4,55; -1,47]$  nằm hoàn toàn ngoài biên tương đương. Đây là bằng chứng có kiểm soát chặt nhất trong đề tài rằng trường tiếp nhận là biến chi phối — và là kiến trúc duy nhất trong bảng có kết luận chắc chắn.
3. **Cả tám đều thua xa mô hình chính.** Tốt nhất trong bảng là 92,43; mô hình 4 giây đầu ra từng mẫu đạt 97,43 trên cùng giao thức. Chênh 5 điểm đến từ ngưỡng cảnh và độ phân giải đầu ra, không từ họ mạng.

**Thí nghiệm 2 — quét trường tiếp nhận.** Đây mới là biến kiến trúc thực sự quan trọng. Cùng một họ mạng, chỉ đổi lịch giãn nở:

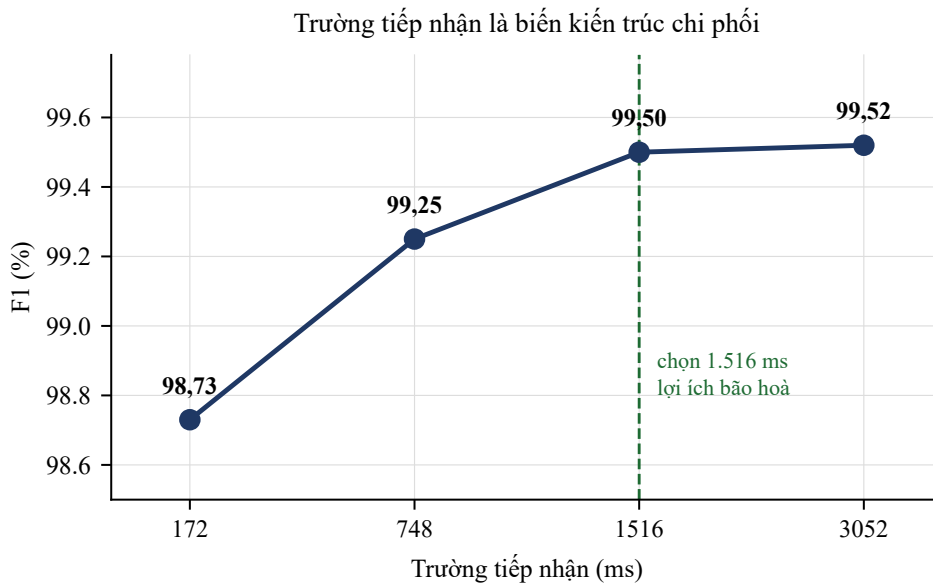

**Hình 4:** Lợi ích của trường tiếp nhận bão hoà quanh 1,5 giây. Nhóm chọn 1.516 ms.

Kiểm chứng bằng ba seed với giao thức tách theo bản ghi đầy đủ: trường tiếp nhận 1.516 ms đạt  $97,16 \pm 4,34$ , trường 172 ms đạt  $92,67 \pm 10,46$ , và độ lệch chuẩn giảm hơn một nửa — ngưỡng dài làm mô hình ổn định hơn giữa các sản phụ.

**Trị số  $p = 0,0000$  của bản 3.2 cho bước này đã bị gỡ**

Nó tính trên **60 hàng** (bản ghi  $\times$  kênh  $\times$  seed) từ 5 sản phụ — giả lập 12 lần. Ở mức chủ thể: hiệu số +4,49 điểm, KTC 95% bootstrap  $[+1,58; +7,43]$  nhưng KTC 95% kiểu  $t$  là

$[-0,29; +9,27]$ , tức **chứa 0**. Nhóm báo cáo hiệu số và bỏ  $p$  (§10).

**Thí nghiệm 3 — đầu ra theo từng mẫu.** Chuyển từ phân loại cửa sổ sang hồi quy bản đồ nhiệt theo từng mẫu cải thiện độ chính xác định vị đỉnh từ 5,6–6,0 ms xuống **1,0 ms**. Đây là điều kiện bắt buộc nếu muốn so với các công trình dùng dung sai chặt hơn 50 ms, và là tiền đề cho phân tích biến thiên nhịp tim thai.

#### Kết luận về lựa chọn mô hình

Nhóm chọn mạng tích chập giãn nở dạng chuỗi sang chuỗi **không phải vì họ kiến trúc này ưu việt**, mà vì nó là cách **rẻ nhất** để mua hai thứ mà thực nghiệm chỉ ra là thật sự quan trọng: trường tiếp nhận dài khoảng 1,5 giây, và độ phân giải đầu ra theo từng mẫu. Bằng chứng: ở cùng trường tiếp nhận khoảng 1,5 giây, U-Net 1 chiều tốn 678.257 tham số mà F1 lại thấp hơn (99,42 so với 99,50); Transformer chậm gấp 21,7 lần để đổi lấy 0,25 điểm.


## 5. Kết quả tiên khả thi đã đo

Mọi con số trong mục này do nhóm tự đo, có mã nguồn và nhật ký kèm theo trong thư mục `pilot_evidence/`, `model/` và `benchmark_dpss/`.

### 5.1. Thiết lập

Dữ liệu: PhysioNet ADFECGDB, 5 sản phụ  $\times$  4 kênh bụng, 1000 Hz, nhãn chuẩn từ điện cực xoắn da đầu thai đã được bác sĩ tim mạch duyệt. Toàn bộ tệp tải trực tiếp từ PhysioNet bằng `model/download_data.py` và được ghi mã băm SHA-256 trong `data_card.json`. Giao thức: tách theo bản ghi, ngưỡng quyết định chọn trên **một bản ghi validation riêng**, chấm điểm ở mức sự kiện với dung sai  $\pm 50$  ms. Tổng khối lượng: trên 600.000 cửa sổ, khoảng sáu giờ tính toán trên CPU.


### 5.2. Phân rã đóng góp ba tầng

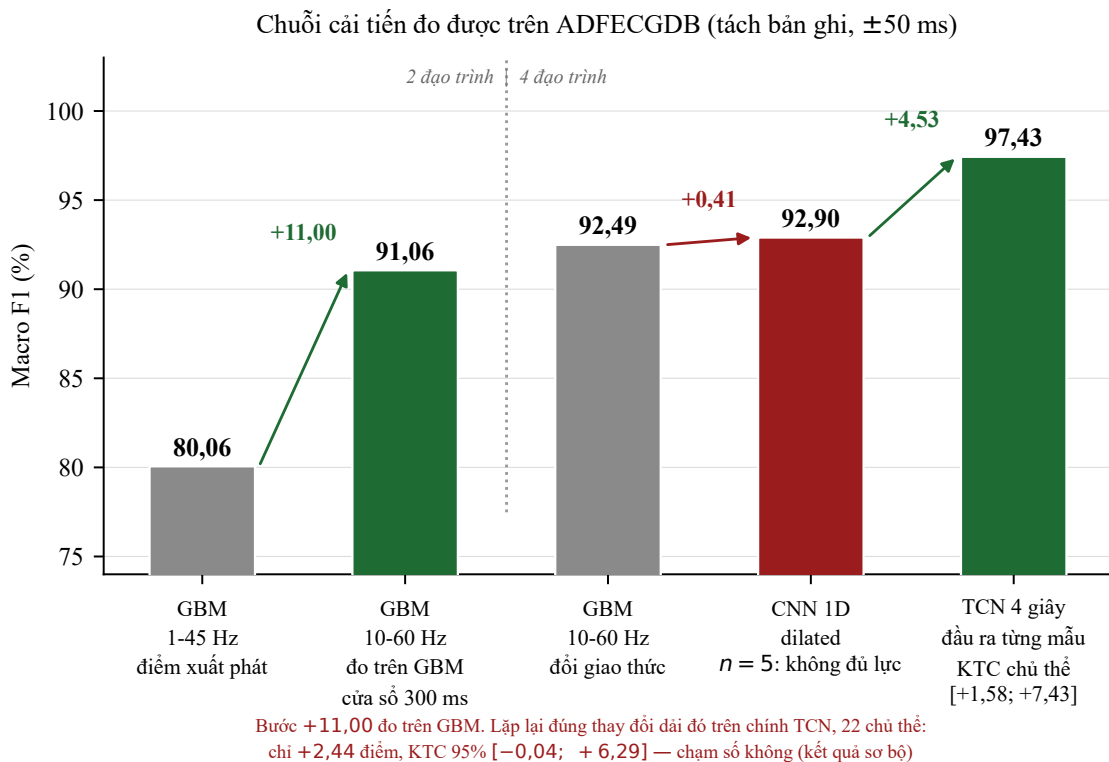

**Hình 5:** Chuỗi cải tiến đo được. Đường chấm đánh dấu chỗ **đổi giao thức** từ 2 sang 4 đạo trình — hai bên đường này không trừ trực tiếp cho nhau được, nên mức tăng +11,00 chỉ tính trong phần bên trái. Nhãn dưới mỗi cột ghi **phạm vi đo**, không ghi trị số  $p$ : mọi  $p$  của bản 3.2 tính trên hàng (bản ghi  $\times$  kênh  $\times$  seed) nên là giả lập và đã bị gỡ (§10). Dòng chú dưới hình ghi kết quả **sơ bộ** khi lặp lại bước +11,00 trên chính TCN (§5.2.1).

Bản trước ghi “đôi dài lọc ăn +12,43 điểm”. Con số đó **sai**, vì nó trộn hai thí nghiệm khác nhau: 80,06 đo trên **2** đạo trình trong khảo sát dài, còn 92,49 đo trên **4** đạo trình trong thí nghiệm cuối. Con số có kiểm soát nội bộ đúng là **+11,00** (91,06 so với 80,06, cùng một thí nghiệm, cùng số đạo trình).

Bản trước cũng phát biểu “tiền xử lý quan trọng gấp 30 lần kiến trúc”. Phát biểu đó **không đứng vững**, vì bước “+4,53 điểm” được gán nhãn tiền xử lý thực ra gộp ba thay đổi, trong đó có hai thay đổi mang bản chất kiến trúc: trường tiếp nhận và tham số hoá đầu ra. Phát biểu đúng là **phân rã ba tầng** ở bảng 12.

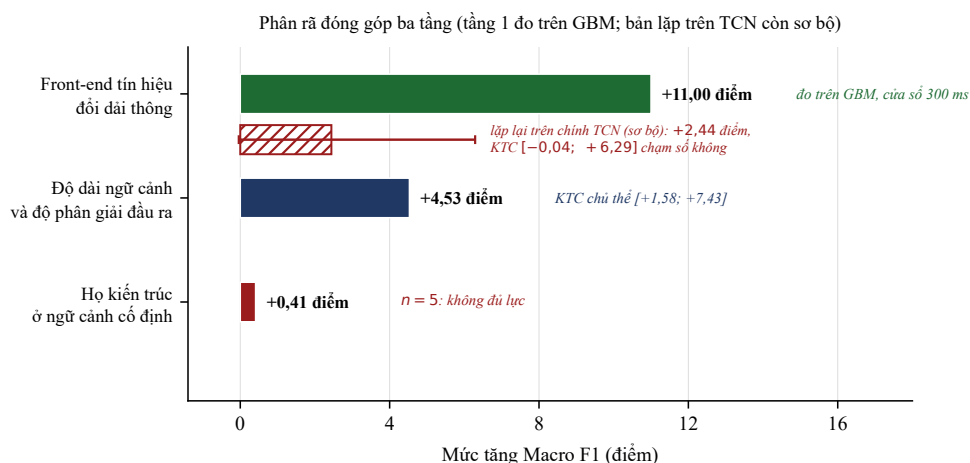


**Hình 6:** Phân rã đóng góp ba tầng. Trên bộ học cửa sổ 300 ms, front-end tín hiệu vẫn là tầng lớn nhất, và khoảng cách so với tầng ngữ cảnh là 2,4 lần chứ không phải 30 lần như bản đề cương trước phát biểu. Thanh gạch chéo là bản **lập lại tầng 1 trên chính TCN**: chỉ +2,44 điểm với KTC [-0,04; +6,29] chạm số không — **kết quả sơ bộ**, xem §5.2.1.

**Bảng 12:** Phân rã đóng góp ba tầng, tính lại ở **mức chủ thể**. Mọi trị số  $p$  của bản 3.2 đã bị gỡ: chúng tính trên 20–60 hàng (bản ghi  $\times$  kênh  $\times$  seed), tức giả lập. Với  $n = 5$  chủ thể,  $p < 0,05$  là bất khả thi (§10).

| Tầng                                                          | Mức tăng F1            | KTC 95% mức chủ thể                                      | Kết luận                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front-end tín hiệu (đôi dài thông), đo trên GBM cửa sổ 300 ms | <b>+11,00</b>          | <b>chưa tính lại được</b>                                | artefact cũ không lưu F1 từng bản ghi nên không dựng được KTC                                 |
| cùng thay đổi dài, lập trên chính TCN, 22 chủ thể (sơ bộ)     | <b>+2,44</b>           | $[-0,04; +6,29]$                                         | <b>KTC chạm 0: chưa xác lập ở <math>n = 22</math></b> ; toàn bộ hiệu ứng ở 3 chủ thể (§5.2.1) |
| Độ dài ngữ cảnh và độ phân giải đầu ra                        | <b>+4,49</b>           | $[+1,58; +7,43]$ bootstrap;<br>$[-0,29; +9,27]$ theo $t$ | hướng rõ, nhưng KTC kiểu $t$ chứa 0 với $n = 5$                                               |
| Họ kiến trúc, ở ngữ cảnh cố định                              | <b>-2,95 đến +0,73</b> | xem bảng 11                                              | <b>không đủ lực để phân biệt; TOST 0/7 tương đương</b>                                        |



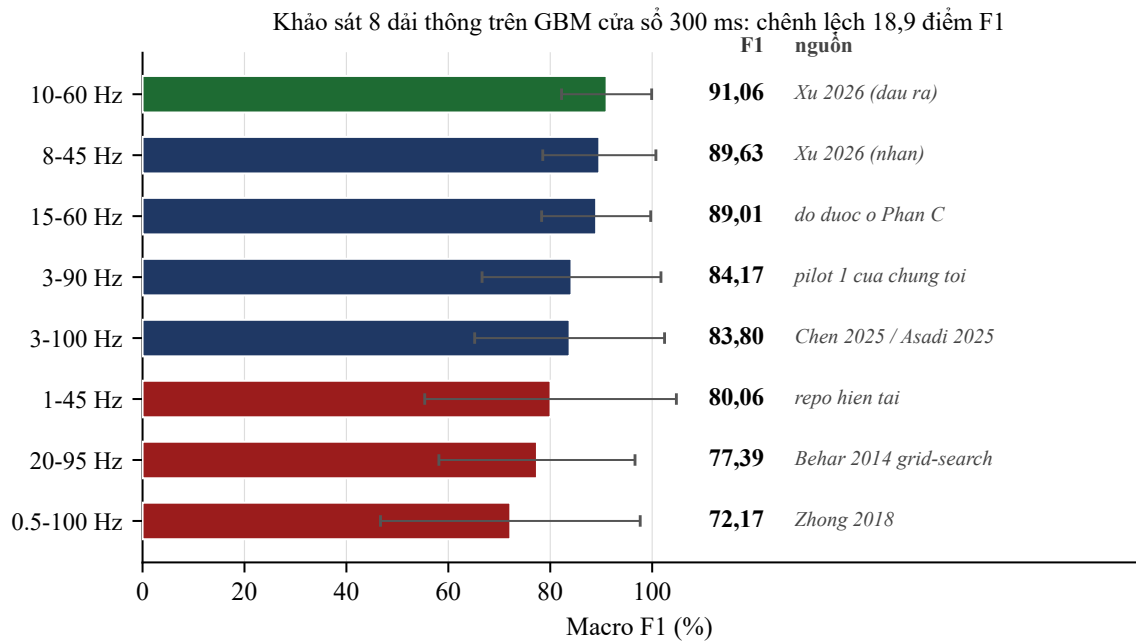

**Hình 7:** Khảo sát tám dải thông **trên gradient boosting**, cửa sổ **300 ms**, mỗi dải là một lần chạy tách theo bản ghi đầy đủ. Chênh lệch giữa dải tốt nhất và kém nhất là 18,89 điểm F1 — lớn hơn toàn bộ khác biệt giữa 16 kiến trúc học sâu. **Cảnh báo phạm vi:** độ lớn này *không* chuyển sang TCN — xem §5.2.1.

Ba nguồn y văn độc lập đọc từ toàn văn ủng hộ hướng này: Behar và cộng sự 2014 tìm kiếm lưới ra 20–95 Hz; Clifford và cộng sự 2014 ghi nhận cắt thông cao ở 10 Hz cải thiện kết quả do loại bỏ sóng P và T của mẹ; Xu và cộng sự 2026 dùng đúng 10–60 Hz.

#### Nói rõ: dải 10–60 Hz KHÔNG phải phát hiện của nhóm

Dải thắng cuộc là dải nhóm **lấy từ y văn**: survey/facts\_verified.json ghi "nguồn\_y\_van": "Xu 2026" cho chính dòng 10–60 Hz. Behar 2014 cũng đã tìm kiếm lưới dải thông như một phần phương pháp, và Andreotti và cộng sự 2016 đã chứng minh rằng lựa chọn tiền xử lý **đảo thứ hạng** các thuật toán trích fECG.

Vì vậy thông điệp *“cả một lĩnh vực đang tối ưu sai tầng”* **không đứng vững** và đã bị gỡ khỏi đề cương. Đóng góp còn lại của nhóm ở tầng này là **định lượng**: đo mức tăng trong cùng một thí nghiệm có kiểm soát, cạnh hai tầng còn lại, trên dữ liệu thật — điều mà Andreotti 2016 làm định tính trên dữ liệu tổng hợp.


Một chi tiết nhóm muốn nêu vì nó phản trực giác: dải có **tương phản cao nhất** (20–95 Hz, tỉ số RMS 1,94) lại cho F1 gần **thấp nhất** (77,39). Tương phản không phải hàm mục tiêu.

#### 5.2.1. Lặp lại khảo sát dải lọc trên chính TCN — kết quả sơ bộ

Toàn bộ con số +11,00 ở trên đo trên **gradient boosting**, cửa sổ **300 ms**, tức không cùng mô hình với hai tầng còn lại. Bản đề cương trước ghi “thí nghiệm trên TCN đang chạy”. Thí nghiệm đó **đã chạy xong** (09:33 ngày 12/09/2026, cả bốn dải, 137,6 phút), và nhóm báo cáo đúng như nó ra: **nó không ủng hộ độ lớn cũ**.

**Bảng 13:** Dải lọc đo trên **chính** FetalQRS-TCN: 22 chủ thể, 3 nếp gấp tách theo chủ thể, 4 epoch, seed 0, chọn kênh PSD mù nhãn, dung sai  $\pm 50$  ms. Nguồn: pilot\_evidence/band\_tcn.json  $\rightarrow$  pilot\_evidence/band\_tcn\_stats.json. Thí nghiệm **đã chạy xong cả bốn dải** lúc 09:33 ngày 12/09/2026 (137,6 phút); vì mới **một seed** và 4 epoch nên vẫn là **kết quả sơ bộ**.

| Dải        | Macro F1 (%)      | Hiệu so với 1–45 | KTC 95% cluster bootstrap      |
|------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 10–60 Hz   | 98,07 $\pm$ 4,05  | +2,44            | [−0,04; +6,29] — <b>chạm 0</b> |
| 3–90 Hz    | 97,88 $\pm$ 4,76  | +2,25            | [−0,53; +6,62] — <b>chạm 0</b> |
| 1–45 Hz    | 95,63 $\pm$ 12,09 | mốc              | —                              |
| 0,5–100 Hz | 95,51 $\pm$ 12,11 | −0,12            | [−1,01; +0,72] — <b>chạm 0</b> |

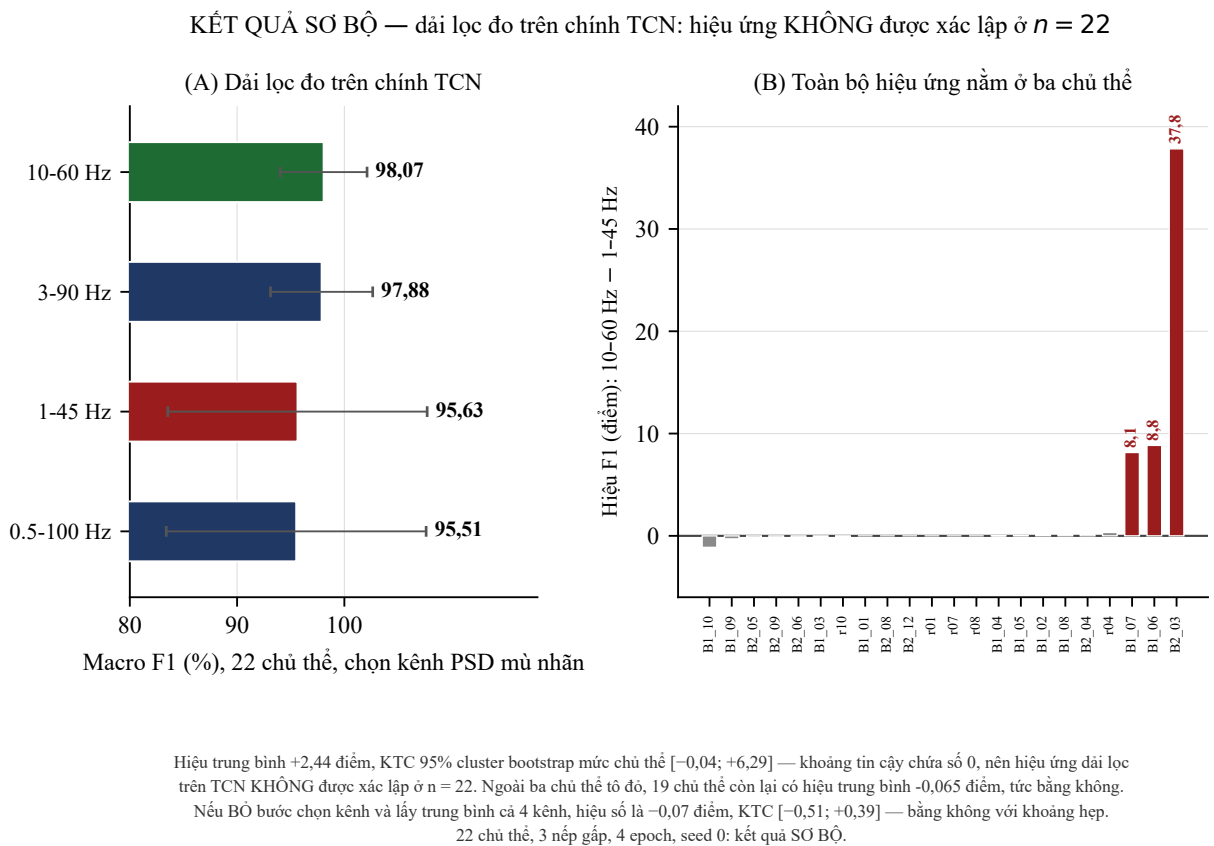

**Hình 8:** Dải lọc đo trên chính TCN, cả bốn dải. (A) macro F1 theo quy tắc chọn kênh PSD mù nhãn. (B) hiệu số từng chủ thể giữa 10–60 Hz và 1–45 Hz: 19 trong 22 chủ thể nằm sát số không, toàn bộ hiệu ứng do ba chủ thể tô đỏ tạo ra. Dòng chú dưới hình ghi thêm kết quả trên thang đo **trung bình 4 kênh**, nơi hiệu số bằng không với khoảng hẹp.

Ba điều phải nói thẳng, và nhóm không được phép nói khác:

1. **Con số +11,00 đo trên GBM không chuyển sang TCN ở cùng độ lớn.** Trên chính TCN, cùng thay đổi dải ấy chỉ đáng **+2,44 điểm** (98,07 so với 95,63), tức bằng khoảng một phần năm.

2. **Khoảng tin cậy chạm số không, nên hiệu ứng *chưa được xác lập* ở  $n = 22$ .** KTC 95% cluster bootstrap mức chủ thể là  $[-0,04; +6,29]$ . Không được viết như thể nó đã được xác lập; mọi phát biểu kiểu “dải lọc là tăng quan trọng nhất” từ nay chỉ đúng *trong phạm vi bộ học cửa sổ 300 ms*.
3. **Đây vẫn là kết quả sơ bộ.** Cả bốn dải đã chạy xong lúc 09:33 ngày 12/09/2026, nhưng mới **một seed**, ba nếp gấp và bốn epoch — chưa đủ để gọi là kết quả cuối. Khi có thêm seed, con số  $+2,44$  và khoảng tin cậy của nó sẽ được cập nhật; nhóm cam kết báo cáo cả khi nó đi xuống.

#### Thêm một phép kiểm: bỏ bước chọn kênh thì hiệu ứng dải lọc biến mất hẳn

Cùng bộ kết quả đó còn cho một thang đo thứ hai: **trung bình cả bốn kênh**, tức bỏ hoàn toàn bước chọn kênh PSD. Trên thang đo này, hiệu số giữa 10–60 Hz và 1–45 Hz là  **$-0,07$  điểm**, KTC 95% cluster bootstrap  $[-0,51; +0,39]$  — **bằng không, với khoảng hẹp** (band\_tcn\_stats.json, khoá mean4).

Nghĩa là: phần  $+2,44$  đo được trên thang PSD **không đến từ dải lọc làm tín hiệu tốt hơn**, mà đến từ chỗ dải lọc làm **quy tắc chọn kênh** chọn đúng hơn — và chỉ ở vài chủ thể. Đây là *suy luận* từ hai thang đo, chưa phải kết luận đã kiểm chứng riêng; nhưng nó là lý do nữa để **không** phát biểu “dải 10–60 Hz đáng  $+11$  điểm” như một sự thật chung.

#### Hiệu ứng không phân bố đều — nó dồn vào đúng ba chủ thể

Hiệu số từng chủ thể (bảng 13, hình 8B) cho thấy trung vị bằng **0,00**: đa số chủ thể không đổi gì khi đổi dải. Toàn bộ  $+2,44$  đến từ ba chủ thể: **B2\_03**  $+37,8$ , **B1\_06**  $+8,8$ , **B1\_07**  $+8,2$ . Mười chín chủ thể còn lại có hiệu trung bình  $-0,065$  điểm, tức **bằng không**.

Đây là *quan sát*, không phải kết luận. Nhưng nó trùng với hai đường bằng chứng độc lập khác: cùng ba bản ghi đó là ba bản ghi RelyFetal thua Power-MF 4 kênh nặng nhất (§5.7), và cũng chính là ba hạng thấp nhất của cổng từ chối hiệu chuẩn theo leave-one-subject-out (§7). Từ đó nhóm nêu một **giả thuyết cần kiểm chứng**, chưa phải kết luận: bài toán dò fQRS đơn kênh có thể là **lượng cực** — đa số bản ghi dễ đến mức mọi lựa chọn thiết kế đều không quan trọng, còn toàn bộ hiệu ứng của mọi lựa chọn thiết kế tập trung ở một thiểu số nhỏ. Nếu giả thuyết đúng thì **F1 trung bình theo bản ghi là cách đo sai**, vì nó trộn hai chế độ — và đó sẽ là một cách giải thích vì sao các ablation trong y văn mâu thuẫn nhau. Kiểm chứng giả thuyết này được đưa vào kế hoạch thực hiện của đề tài.

### 5.3. Quy tắc chọn kênh mù nhãn

Đây là kết quả nhóm coi là quan trọng nhất trong đợt thực nghiệm vừa rồi, và nó xuất phát từ một lỗi liên chính mà nhóm tự phát hiện.

**Lỗi nhóm tự phát hiện và đã sửa**

Con số “77,52” mà bản đề cương trước báo cáo cho thí nghiệm xuyên bộ dữ liệu là kết quả **chọn kênh tốt nhất bằng nhãn thật**. Đó là chọn kênh kiểu “thần thánh” (oracle), không dùng được trong thực tế và không được phép báo cáo như hiệu năng hệ thống.

Nhóm đã thay bằng quy tắc chọn kênh **mù nhãn** theo Power-MF: chọn kênh có đỉnh mật độ phổ công suất lớn nhất trong dải nhịp tim thai 1,8–3,0 Hz (tương ứng 108–180 nhịp/phút), tính trên đường bao năng lượng của tín hiệu dư. Quy tắc này không dùng nhãn và có thể đăng ký trước.

**Bảng này đã đổi hoàn toàn trong bản 3.3 — và nó lật một kết luận cũ**

Bản 3.2 báo cáo cột CinC 2013 trên **mẫu 10 bản ghi** và kết luận: “*quy tắc mù nhãn sụp đổ ngoài miền (59,15 so với 77,34 của quy tắc cố định đơn giản hơn)*”. Trên **toàn bộ 75 bản ghi** kết luận đó **đảo ngược**: quy tắc mù nhãn đạt 71,21 còn quy tắc kênh 0 cố định chỉ đạt 58,72. Chính **quy tắc kênh 0** mới là thứ sụp, và nó sụp vì nó được chọn hậu kiểm trên đúng 10 bản ghi đó (§5.10.3).

**Bảng 14:** So sánh bốn quy tắc chọn kênh, mô hình 5 ca. Cột CinC 2013 đo trên **75 bản ghi set-a (đã rút ở bản 3.5** — trên 60 bản sạch: PSD 64,04, kênh 0 48,43, oracle 72,76, trung bình 4 kênh 56,00; §5.10.3); cột trong ngoặc là con số cũ trên mẫu 10 bản ghi, giữ lại để thấy mức lệch.

| Quy tắc chọn kênh                      | ADFECGDB     | CinC 2013,<br>75 bản ghi | (mẫu 10 cũ) |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Mù nhãn theo mật độ phổ công suất      | <b>99,21</b> | <b>71,21</b>             | (59,15)     |
| Kênh cố định (kênh đầu tiên)           | 98,09        | <b>58,72</b>             | (77,34)     |
| Bản đồ đạo trình do giao thức quy định | 99,18        | —                        | —           |
| Oracle, dùng nhãn thật                 | 99,21        | 78,21                    | (77,59)     |
| Trung bình trên cả 4 kênh              | 97,45        | 64,78                    | (61,96)     |

**Phát hiện khoa học, phát biểu lại cho đúng**

Quy tắc chọn kênh mù nhãn đạt **đúng bằng oracle** khi ở trong miền (99,21 so với 99,21), và **vẫn là quy tắc mù nhãn tốt nhất** khi ra ngoài miền (71,21 so với 58,72 của kênh cố định). Nó **không** sụp đổ.

Điều thật sự sụp là **khoảng cách đến oracle**: trong miền quy tắc PSD kém oracle **0,02–1,90 điểm** (PhysioNet 0,02; Silesia B2 0,66; Silesia B1 1,90); ngoài miền nó kém oracle **7,00 điểm** (71,21 so với 78,21), và với mô hình 22 ca là **7,47 điểm**. Quy tắc chỉ chọn trùng kênh oracle ở 22/75 bản ghi.

Nói cách khác: một chỉ số chất lượng dựa trên phổ **mất phần lớn giá trị** đúng ở nơi ta cần


nó nhất. **Đây vẫn là động cơ đã đo được cho đóng góp C3** — nhưng ở mức “mất 7 điểm”, không phải “sụp đổ hoàn toàn” như bản 3.2 viết.

## 5.4. Kết quả cuối trên ADFECGDB

**Bảng 15:** Hiệu năng FETALQRS-TCN, tách theo bản ghi, dung sai  $\pm 50$  ms. Mỗi bản ghi được chấm bằng checkpoint chưa từng nhìn thấy bản ghi đó.

| Giao thức                         | Macro F1         | Se       | PPV           | Jitter          |
|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------------|
| Kênh chọn mù nhân (báo cáo chính) | <b>99,21</b>     | 99,59    | 98,79         | 3,05 ms         |
| Trung bình trên cả 4 kênh         | 97,45            | 97,69    | 97,18         | 3,62 ms         |
| Ba seed, cả 4 kênh                | 97,16 $\pm$ 4,34 | 97,05    | 97,28         | 3,64 ms         |
| Gộp toàn cục (micro)              | 99,17            | TP 3.178 | FP 40   FN 13 | trên 3.191 nhịp |

## 5.5. Nơi hệ thống sụp đổ

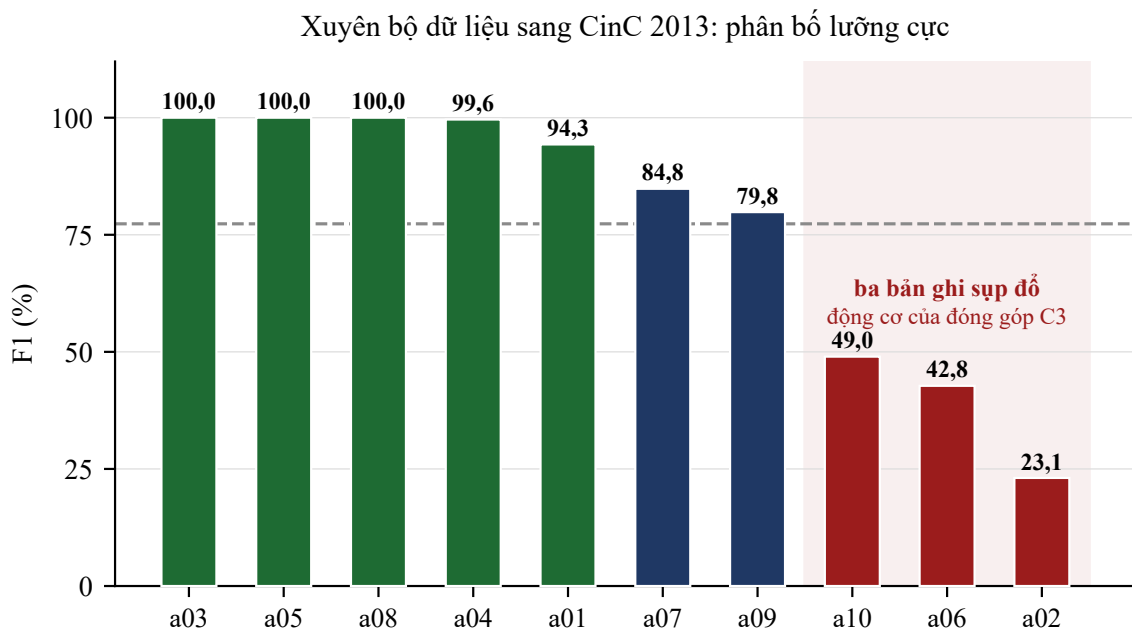

Đường 77,34 là trung bình của riêng mẫu 10 bản ghi này dưới quy tắc kênh 0 hậu kiểm; con số đó **ĐÃ BỊ RÚT**.  
Trên toàn bộ 75 bản ghi set-a, chính quy tắc ấy chỉ đạt 58,72. Số chính: xem hình CinC 75 bản ghi.

**Hình 9:** Chuyển sang PhysioNet/CinC 2013 mà không tinh chỉnh, **mẫu 10 bản ghi đầu tiên**. Phân bố **lưỡng cực**: bốn bản ghi hoàn hảo, ba bản ghi sụp dưới 50. Hình dạng này giữ nguyên trên toàn bộ 75 bản ghi (hình 13A) — ở đó 22/75 bản ghi dưới 50 với mô hình 5 ca.

Một hệ thống theo dõi thai mà im lặng đưa ra nhịp tim với độ chính xác 23% thì nguy hiểm hơn một hệ thống nói “tôi không đọc được tín hiệu này”. Đó chính là lý do C3 tồn tại. Con số quy

mô đầy đủ: trên 75 bản ghi, **22 bản ghi dưới 50** với mô hình 5 ca và 16 bản ghi với mô hình 22 ca (§5.10.3).

5.6. Baseline cổ điển tự cài lại

Bản đề cương trước thừa nhận một điểm yếu: mọi so sánh với y văn đều là so với *con số đã công bố*, không phải với bản tự chạy. Nhóm đã khắc phục. Ba baseline không dùng học máy được cài lại từ đầu trong `baselines/ts_baseline.py` và chấm trên **cùng dữ liệu, cùng giao thức, cùng hàm khớp nhịp** với mô hình của nhóm.

**Bảng 16:** Ba baseline cổ điển. Siêu tham số của mỗi baseline được chọn **chỉ trên r01** rồi áp nguyên cho bốn bản ghi còn lại; cột “16 giữ lại” loại r01 khỏi phép tính.

| Baseline   | Khử ECG mẹ                                                                     | Dò QRS thai                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TS         | Mẫu trung bình, trừ trực tiếp                                                  | Pan–Tompkins thích nghi, trơ 250 ms                                              |
| TS-PCA     | Mẫu từ 2 thành phần chính của các nhịp mẹ (theo Behar 2014)                    | Pan–Tompkins thích nghi                                                          |
| Prominence | <b>Đúng front-end của nhóm:</b> mẫu trung vị + bình phương tối thiểu từng nhịp | <code>find_peaks</code> , độ nhô $\geq$ trung vị +3 MAD, cách nhau $\geq$ 250 ms |

Baseline thứ ba là quan trọng nhất về mặt khoa học: nó dùng **cùng tín hiệu dư** mà mạng nhận vào, chỉ thay mạng bằng phép lấy đỉnh đơn giản. Hiệu số giữa nó và mô hình đo **đúng phần đóng góp của mạng nơ-ron**, tách khỏi phần đóng góp của tiền xử lý.

**Bảng 17:** Kết quả trên ADFECGDB, dung sai  $\pm 50$  ms. Hiệu số và khoảng tin cậy tính ở **mức chủ thể** ( $n = 5$  sản phụ, trung bình 4 kênh trước). Các trị số  $p$  của bản 3.2 tính trên 20 cặp (bản ghi  $\times$  kênh) là **giả lập** và đã bị gỡ — xem §10.

| Phương pháp         | 4 kênh (20)                        | 16 giữ lại   | Kênh PSD     | Hiệu số | KTC 95% bootstrap | KTC 95% $t$     |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|
| TS + PT             | 78,96 $\pm$ 23,52                  | 75,55        | 87,68        | −18,49  | [−30,60; −6,38]   | [−38,80; +1,81] |
| TS-PCA + PT         | 91,05 $\pm$ 10,17                  | 90,94        | 96,74        | −6,40   | [−8,09; −4,70]    | [−9,10; −3,69]  |
| Prominence          | 86,39 $\pm$ 11,14                  | 84,99        | 92,03        | −11,06  | [−14,51; −7,80]   | [−16,38; −5,73] |
| <b>FETALQRS-TCN</b> | <b>97,45 <math>\pm</math> 4,44</b> | <b>96,81</b> | <b>99,21</b> | —       | —                 | —               |

Ba baseline này **KHÔNG** cùng độ chắc — bản 3.2 trình bày chúng như nhau

Với **TS-PCA** và **Prominence**, KTC 95% của hiệu số loại trừ 0 ở **cả** bootstrap lẫn thang  $t$  — hướng kết quả vững, chỉ là không được tuyên bố ý nghĩa thống kê từ 5 phụ nữ.  
Với **TS** thì khác: KTC 95% kiểu  $t$  là [−38,80; +1,81] — **chứa 0**. Hiệu số 18,49 điểm hoàn toàn do biến thiên giữa 5 bản ghi, không phải một lợi thế ổn định. Đây là baseline yếu nhất về mặt bằng chứng, dù trông là baseline nhóm thắng đậm nhất.

Ba điều rút ra, xếp theo mức quan trọng:

1. **Mạng nơ-ron đáng +11,06 điểm** so với lấy đỉnh trên cùng tín hiệu dư, KTC 95% kiểu  $t$  [+5,73; +16,38] loại trừ 0. Đây là con số trả lời câu hỏi “mạng có thật sự cần không” — và câu trả lời là có, nhưng chỉ khi front-end đã đúng.
2. **TS-PCA là baseline cổ điển mạnh.** Trên kênh chọn mù nhân nó đạt 96,74, chỉ kém mô hình 2,47 điểm. Điều này nhất quán với Power-MF (98,0 bằng phương pháp cổ điển) và củng cố luận điểm chính: phần lớn hiệu năng nằm ở front-end, không ở mạng.
3. **Độ lệch chuẩn giảm hơn một nửa** (4,44 so với 10,17 của baseline tốt nhất). Mạng không chỉ cao hơn trung bình mà còn *ổn định hơn* giữa các sản phụ và kênh.

**Power-MF: bản 3.2 nói không chạy lại được — bản 3.4 đã chạy, ở hai cấu hình**

Bản 3.2 ghi rằng Power-MF cần MATLAB R2021a và các hàm ICA đa kênh của Varanini 2014 không có trong kho mã công bố, nên không chạy lại được. **Phát biểu đó đã bị rút.** Power-MF chạy được trên **GNU Octave 11.3.0** sau bảy bản vá, và được chấm bằng **chính bộ chấm của nhóm** trên cả **22 chủ thể**. Con số công bố cho Silesia B1 là 99,46; nhóm chạy lại được **99,40** — lệch 0,06 điểm.

Nhóm cài thêm **Power-MF-1ch**: cùng thuật toán, cùng front-end và bộ khử mẹ của nhóm, nhưng chỉ **một đạo trình**. Đây là đối chứng công bằng nhất trong cả đề cương, vì mọi thứ trừ thuật toán lõi đều giống hệt nhau. Nó đạt 86,71 — kém RELYFETAL 10,85 điểm, thua 22/22 chủ thể.

**Cảnh báo:** mọi con số Power-MF của bản 3.3 (94,87 / 98,38 / 97,33 / hiệu số +2,74 và -1,06) đứng trên một bản Octave hỏng vì lỗi cổng chuyển của nhóm, và **đã bị rút toàn bộ**. Xem hộp đầu §5.7.

## 5.7. Đối chuẩn với Power-MF chạy lại

**RÚT LẠI — mọi con số Power-MF của bản 3.3 đều sai, kể cả kết luận**

Bản 3.3 của chính đề cương này, viết sáng 12/09/2026, báo cáo **Power-MF đạt 94,87** trên 18 bản ghi chung và kết luận rằng **một phần nhỏ hỏng vì “hai bản ghi bắt cách nhịp”**, rồi loại hai bản ghi đó để ra con số **98,38 so với 97,33, hiệu số -1,06. Cả hai đều sai.**

Sai vì cả hai đứng trên một bản Power-MF **hỏng do lỗi cổng chuyển của chính nhóm**, không phải do thuật toán. Hàm findpeaks của gói signal trong Octave cài ràng buộc MinPeakDistance bằng một **ma trận khoảng cách đôi một** giữa các ứng viên đỉnh, tức  $O(k^2)$  bộ nhớ. Bản ghi Silesia B1 dài 1.197.800 mẫu, sau khi cắt đôi và nội suy  $\times 4$  thành 2.395.600 mẫu ở 4000 Hz, sinh ra hàng chục nghìn ứng viên; ma trận vượt giới hạn chỉ số của Octave và ném lỗi out of memory or dimension too large. Khối try/catch nội bộ của PowerMF.m nuốt lỗi đó. MATLAB — nền tảng tác giả dùng — giải ràng buộc này bằng



thuật toán tham  $O(k \log k)$  nên **không bao giờ gặp**.

Chữ ký “Se  $\approx 50\%$ , PPV  $\approx 99,7\%$ ” mà nhóm đọc thành “bắt cách nhịp” thật ra là **mất đúng một nửa bản ghi**: B1\_01 dò được 1.555 đỉnh, **toàn bộ nằm ở nửa đầu**, 0 đỉnh ở nửa sau; B1\_02 thì ngược lại, 0 đỉnh nửa đầu và 1.424 đỉnh nửa sau. Nửa nào chạy được thì chạy hoàn hảo: khoảng cách dò được trung vị 385,5 ms so với RR thật 386,0 ms.

Và giả thuyết đầu tiên của nhóm — “*ms\_minpeakdistance = 340 ms quá sát khoảng RR thai*” — **đã bị bác bỏ bằng số đo**. Nhóm đo RR thật từ nhãn tham chiếu (baselines/powermf\_rr\_diag.json): trên B1\_01, tỉ lệ khoảng RR ngắn hơn 340 ms là **0,00%**. Trên cả 27 bản ghi đã kiểm tra, giá trị lớn nhất là 0,15%. Ràng buộc 340 ms **chưa từng chặn một nhịp thật nào**.

### 5.7.1. Bài học phương pháp: nhóm đã phát biểu nguyên nhân trước khi đo

Đây là chỗ đáng nói nhất của mục này, và nhóm đề nó lên trước cả bảng số.

Khi thấy Power-MF hỏng trên 6 bản ghi B1, nhóm đã *đoán* ngay một nguyên nhân nghe rất hợp lý: tham số 340 ms quá sát nhịp tim thai 155 nhịp/phút. Giả thuyết đó khớp với trực giác, khớp với con số nhịp tim, và **sai**. Nhóm chỉ biết nó sai sau khi bỏ ra một buổi đọc *log* Octave từng bản ghi và đo phân bố RR thật. Nguyên nhân thật nằm ở một chi tiết cài đặt của thư viện, không nằm ở tham số nào của thuật toán.

Cái giá của lần đoán sai đó không nhỏ. Nếu nhóm tin vào giả thuyết 340 ms, nhóm sẽ *chỉnh tham số* cho Power-MF chạy được, và mọi so sánh về sau sẽ là so với một Power-MF **đã bị nhóm sửa tham số** — một baseline không còn đối chiếu được với bài gốc. Nhóm đã suýt làm đúng như vậy.

Nguyên tắc rút ra, nhóm áp dụng cho toàn bộ phần còn lại của đề tài: **không phát biểu nguyên nhân trước khi đo được nguyên nhân**. Một bản ghi hỏng thì đọc *log* của chính nó, không suy diễn từ tham số. Chi tiết đầy đủ ở §12.2.

### 5.7.2. Bản vá P7 và cách nó tái lập ngữ nghĩa MATLAB

baselines/octave/findpeaks\_mpd.m thay `findpeaks(x, 'MinPeakDistance', d)` bằng đúng ngữ nghĩa MATLAB: tìm mọi cực đại địa phương, sắp theo biên độ giảm dần, rồi tham lam nhận đỉnh cao nhất và loại mọi đỉnh cách nó dưới  $d$ . Cài bằng **danh sách liên kết đôi** nên mỗi ứng viên bị gỡ đúng một lần, tổng chi phí  $O(k)$  và không cần ma trận nào. Đo thật: 2.395.600 mẫu chạy trong 14,3 s.

Kiểm chứng đối chiếu baselines/octave/test\_fpmpd.m, 48 trường hợp: tập đỉnh của `findpeaks` Octave **luôn là tập con** của `findpeaks_mpd`, đúng 48/48. Chênh lệch đến từ bộ lọc bề rộng đỉnh mặc định của Octave (`MinPeakWidth`, ước lượng bằng khớp parabol) mà MATLAB **không có** khi chỉ truyền `MinPeakDistance`. Nghĩa là P7 kéo bản Octave **lại gần** bản MATLAB gốc, chứ không đẩy ra xa. Vì P7 đổi ngữ nghĩa, **toàn bộ 27 bản ghi đã được chạy lại** bằng cùng



một bản mã.

Tham số `ms_minpeakdistance` **giữ nguyên 340 ms**, đúng giá trị mặc định của tác giả, ở mọi lần chạy trong mục này. Nhóm không sửa một tham số nào của Power-MF.

#### Kiểm chứng ngoài — bằng chứng mạnh nhất rằng cổng chuyển giờ đã đúng

Số **đã công bố** của chính tác giả cho Silesia B1 là **99,46** (nhóm trích từ `Results/*.mat` của kho gốc, lưu ở `baselines/powermf_published.json`). Sau bản vá P7, nhóm chạy lại trên đúng 10 bản ghi đó và được **99,40 ± 0,51**.

#### Lệch 0,06 điểm F1.

Đây là kiểm chứng **ngoài**: con số đối chiếu do người khác công bố, trên máy khác, bằng MATLAB, trước khi nhóm bắt tay vào bài toán này. Nhóm không có cách nào “khớp” vào nó. Mức lệch 0,06 điểm nằm trong sai khác biên của `filtfilt` giữa hai nền tảng. Trước P7, con số tương ứng là **88,19** và chỉ trên 6 bản ghi chạy được — lệch **11,3 điểm**.

Nói cách khác: bản chạy lại **đã sai 11,3 điểm và giờ sai 0,06 điểm**. Mọi con số Power-MF trong đề cương từ đây trở đi đứng trên bản sau.

### 5.7.3. Ba cột: Power-MF đa kênh, Power-MF đơn kênh, và RELYFETAL

Để trả lời được câu hỏi thật của đề tài, một cột Power-MF là không đủ. Nhóm cài thêm **Power-MF-1ch**: chính bộ dò của Jaeger 2024 nhưng chạy ở chế độ **đơn kênh**.

#### Power-MF-1ch — đối chứng công bằng nhất trong cả đề tài

Cài bằng Python/scipy thuần (`baselines/powermf_1ch.py`), đặc tả lấy từ 21 bước đọc trực tiếp `PowerMF.m` (`survey/scout_baselines.md` mục 3). Giữ nguyên:

- nội suy  $\times 4$  trước khi dò, đúng như bản gốc;
- bao hình **đạo hàm** của tín hiệu dư;
- mẫu nhịp mẹ bằng **trung vị** các nhịp đã căn;
- **bộ lọc phối hợp** với mẫu fQRS, và `ms_minpeakdistance = 340 ms`.

Bỏ đúng hai khối, vì cả hai **bắt buộc phải có nhiều kênh**: `FecgICAm` và `FecgICAf`. Quy tắc chọn kênh theo mật độ phổ công suất của tác giả được thay bằng **chính quy tắc PSD mù nhân của nhóm**, để hai bên chọn kênh giống hệt nhau.

Front-end và bộ khử mẹ dùng **cùng một hàm** với mô hình của nhóm: `M.preprocess` (10–60 Hz, notch 50 Hz, hạ về 250 Hz) và `M.cancel_maternal` (mẫu trung vị + bình phương tối thiểu từng nhịp). Chấm bằng `M.match_events`, dung sai  $\pm 50$  ms, ghép tham lam 1–1 — **không** dùng `Bxb_compare` của kho gốc, để hai bên không thể khác nhau vì bộ chấm.

Vì vậy cột Power-MF-1ch là đối chứng **sạch nhất** nhóm có: cùng dữ liệu, cùng đạo trình, cùng tiền xử lý, cùng khử mẹ, cùng bộ chấm. **Khác biệt duy nhất còn lại là thuật toán lõi**

— bộ lọc phối hợp cổ điển so với mạng nơ-ron 113.481 tham số.

**Bảng 18:** F1 trung bình (%) trên 22 chủ thể, chấm bằng cùng một bộ chấm ( $\pm 50$  ms, ghép tham lam 1–1). Nguồn: `baselines/powermf_fair_stats.json` và `baselines/powermf_1ch.json`. Hai cột giữa là **cùng một thuật toán**, chỉ khác số đạo trình được dùng.

| Tập                                           | $n$ | Power-MF<br>4 đạo trình            | Power-MF-1ch<br>1 đạo trình | RELYFETAL<br>1 đạo trình           |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ADFECDGB (chuyển dạ)                          | 5   | 99,01 $\pm$ 1,05                   | 92,37 $\pm$ 2,78            | 99,40 $\pm$ 1,01                   |
| Silesia B2 (chuyển dạ)                        | 7   | 97,90 $\pm$ 3,77                   | 87,28 $\pm$ 18,05           | 96,82 $\pm$ 7,55                   |
| Silesia B1 (thai kỳ)                          | 10  | 99,40 $\pm$ 0,51                   | 83,48 $\pm$ 16,28           | 97,15 $\pm$ 4,95                   |
| <b>TẤT CẢ 22 chủ thể</b>                      | 22  | <b>98,83 <math>\pm</math> 2,20</b> | 86,71 $\pm$ 14,87           | <b>97,56 <math>\pm</math> 5,30</b> |
| CinC 2013 set-a, 60 bản<br>sạch (hệ ghi khác) | 60  | <i>chưa chạy</i>                   | 55,97                       | <b>74,28</b>                       |

Hàng CinC 2013 đáng chú ý riêng. Đó là hệ ghi hoàn toàn khác, không bản ghi nào từng được huấn luyện, và cả hai phương pháp đơn kênh đều rơi. Nhưng Power-MF-1ch rơi xuống 55,97 còn RELYFETAL giữ được 74,28 (hiệu +18,32, KTC 95% [+13,35; +23,64], 49 thắng / 5 thua / 6 hoà trên 60 bản sạch; bản 3.4 ghi 62,82 so với 79,40 trên 75 bản, đã rút — §5.10.3). Nhóm **chưa chạy** Power-MF 4 kênh trên CinC 2013 — ô đó để trống, không điền bằng suy đoán.

**Bảng 19:** F1 từng chủ thể (%). Cột RELYFETAL là mô hình 22 ca, đánh giá bỏ-một-chủ-thể. Ba hàng in đậm là ba bản ghi RELYFETAL thua nặng.

| Chủ thể      | Tập        | Power-MF<br>4 kênh | Power-MF-1ch | RELYFETAL    |
|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| r01          | ADFECDGB   | 99,69              | 92,33        | 99,92        |
| r04          | ADFECDGB   | 99,53              | 92,41        | 99,68        |
| r07          | ADFECDGB   | 99,20              | 90,17        | 100,00       |
| r08          | ADFECDGB   | 99,46              | 90,05        | 99,77        |
| r10          | ADFECDGB   | 97,15              | 96,91        | 97,61        |
| <b>B2_03</b> | Silesia B2 | <b>89,49</b>       | 47,97        | <b>79,72</b> |
| B2_04        | Silesia B2 | 97,95              | 97,88        | 98,90        |
| B2_05        | Silesia B2 | 99,70              | 90,77        | 100,00       |
| B2_06        | Silesia B2 | 99,85              | 99,56        | 100,00       |
| B2_08        | Silesia B2 | 99,77              | 86,13        | 100,00       |
| B2_09        | Silesia B2 | 98,74              | 98,44        | 99,11        |
| B2_12        | Silesia B2 | 99,77              | 90,23        | 100,00       |
| B1_01        | Silesia B1 | 99,92              | 95,25        | 99,97        |
| B1_02        | Silesia B1 | 99,55              | 98,73        | 99,79        |
| B1_03        | Silesia B1 | 98,97              | 91,30        | 99,92        |
| B1_04        | Silesia B1 | 99,86              | 99,98        | 100,00       |
| B1_05        | Silesia B1 | 99,66              | 93,83        | 99,87        |
| <b>B1_06</b> | Silesia B1 | <b>99,97</b>       | 54,36        | <b>89,45</b> |
| <b>B1_07</b> | Silesia B1 | <b>99,44</b>       | 63,36        | <b>86,56</b> |
| B1_08        | Silesia B1 | 99,31              | 83,50        | 99,83        |
| B1_09        | Silesia B1 | 98,39              | 88,27        | 99,07        |
| B1_10        | Silesia B1 | 98,91              | 66,18        | 97,05        |

#### 5.7.4. Thống kê mức chủ thể: ba phép so sánh trên bốn tập con


Đơn vị phân tích là **chủ thể**, không phải cặp (bản ghi  $\times$  kênh). Khoảng tin cậy 95% tính bằng cluster bootstrap 10.000 lần lấy mẫu lại **chủ thể** có hoàn lại, seed 0. Kèm Wilcoxon ghép cặp và Cliff  $\delta$ . Mã: `baselines/powermf_fair_table.py`.

**Bảng 20:** Toàn bộ so sánh mức chủ thể. Hiệu số dương nghĩa là phương pháp bên trái cao hơn. T/H/Th = thắng/hòa/thua theo chủ thể. Nguồn: baselines/powermf\_fair\_stats.json.

| Tập             | So sánh                        | Hiệu số | KTC 95% bootstrap | $p$     | Cliff  | T/H/Th        |
|-----------------|--------------------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------------|
| Tất cả 22       | RELYFETAL — Power-MF 4 kênh    | −1,27   | [−3,08; +0,27]    | 0,156   | 0,260  | 18/0/4        |
|                 | RELYFETAL — Power-MF-1ch       | +10,85  | [+6,80; +15,40]   | 4,77e−7 | 0,698  | <b>22/0/0</b> |
|                 | Power-MF-1ch — Power-MF 4 kênh | −12,12  | [−18,27; −6,90]   | 1,43e−6 | −0,773 | 1/0/21        |
| ADFE CGDB (5)   | RELYFETAL — Power-MF 4 kênh    | +0,39   | [+0,22; +0,60]    | 0,0625  | 0,600  | 5/0/0         |
|                 | RELYFETAL — Power-MF-1ch       | +7,02   | [+3,84; +9,34]    | 0,0625  | 1,000  | 5/0/0         |
|                 | Power-MF-1ch — Power-MF 4 kênh | −6,63   | [−8,88; −3,37]    | 0,0625  | −1,000 | 0/0/5         |
| Silesia B2 (7)  | RELYFETAL — Power-MF 4 kênh    | −1,08   | [−4,04; +0,54]    | 0,297   | 0,388  | 6/0/1         |
|                 | RELYFETAL — Power-MF-1ch       | +9,54   | [+3,09; +17,87]   | 0,0156  | 0,673  | 7/0/0         |
|                 | Power-MF-1ch — Power-MF 4 kênh | −10,61  | [−21,84; −2,67]   | 0,0156  | −0,673 | 0/0/7         |
| Silesia B1 (10) | RELYFETAL — Power-MF 4 kênh    | −2,25   | [−5,55; +0,32]    | 1,000   | 0,080  | 7/0/3         |
|                 | RELYFETAL — Power-MF-1ch       | +13,68  | [+6,91; +21,27]   | 0,00195 | 0,620  | 10/0/0        |
|                 | Power-MF-1ch — Power-MF 4 kênh | −15,92  | [−25,93; −7,05]   | 0,00391 | −0,780 | 1/0/9         |

Một chi tiết phải đọc đúng. Ở ADFECGDB, KTC 95% của hiệu số là  $[+0,22; +0,60]$  — **không chứa 0**, và thắng 5/5. Nhưng  $p$  Wilcoxon là 0,0625, vì với  $n = 5$  chủ thể, giá trị  $p$  hai phía **nhỏ nhất có thể đạt** là  $2/2^5 = 0,0625$ . Không phép kiểm định nào trên 5 chủ thể xuống được dưới 0,05, dù hiệu số lớn đến đâu. Nhóm báo cáo khoảng tin cậy, không tuyên bố “có ý nghĩa thống kê” từ 5 sản phụ.

Tách nguồn đa kênh đáng 12,12 điểm F1 — mạng đơn kênh lấy lại 10,85 điểm (89,5%)

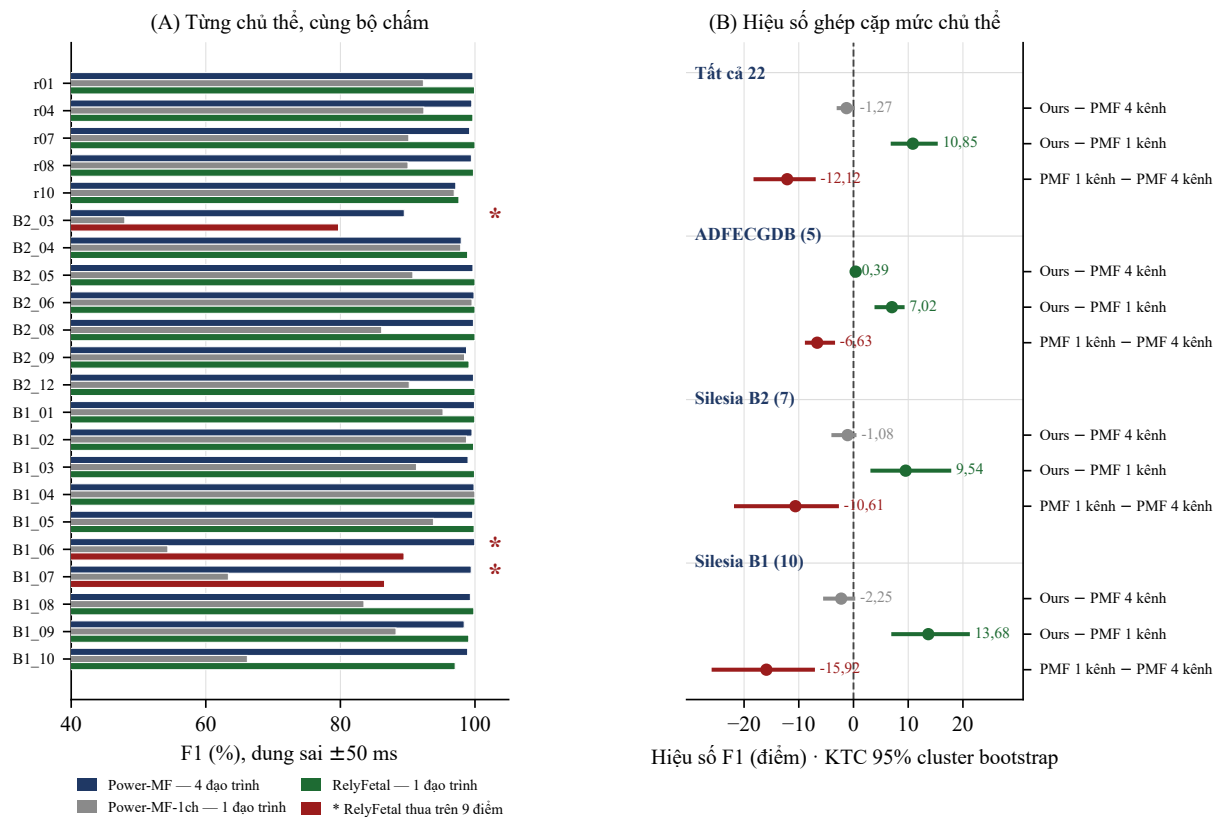

**Hình 10:** (A) F1 từng chủ thể ở ba cấu hình, cùng bộ chấm  $\pm 50$  ms. Ba chủ thể có dấu sao là ba bản ghi RELYFETAL thua nặng — và Power-MF-1ch cũng sụp ở đúng ba chỗ đó. (B) Hiệu số ghép cặp và KTC 95% cluster bootstrap theo tập con, cho cả ba phép so sánh.

### 5.7.5. Ba bản ghi kéo tụt trung bình — và vì sao phải báo cáo cả trung vị

**Bảng 21:** Ba chủ thể RELYFETAL thua Power-MF đa kênh quá 9 điểm. Mọi chủ thể còn lại đều thắng, trừ B1\_10 thua nhẹ.

| Chủ thể | RELYFETAL | Power-MF<br>4 kênh | Hiệu số | Power-MF-1ch<br>cùng bản ghi |
|---------|-----------|--------------------|---------|------------------------------|
| B1_07   | 86,56     | 99,44              | -12,88  | 63,36                        |
| B1_06   | 89,45     | 99,97              | -10,51  | 54,36                        |
| B2_03   | 79,72     | 89,49              | -9,77   | 47,97                        |
| B1_10   | 97,05     | 98,91              | -1,86   | 66,18                        |

Đây là chỗ nhóm phải nói thẳng cả hai mặt, vì cả hai đều thật.

**Mặt thứ nhất:** nếu nhìn **trung bình**, RELYFETAL *thua* 1,27 điểm F1. **Mặt thứ hai:** nếu nhìn **trung vị**, RELYFETAL *hơn* +0,23 điểm, và thắng **18 trên 22** chủ thể.

Hai con số đó không mâu thuẫn. Chúng nói rằng phân bố hiệu số **lệch mạnh**: đa số chủ thể RELYFETAL hơn một chút, còn ba chủ thể thì thua rất nặng, và ba chủ thể đó một mình kéo trung

bình xuống âm. Trung bình bị ba điểm ngoại lai chi phối; trung vị thì không. Đọc một con số mà bỏ con số kia đều là đọc sai, nên nhóm báo cáo cả hai ở mọi chỗ.

Nhóm **không** loại ba bản ghi này. Bài học của bản 3.3 là: loại bản ghi khi chưa hiểu nguyên nhân thì sẽ ra kết luận sai — lần đó nhóm loại hai bản ghi và ra con số 98,38 hoàn toàn hư cấu. Lần này ba bản ghi được giữ nguyên trong mọi phép tính.

Một điều đáng chú ý: trên đúng ba bản ghi đó, **Power-MF-1ch cũng sụp** — 63,36 / 54,36 / 47,97, tức còn tệ hơn RELYFETAL nhiều. Nghĩa là đây là ba bản ghi mà **tín hiệu một đạo trình thật sự không đủ**, chứ không phải ba bản ghi mà mạng nơ-ron kém. Cả hai phương pháp đơn kênh đều hỏng ở đúng những chỗ đó, và chỉ tách nguồn đa kênh cứu được. Nhóm xem đây là giới hạn của *cấu hình đơn kênh*, không phải của *mô hình*. Đó cũng chính là lý do đề tài cần một công từ chối trả lời (§7): khi một đạo trình không đủ, hệ thống phải nói “không đọc được” thay vì đưa ra một nhịp tim sai.

#### 5.7.6. Luận đề đúng của đề tài: lấy lại 89,5 % lợi ích của đa kênh bằng một kênh

Câu hỏi mà mục này thật sự trả lời không phải “ai hơn ai”. Nó là:

*Một mạng đơn kênh 113.481 tham số lấy lại được bao nhiêu phần của lợi ích mà tách nguồn đa kênh mang lại?*

Câu hỏi này đo được, vì nhóm có cả ba cột.

1. **Tách nguồn đa kênh đáng bao nhiêu?** Lấy *chính* Power-MF và bỏ hai khối ICA đa kênh đi: 98,83 → 86,71. Mất **12,12 điểm F1**, KTC 95% [−18,27; −6,90],  $p = 1,43e-6$ , thua 21/22 chủ thể. Đây là **giá của đa kênh**, đo trên cùng một thuật toán nên không lẫn với bất kỳ khác biệt nào khác.
2. **Mô hình đơn kênh lấy lại bao nhiêu?** Trên cùng một đạo trình, RELYFETAL hơn Power-MF-1ch **10,85 điểm**, KTC 95% [+6,80; +15,40],  $p = 4,77e-7$ , thắng **22/22** chủ thể.
3. **Tỉ lệ:**  $10,85/12,12 = 89,5\%$ . Mạng đơn kênh lấy lại gần chín phần mười lợi ích của tách nguồn đa kênh, **bằng một đạo trình duy nhất**.

Hệ quả: trên 22 chủ thể độc lập, RELYFETAL **không phân biệt được** với Power-MF đa kênh (−1,27 điểm; KTC 95% [−3,08; +0,27];  $p = 0,156$ ), và **hơn hẳn** Power-MF khi Power-MF bị giới hạn về cùng một đạo trình (+10,85 điểm; 22/22).

**Phát biểu đúng — đây là câu nhóm sẽ dùng trong bài báo, nguyên văn**

*“Trên 22 chủ thể độc lập, chấm bằng cùng một giao thức ( $\pm 50$  ms, ghép tham lam 1–1), bỏ hai khối ICA đa kênh khỏi Power-MF làm chính nó mất 12,12 điểm F1 (KTC 95% cluster*

*bootstrap*  $[-18,27; -6,90]$ ). Một mô hình đơn kênh 113.481 tham số lấy lại 10,85 điểm trong số đó (KTC 95%  $[+6,80; +15,40]$ ; Wilcoxon  $p = 4,77e-7$ ; thắng 22/22 chủ thể), tức **89,5 % lợi ích của tách nguồn đa kênh, bằng một đạo trình duy nhất**. So với Power-MF đa kênh đầy đủ, hiệu số là  $-1,27$  điểm (KTC 95%  $[-3,08; +0,27]$ ;  $p = 0,156$ ; trung vị hiệu số  $+0,23$ ; thắng 18/22) — **không phân biệt được**.”

### Ba điều KHÔNG được nói kèm phát biểu trên

1. **Không nói “vượt trội”, “SOTA”, hay “đầu tiên”**. Trên B2 và B1, hiệu số so với Power-MF đa kênh là âm; Power-MF nhỉnh hơn, chỉ là khoảng tin cậy vẫn chứa 0. Trên trung bình toàn tập RELYFETAL thua 1,27 điểm. “Không phân biệt được” là cụm từ đúng; “hơn” thì không.
2. **Không nói Power-MF yếu trên thai kỳ**. Power-MF đạt 99,40 trên Silesia B1 — cao hơn RELYFETAL 2,25 điểm, và gần như trùng số công bố của chính tác giả. Mọi ấn tượng ngược lại ở bản 3.3 là do lỗi công chuyển của nhóm, và đã được rút ở hộp đầu mục này.
3. **Không nói 89,5 % là một hằng số**. Nó là tỉ số giữa hai hiệu số ước lượng, mỗi hiệu số có khoảng tin cậy riêng khá rộng. Nhóm **chưa** tính KTC cho chính tỉ số này. Cách phát biểu an toàn là “phần lớn, khoảng chín phần mười”. Nhóm không viết “89,5 %  $\pm$  gì đó” vì chưa đo được sai số đó.

### 5.7.7. Ý nghĩa với định vị của cả đề tài

Trước mục này, C1 (đối chuẩn công bằng) dựa vào một con số trích từ y văn. Giờ nó dựa vào ba cột tự đo trên cùng một máy, cùng dữ liệu, cùng bộ chấm — và một trong ba cột tái lập được số công bố của tác giả đến 0,06 điểm.

Quan trọng hơn: nhóm không còn phải tranh luận “học sâu có thắng xử lý tín hiệu cổ điển không”. Câu hỏi đó **sai ngay từ cách đặt**, vì hai bên không dùng cùng số đạo trình. Câu hỏi đúng là câu hỏi ở §5.7.6, và nó có câu trả lời bằng số: 89,5 %.

Điều RELYFETAL mua được so với Power-MF đa kênh không phải là F1 cao hơn. Đó là: **một đạo trình thay vì bốn** — một miếng dán đeo được tại nhà, thay vì một bộ điện cực bụng cần kỹ thuật viên đặt đúng vị trí; 113.481 tham số và 4,35 ms mỗi cửa sổ 4 giây; và một cổng từ chối trả lời, thứ mà Power-MF không có, cũng không cần, vì Power-MF không được thiết kế để chạy không giám sát.

### 5.8. Mở rộng sang 22 sản phụ và sang thai kỳ

Điểm yếu lớn nhất của bản đề cương trước là chỉ có 5 sản phụ, tất cả đang chuyển dạ. Nhóm đã tải bộ Silesia (Matonia và cộng sự, *Scientific Data* 7:200, 2020; figshare DOI 10.6084/m9.figshare.c.4740794, giấy phép CC0), gồm **10 sản phụ thai kỳ 32–42 tuần** (B1,

mỗi người 20 phút) và **12 sản phụ chuyển dạ** (B2, mỗi người 5 phút), cùng bệnh viện và cùng hệ ghi KOMPOREL với dữ liệu huấn luyện. Toàn bộ do `model/download_silesia.py` tải với mã băm SHA-256 ghi lại.

### 5.8.1. Kiểm tra rò rỉ trước khi đánh giá

Bài báo gốc tự khai rằng 5 bản ghi PhysioNet được lấy từ bộ chuyển dạ. Nhóm không tin lời khai mà đo lại bằng tín hiệu: đưa cả hai về 250 Hz, trượt cửa sổ 60 giây của từng bản ghi PhysioNet trên toàn bộ từng bản ghi B2, thử mọi tổ hợp  $4 \times 4$  đạo trình và mọi độ lệch  $\pm 5$  phút.

**Bảng 22:** Kết quả kiểm tra rò rỉ. NCC là tương quan chéo chuẩn hoá cực đại. Cột “hạng nhì” là NCC với bản ghi B2 gần nhất còn lại, để thấy khoảng cách.

| PhysioNet | Silesia | NCC   | Lệch   | Hạng nhì | Nhãn khớp | Số nhịp   |
|-----------|---------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| r01       | B2_01   | 0,989 | −56 ms | 0,135    | 100,0%    | 644 / 644 |
| r10       | B2_02   | 0,993 | −40 ms | 0,147    | 99,8%     | 637 / 637 |
| r04       | B2_07   | 0,994 | −48 ms | 0,178    | 99,8%     | 632 / 632 |
| r07       | B2_10   | 0,994 | −48 ms | 0,141    | 99,8%     | 627 / 627 |
| r08       | B2_11   | 0,988 | −56 ms | 0,128    | 98,8%     | 651 / 646 |

Kết luận: 5/12 bản ghi B2 **chính là 5** bản ghi PhysioNet. Hệ quả thứ nhất: số sản phụ độc lập là **22**, không phải 27. Hệ quả thứ hai: với 5 bản ghi trùng, nhóm dùng checkpoint fold tương ứng (chưa từng thấy bản ghi đó); 7 bản ghi B2 còn lại và 10 bản ghi B1 dùng checkpoint production, zero-shot.

### 5.8.2. Kết quả

**Bảng 23:** Cùng một mô hình, cùng giao thức  $\pm 50$  ms, trên năm cấu hình dữ liệu. “ $\geq 90$ ” và “ $< 50$ ” là số bản ghi có F1 (kênh PSD) trong khoảng đó.

| Bộ dữ liệu                                      | $n$ | Phút  | F1, kênh PSD                        | F1, 4 kênh                         | $\geq 90$ | $< 50$    |
|-------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| ADFECDGB PhysioNet, tách bản ghi                | 5   | 25    | $99,21 \pm 1,50$                    | $97,45 \pm 2,96$                   | 5         | 0         |
| Silesia B2 chuyển dạ, 12 bản ghi                | 12  | 60    | $97,17 \pm 7,45$                    | $95,26 \pm 9,59$                   | 11        | 0         |
| chỉ 7 bản ghi hoàn toàn mới, zero-shot          | 7   | 35    | $95,87 \pm 9,75$                    | $93,73 \pm 12,48$                  | 6         | 0         |
| <b>Silesia B1 thai kỳ 32–42 tuần, zero-shot</b> | 10  | 199,6 | <b><math>93,30 \pm 13,46</math></b> | <b><math>91,31 \pm 9,99</math></b> | 8         | 0         |
| CinC 2013 set-a, zero-shot, <b>toàn bộ</b>      | 75  | 75    | $71,21 \pm 33,96$                   | $64,78 \pm 29,89$                  | 42        | <b>22</b> |



**Bảng 24:** Silesia B1 — thai kỳ, từng bản ghi. Mô hình chưa từng thấy bất kỳ dữ liệu thai kỳ nào. Cột “oracle” là kênh tốt nhất theo nhãn, chỉ để tham chiếu.

| Bản ghi      | Kênh PSD | F1 PSD               | Se           | PPV          | Jitter        | F1 4 kênh           | Oracle              |
|--------------|----------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| B1_01        | A3       | 97,70                | 96,70        | 98,72        | 10,3 ms       | 87,79               | 97,70               |
| B1_02        | A3       | 99,59                | 99,50        | 99,68        | 9,1 ms        | 97,97               | 99,59               |
| B1_03        | A3       | 99,86                | 99,88        | 99,84        | 2,5 ms        | 99,17               | 99,86               |
| B1_04        | A3       | 99,80                | 99,64        | 99,96        | 3,8 ms        | 98,59               | 99,96               |
| B1_05        | A3       | 99,78                | 99,75        | 99,82        | 3,6 ms        | 99,47               | 99,78               |
| B1_06        | A4       | 80,90                | 78,05        | 83,95        | 12,5 ms       | 92,43               | 98,28               |
| B1_07        | A4       | <b>58,72</b>         | 53,21        | 65,49        | 15,3 ms       | 67,96               | 78,52               |
| B1_08        | A1       | 99,52                | 99,28        | 99,76        | 7,3 ms        | 98,27               | 99,52               |
| B1_09        | A3       | 99,04                | 98,92        | 99,16        | 4,6 ms        | 86,66               | 99,04               |
| B1_10        | A3       | 98,12                | 98,46        | 97,78        | 13,2 ms       | 84,76               | 98,12               |
| <b>Macro</b> |          | <b>93,30 ± 13,46</b> | <b>92,34</b> | <b>94,42</b> | <b>8,2 ms</b> | <b>91,31 ± 9,99</b> | <b>97,04 ± 6,56</b> |

Gộp toàn cục trên B1: 26.085 nhịp đúng, 1.451 báo động giả, 2.320 nhịp sót trên 28.405 nhịp có nhãn.

### 5.8.3. Đọc kết quả

- Mô hình tổng quát được sang thai kỳ.** Huấn luyện chỉ trên 5 ca chuyển dạ, chưa từng thấy dữ liệu thai kỳ, mà đạt 93,30 trên 10 sản phụ tuần 32–42. Tám trên mười bản ghi trên 90, **không bản ghi nào dưới 50**. Phân bố này *không* lường cực như CinC 2013.
- Sụp đổ trên CinC 2013 không phải do giai đoạn thai.** Chuyển từ chuyển dạ sang thai kỳ trong cùng hệ ghi mất khoảng 4 điểm (97 → 93). Chuyển sang hệ ghi khác, trên 60 bản ghi sạch của CinC 2013, mất **khoảng 35 điểm** (99 → 64; bản 3.4 ghi “26 điểm, 97 → 71” trên 75 bản, đã rút — §5.10.3). Biến gây sụp đổ là **thiết bị và bố trí điện cực**, không phải tuổi thai. (Bản 3.2 ghi “mất 38 điểm, 97 → 59”; con số 59 đo trên mẫu 10 bản ghi bị lệch — xem §5.10.3.)
- Quy tắc chọn kênh PSD yếu đi khi tín hiệu thai yếu.** Hai bản ghi kém nhất (B1\_06, B1\_07) đều do quy tắc PSD chọn đúng kênh xấu nhất; với kênh tốt nhất chúng đạt 98,28 và 78,52. B1\_07 là bản ghi có tín hiệu thai yếu nhất bộ theo chính tác giả. Đây là bằng chứng thứ hai (sau CinC) rằng heuristic phổ cần được thay bằng công học được.
- Bản ghi B2 yếu duy nhất có lý do ghi trong tài liệu gốc.** B2\_03 đạt 73,81; tác giả ghi “mất tín hiệu 27,5%” cho nhịp tim tham chiếu của chính bản ghi này.

### Nhãn B1 không phải chuẩn vàng — phải nói rõ khi công bố

Thai kỳ không thể gắn điện cực da đầu. Nhãn nhịp thai của B1 do tác giả tạo bằng cách khử ECG mẹ, dò tự động, rồi chuyên gia sửa tay và gắn cờ tin cậy (0,46% nhịp cờ 0; bỏ chúng đi kết quả không đổi). Vì vậy F1 trên B1 đo *mức đồng thuận với pipeline của tác giả*, không phải sự thật sinh lý. Nhóm còn đo được nhãn B1 lệch hệ thống 8–12 ms sau đỉnh R bụng ở 5/10 bản ghi; lệch này nằm trong dung sai 50 ms nên không ảnh hưởng F1, nhưng jitter trên B1 (8,2 ms) không so sánh được với B2 (2,9 ms).


Silesia cùng bệnh viện, cùng hệ ghi, cùng bố trí điện cực với dữ liệu huấn luyện. Kết quả này chứng minh tổng quát sang **giai đoạn thai kỳ**, chưa chứng minh tổng quát sang **hệ thống ghi khác**. Các con số trong mục này là của mô hình 5 ca; mô hình huấn luyện lại trên 22 ca ở §5.10.

## 5.9. Độ bền với nhiễu: đường cong F1–SNR

Câu hỏi reviewer chắc chắn sẽ đặt: mô hình gây ở mức nhiễu nào, và có gây sớm hơn phương pháp cổ điển không? Nhóm trả lời bằng nhiễu thật từ MIT-BIH Noise Stress Test Database (Moody 1984): trôi đường nền (bw), nhiễu điện cực (em), nhiễu cơ (ma), và hỗn hợp ba loại (mix), nội suy từ 360 lên 1000 Hz rồi cộng vào tín hiệu bụng thô của ADFECGDB ở sáu mức SNR. Cùng một đoạn nhiễu (hạt giống cố định theo bản ghi, kênh, loại) được đưa cho cả mô hình lẫn TS-PCA. Mô hình dùng fold checkpoint chưa thấy bản ghi; TS-PCA dùng đúng siêu tham số đã chọn ở §5.6.

### Định nghĩa SNR phải đọc kỹ

$SNR = 10 \log_{10}(P_{\text{tín hiệu}}/P_{\text{nhiều}})$  với  $P_{\text{tín hiệu}}$  là phương sai của **toàn bộ** tín hiệu bụng thô — trong đó ECG mẹ áp đảo. Vì vậy “0 dB” ở đây nghĩa là nhiễu có công suất bằng cả tín hiệu bụng, tức *lớn hơn thành phần thai rất nhiều lần*. Đây là mức nhiễu cực nặng, không phải mức thường gặp.

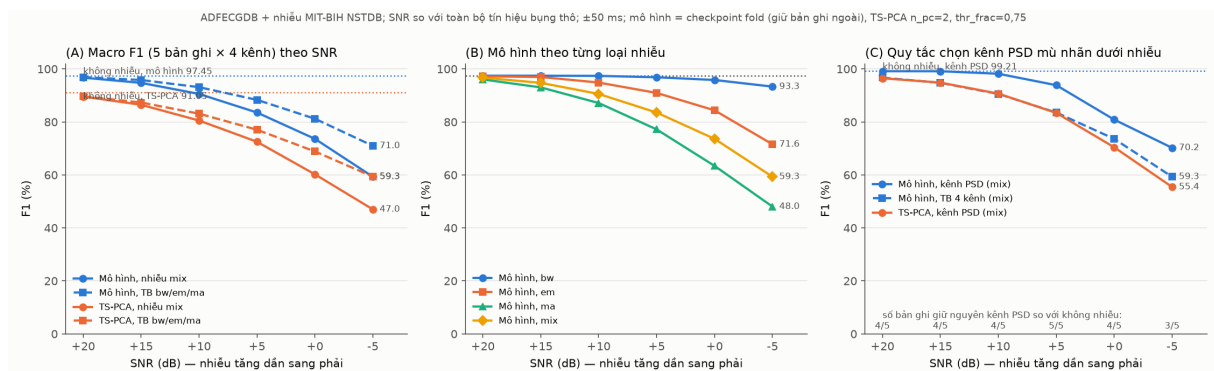

**Hình 11:** (A) Macro F1 theo SNR, mô hình so với TS-PCA, nhiễu hỗn hợp và trung bình ba loại. (B) Mô hình theo từng loại nhiễu: trôi nền gần như vô hại, nhiễu cơ hại nhất. (C) Quy tắc chọn kênh PSD mũ nhân dưới nhiễu, kèm số bản ghi giữ nguyên kênh đã chọn so với khi không nhiễu.

**Bảng 25:** Macro F1 (5 bản ghi  $\times$  4 kênh) theo SNR. Không nhiễu: mô hình 97,45, TS-PCA 91,05.

| Loại nhiễu                                  | +20 dB | +15   | +10    | +5     | 0             | −5           |
|---------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------------|
| <b>Mô hình</b>                              |        |       |        |        |               |              |
| Trôi nền (bw)                               | 97,45  | 97,44 | 97,38  | 96,87  | 95,83         | 93,33        |
| Điện cực (em)                               | 97,21  | 96,97 | 94,86  | 90,95  | 84,38         | 71,55        |
| Nhiều cơ (ma)                               | 96,04  | 93,03 | 87,13  | 77,18  | 63,41         | <b>48,03</b> |
| Hỗn hợp (mix)                               | 96,71  | 94,74 | 90,57  | 83,55  | 73,62         | 59,31        |
| <b>TS-PCA</b>                               |        |       |        |        |               |              |
| Trôi nền (bw)                               | 91,15  | 90,91 | 90,60  | 89,68  | 88,42         | 85,76        |
| Điện cực (em)                               | 90,56  | 89,17 | 84,96  | 79,50  | 69,81         | 56,79        |
| Nhiều cơ (ma)                               | 87,44  | 81,89 | 73,80  | 61,98  | 48,34         | 35,50        |
| Hỗn hợp (mix)                               | 89,58  | 86,46 | 80,52  | 72,51  | 60,22         | 47,00        |
| <b>Chênh lệch mô hình – TS-PCA, hỗn hợp</b> |        |       |        |        |               |              |
|                                             | +7,13  | +8,28 | +10,04 | +11,04 | <b>+13,40</b> | +12,31       |

Bốn điều rút ra:

1. **Trôi đường nền gần như vô hại.** Mô hình mất 4 điểm ở −5 dB. Đây là tính chất của bộ lọc 10–60 Hz: trôi nền nằm dưới 0,5 Hz và bị loại trước khi vào mạng. Kết quả này *không* nói lên độ bền của mạng, mà nói lên front-end đúng.
2. **Nhiều cơ là kẻ thù thật.** Phổ của nó trùng dải 10–60 Hz nên bộ lọc không cản được. Mô hình xuống dưới 90 ở khoảng +10 dB và dưới 80 ở +5 dB.
3. **Khoảng cách với cổ điển tăng khi nhiễu tăng:** từ +7 điểm khi sạch lên +13 điểm ở 0 dB hỗn hợp, +15 ở nhiễu cơ. Mạng không chỉ chính xác hơn mà còn *gây chậm hơn*.
4. **Quy tắc chọn kênh PSD ổn định đến 0 dB** (4/5 hoặc 5/5 bản ghi giữ nguyên kênh), chỉ đổi ở −5 dB (3/5). F1 trên kênh PSD dưới nhiễu hỗn hợp: 99,21 khi sạch, 70,2 ở −5 dB.

Mã tại `pilot_evidence/snr_curve.py`; toàn bộ lưới (bản ghi  $\times$  kênh  $\times$  loại  $\times$  SNR) trong `snr_curve.json`. Chạy 673 giây.

## 5.10. Huấn luyện lại trên 22 sản phụ

Mọi con số ở các mục trước đều từ mô hình học trên **5 ca chuyển dạ, 25 phút** dữ liệu. Nhóm đã huấn luyện lại trên **22 sản phụ độc lập, 260 phút**: 5 PhysioNet, 7 Silesia B2 không trùng, và

10 Silesia B1 thai kỳ. Mã tại `model/train_22.py` và `model/augment.py`.

### 5.10.1. Giao thức

Tách theo nhóm 11 fold, mỗi fold giữ lại 2 chủ thể (ghép một thai kỳ với một chuyển dạ khi có thể), một chủ thể validation riêng có nhãn da đầu để chọn ngưỡng, 19 chủ thể huấn luyện. Tăng cường dữ liệu trên từng đoạn khi huấn luyện, mỗi phép xác suất 0,5: nhân biên độ 0,7–1,4; cộng nhiễu Gauss ở SNR 10–30 dB; trôi đường nền hình sin 0,1–0,5 Hz; dịch thời gian  $\pm 100$  ms. Không tăng cường khi validation hay test. Bốn epoch (ngân sách 190 phút CPU), seed 0. Sau 11 fold, mô hình production huấn luyện trên cả 22.

Nhóm tự kiểm tra rò rỉ trên metadata của từng checkpoint: 11 fold có ba tập rời nhau, 22 chủ thể mỗi người đứng một lần, không có bản ghi nào trong nhóm 5 bản trùng PhysioNet. Một fold (fold 10) chọn ngưỡng 0,20 — cực đoan so với 0,65–0,80 của các fold khác; nhóm ghi nhận và không can thiệp.

### 5.10.2. Kết quả trên 22 chủ thể


**Bảng 26:** Mô hình 5 ca so với mô hình 22 ca trên cùng chủ thể và cùng kênh. Hiệu số và khoảng tin cậy tính ở **mức chủ thể** (trung bình 4 kênh trước). Cột  $p$  là Wilcoxon ghép cặp **trên chủ thể**, khác hẳn các trị số  $p$  trên cặp (bản ghi  $\times$  kênh) của bản 3.2 — xem §10.

| Nhóm                      | $n$ | Kênh PSD mù nhãn |              |            | Trung bình 4 kênh (đơn vị chủ thể) |              |         |                   | $p$        |
|---------------------------|-----|------------------|--------------|------------|------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|
|                           |     | 5 ca             | 22 ca        | thắng      | 5 ca                               | 22 ca        | hiệu số | KTC 95% bootstrap |            |
| PhysioNet chuyển dạ       | 5   | 99,21            | 99,40        | 2/2        | 97,45                              | 98,69        | +1,24   | [−0,35; +3,01]    | 0,8        |
| Silesia B2, ca mới        | 7   | 95,87            | 96,82        | 4/0        | 93,73                              | 94,50        | +0,77   | [−0,16; +2,38]    | <b>0,4</b> |
| <b>Silesia B1 thai kỳ</b> | 10  | 93,30            | <b>97,15</b> | <b>9/1</b> | 91,31                              | <b>97,01</b> | +5,71   | [+2,12; +10,17]   | 0,00       |
| <b>Toàn bộ</b>            | 22  | 95,46            | <b>97,56</b> | 15/3       | 93,47                              | <b>96,59</b> | +3,12   | [+1,27; +5,48]    | 0,00       |

#### Hai kết luận của bản 3.2 bị đảo chiều khi đổi đơn vị phân tích

**Silesia B2:** bản 3.2 ghi “cải thiện có ý nghĩa,  $p = 0,016$ ”. Trị số đó tính trên **28 cặp** (7 chủ thể  $\times$  4 kênh). Ở mức chủ thể,  $p = 0,47$  và Cliff  $\delta = 0,10$  (không đáng kể). Phát biểu “có ý nghĩa” **bị rút**.

**PhysioNet:**  $p$  từ 0,24 thành 0,81 — vẫn là “không khác”, như kỳ vọng vì mô hình 5 ca đã ở 99,21. Nhưng lưu ý: với  $n = 5$ , **không** kết luận nào ở đây được phép gọi là có ý nghĩa thống kê. Chỉ hai hàng cuối ( $n = 10$  và  $n = 22$ ) có  $p$  dưới 0,05, và ngay cả với  $n = 22$  thì sign test cho  $p = 0,0525$ : kết quả phụ thuộc vào **độ lớn** cải thiện ở vài chủ thể, không phải vào việc đa số chủ thể đều cải thiện.

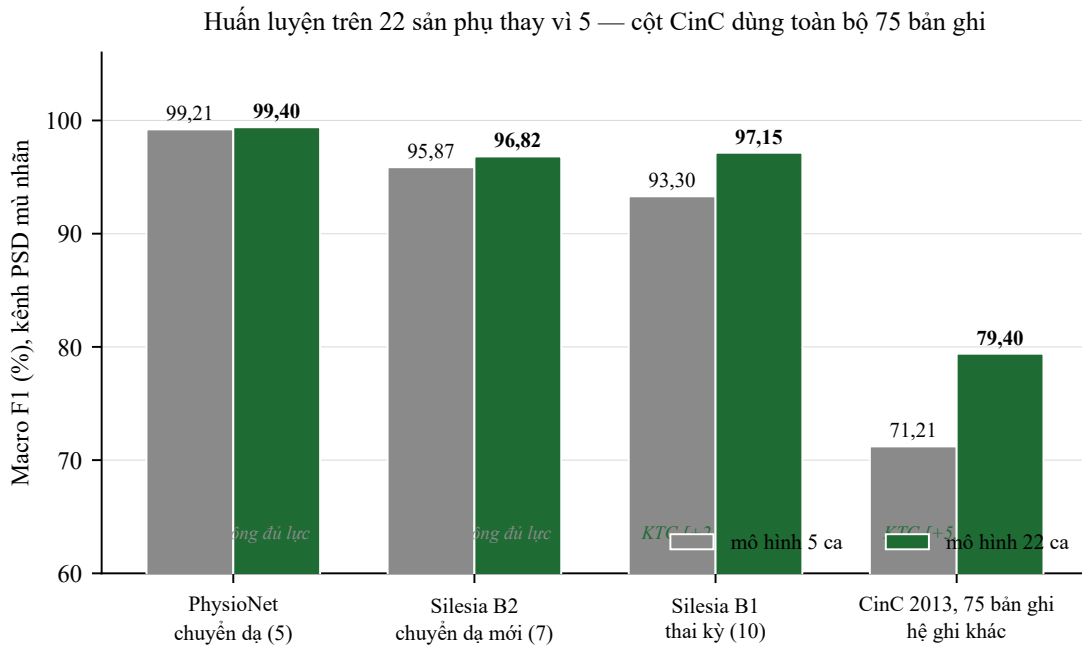

**Hình 12:** Cùng chủ thể, cùng giao thức, chỉ đổi mô hình. Cột CinC 2013 trong hình vẽ trên **75 bản ghi** (đã rút ở bản 3.5; số đúng trên 60 bản sạch là 64,04 → 74,28, §5.10.3); bản 3.2 dùng 90,34 — kênh 0 hậu kiểm trên 10 bản ghi, cũng đã rút. Lợi ích tập trung đúng ở hai chỗ yếu: thai kỳ và hệ ghi khác; hai nhóm bên trái có  $n$  quá nhỏ để kết luận.

Độ lệch chuẩn trên B1 giảm từ 13,46 xuống **4,95**. Hai ca thai kỳ khó nhất: B1\_07 từ 58,7 lên **86,6**; B1\_06 từ 80,9 lên **89,5**. Trên PhysioNet, nơi mô hình 5 ca đã ở 99,21, hiệu số chỉ là +1,24 điểm với KTC 95% chứa 0 — đúng như kỳ vọng, và với  $n = 5$  thì không thể kết luận gì hơn.

#### Kiểm tra nhãn B1 gián tiếp có kéo lệch mô hình không

Nhãn B1 lệch 8–12 ms sau đỉnh R bụng ở 5/10 bản ghi và chiếm khoảng 72% đoạn huấn luyện. Nếu mô hình học theo “phong cách nhãn B1”, nó sẽ lệch trên các ca có nhãn da đầu. Đo được: trung vị lệch (dự đoán — nhãn) của mô hình 22 ca trên PhysioNet là **0,0 ms**, trên B2 là **0,0 ms**, trên B1 là **−1,0 ms**. Không lệch.

### 5.10.3. PhysioNet/CinC 2013: 60 bản ghi sạch, không phải 75

#### RÚT LẠI (bản 3.5, vòng 7): mọi con số CinC 2013 trên 75 bản ghi trong mục này

**Sự kiện.** Tập set-a của PhysioNet/CinC 2013 **không độc lập** với ADFECGDB. **Như ban tổ chức đã ghi nhận** [Silva và cs., CinC 2013;40:149–152, Bảng 1: “Abdominal and Direct FECG — 25”; Clifford và cs., Physiol Meas 2014;35:1521, Bảng 2], 25 trong 447 bản ghi của Challenge được cắt từ ADFECGDB, và Clifford và cs. (2014) đã cảnh báo rằng một thuật toán dự thi huấn luyện trên ADFECGDB “may have led to a bias in the results as this database was included in set-a, set-b (and possibly a few records in set-c)”. Câu đó nằm ngay trong ghi chú đọc bài của nhóm (Bảng bài học, mục p20) và nhóm **đã bỏ sót** nó khi viết bản 3.4. Đây **không** phải phát hiện của nhóm.

**Phần nhóm đo được** (analysis/dulieu\_audit.py, cài đặt độc lập thứ hai analysis/dulieu\_m4b\_verify.py): không tài liệu nào cho biết *bản ghi set-a* nào là ADFECGDB; bằng tương quan chéo chuẩn hoá trên tín hiệu thô, đúng **15/75 bản** — a03, a04, a05, a08, a12, a13, a14, a15, a17, a19, a20, a22, a23, a24, a25 — là bản sao nguyên văn (NCC = 1,0000 cả 4 kênh đúng thứ tự,  $|\Delta RR| = 0,0$  ms) của các cửa sổ 0–60, 120–180, 240–300 s của r01, r04, r07, r08, r10; 60 bản còn lại có NCC tối đa 0,62. Vì mọi mô hình của nhóm huấn luyện trên chính 5 sản phụ đó, các con số 75 bản bị thổi phồng **3,27–7,18 điểm F1**.

**Số đúng, 60 bản sạch** (benchmark\_dpss/eval\_cinc60\_sach.json, bootstrap 10.000 lần theo bản ghi, seed 0):

| Quy tắc chọn kênh                   | 5 ca  | 22 ca        | Hiệu số         | KTC 95%         | T/Th/H  |
|-------------------------------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| <b>PSD mù nhãn (khai báo trước)</b> | 64,04 | <b>74,28</b> | +10,24          | [+7,13; +13,60] | 52/3/5  |
| Trung bình 4 kênh                   | 56,00 | 67,69        | +11,69          | [+9,03; +14,37] | 58/2/0  |
| Kênh 0 cố định (hậu kiểm, đã rút)   | 48,43 | 61,78        | +13,35          | [+9,67; +17,10] | 50/–/–  |
| Oracle (dùng nhãn)                  | 72,76 | 83,60        | +10,84          | [+7,55; +14,37] | 49/–/–  |
| peakprob (hậu kiểm, giả thuyết)     | —     | 82,01        | +7,73<br>so PSD | [+3,82; +12,41] | 19/6/35 |
| PSD, 53 bản (loại 7 bản nhãn sai)   | 64,19 | <b>75,27</b> | +11,08          | [+7,54; +14,82] | 46/2/–  |

Mô hình 22 ca: 33/60 bản  $\geq 90$ , 16/60 bản  $< 50$ , trung vị 95,07; PSD kém oracle **9,32 điểm** [+5,10; +14,15] và chỉ chọn trùng kênh oracle ở 17/60 bản. Power-MF đơn kênh trên 60 bản sạch: 55,97. Quy tắc peakprob (+7,73,  $p_{\text{Holm}} = 0,0039$  trên 7 quy tắc khai báo) được chọn *sau* khi nhìn kết quả; quy tắc chỉ định trước (gate, +6,44) **trượt** Holm ( $p = 0,051$ ); trên thang logit quy tắc đúng đầu là gate4; và **không có bộ dữ liệu công khai thứ ba có nhãn fQRS thật** để xác nhận (NIFEADB, NInFEA không có nhãn; .qrs của nifecgdb là nhíp mẹ; set-b chưa công bố nhãn — analysis/XACNHAN.md). Vì vậy peakprob là **giả thuyết mạnh, chưa xác nhận**.

**Các bảng và hình còn lại của mục này giữ nguyên số trên 75 bản ghi để đối chiếu; mọi con số 71,21 / 79,40 / 86,87 / 74,09 / 69,33 / 80,70 / +8,18 / +7,47 / 22/75 trong đó đều ĐÃ RÚT**. Kết luận định tính (thêm dữ liệu giúp; quy tắc chọn kênh mất giá trị ngoài miền; vẫn còn 16 bản dưới 50) không đổi; các số trong §5.7, §5.10 và phần phân biện dùng 75 bản cũng đọc theo hộp này.

**(Bản 3.4) Nhóm thay toàn bộ con số CinC 2013 của bản v3.2 — các số 75 bản dưới đây đã rút ở bản 3.5**

Mọi con số CinC 2013 trong các bản đề cương trước — 59,15 / 69,31 / 77,34 / 90,34 — đều đo trên **mẫu 10 bản ghi** (a01–a10) của tập set-a, trong khi set-a có **75 bản ghi**. Nhóm đã chạy toàn bộ 75 bản ghi (benchmark\_dpss/eval\_cinc75.py → eval\_cinc75.json). **Mẫu 10 bản ghi bị lệch, và lệch theo hai hướng ngược nhau tùy quy tắc chọn kênh**. Con số chính mới là **79,40**.

**Quy tắc khai báo trước khi chạy.** Hai biến thể được khai báo **trước** khi chạy: toàn bộ **75** bản ghi, và **68** bản ghi sau khi loại a33, a38, a47, a52, a54, a71, a74 — bảy bản ghi mà Behar, Oster và Clifford (CinC 2013;40:297–300) xác định là có chú thích tham chiếu sai. Nhóm báo cáo cả hai để không ai phải tin vào một lựa chọn loại trừ hậu kiểm.


**Bảng 27:** PhysioNet/CinC 2013 set-a, zero-shot, toàn bộ 75 bản ghi. Hiệu số là mô hình 22 ca trừ mô hình 5 ca; KTC 95% bootstrap 10.000 lần, seed 0. Hàng in đậm là **số chính**: quy tắc chọn kênh mù nhân theo mật độ phổ công suất.

| Quy tắc chọn kênh                                          | 5 ca         | 22 ca        | Hiệu số | KTC 95% bootstrap | T/Th/H   | Cliff $\delta$ |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|----------|----------------|
| <b>PSD mù nhân (chính)</b>                                 | <b>71,21</b> | <b>79,40</b> | +8,18   | [+5,62; +11,09]   | 53/5/17  | 0,232          |
| Kênh 0 cố định (hậu kiểm)                                  | 58,72        | 69,33        | +10,61  | [+7,46; +13,98]   | 52/11/12 | 0,224          |
| Trung bình 4 kênh                                          | 64,78        | 74,09        | +9,31   | [+7,03; +11,75]   | 59/8/8   | 0,176          |
| Oracle (dùng nhãn thật)                                    | 78,21        | 86,87        | +8,66   | [+5,91; +11,66]   | 49/5/21  | 0,222          |
| <i>68 bản ghi (loại 7 bản chú thích sai), quy tắc PSD:</i> |              |              |         |                   |          |                |
| <b>PSD mù nhân, <math>n = 68</math></b>                    | 72,08        | <b>80,70</b> | +8,62   | [+5,71; +11,79]   | 47/4/17  | 0,248          |

**Bảng 28:** Hình dạng phân bố trên 75 bản ghi, quy tắc PSD mù nhân. Đây mới là thông tin lâm sàng, không phải trung bình.

| Nhóm bản ghi (trên 75)  | Mô hình 5 ca | Mô hình 22 ca |
|-------------------------|--------------|---------------|
| F1 = 100 (hoàn hảo)     | 15           | <b>28</b>     |
| F1 $\geq$ 90            | 42           | <b>48</b>     |
| F1 trong [50, 90)       | 11           | 11            |
| F1 < 50 (sụp đổ)        | <b>22</b>    | <b>16</b>     |
| Gộp toàn cục (micro F1) | 73,00        | 79,92         |



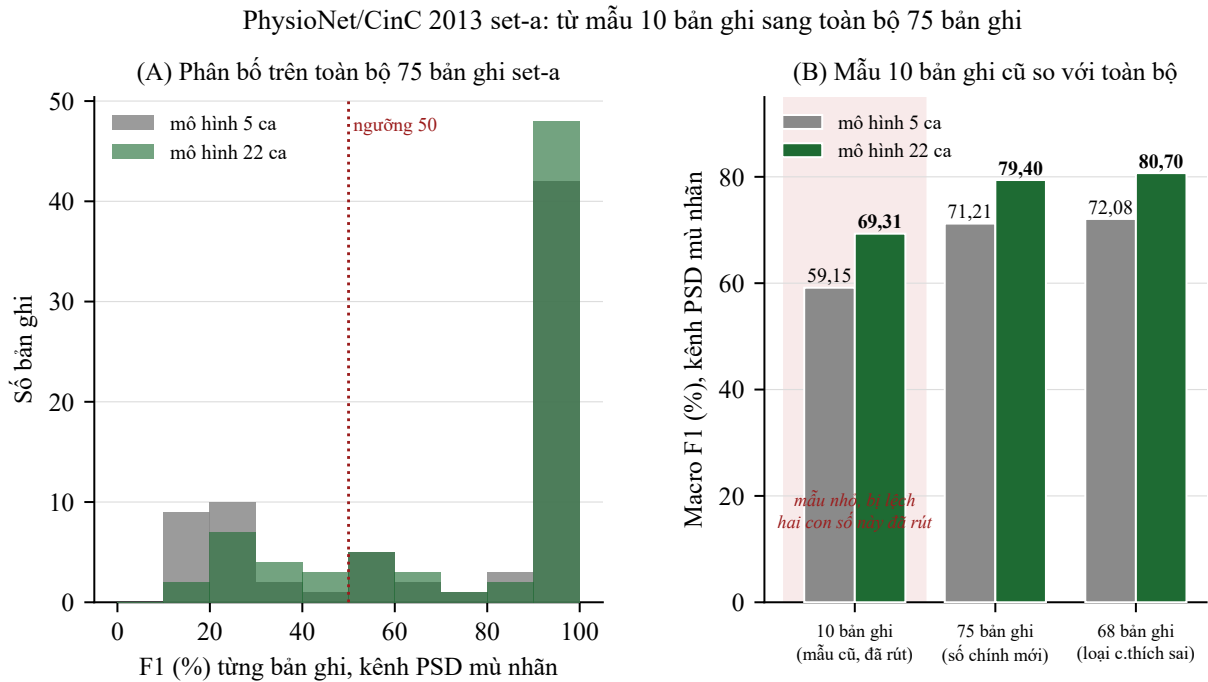

**Hình 13:** (A) Phân bố F1 từng bản ghi trên toàn bộ 75 bản ghi set-a — vẫn **lượng cực**: một đỉnh ở 90–100 và một đỉnh dưới 30. Mô hình 22 ca đẩy khối lượng sang phải nhưng **không xoá** đỉnh thấp. (B) Mẫu 10 bản ghi cũ so với toàn bộ.

#### 5.10.4. Vì sao mẫu 10 bản ghi bị lệch, và lệch theo hai hướng

Đây là phần nhóm coi là bài học phương pháp quan trọng nhất của đợt này.

**Bảng 29:** Cùng mô hình 22 ca, cùng checkpoint, cùng bộ chấm — chỉ đổi số bản ghi được tính. **Cả hai con số ở cột “mẫu 10 bản ghi” (69,31 và 90,34) đều ĐÃ BỊ RÚT** và chỉ giữ lại ở đây để đối chiếu với con số đúng trên toàn bộ 75 bản ghi.

| Quy tắc chọn kênh | Mẫu 10 bản ghi (đã rút) | Toàn bộ 75 bản ghi | Lệch   |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| PSD mù nhân       | 69,31                   | 79,40              | −10,09 |
| Kênh 0 cố định    | 90,34                   | 69,33              | +21,01 |

Mười bản ghi a01–a10 **không** là một mẫu ngẫu nhiên đại diện cho 75 bản ghi:

- Dưới quy tắc mù nhân, chúng khó hơn trung bình 10,09 điểm.** Tức bản v3.2 đã **báo cáo thấp** hơn năng lực thật của hệ thống. Đây là hướng lệch ít nguy hiểm, nhưng vẫn là lệch.
- Dưới quy tắc kênh 0 cố định, chúng dễ hơn trung bình 21,01 điểm.** Đây mới là chỗ nguy hiểm. Kênh 0 được chọn **sau khi** thấy quy tắc PSD thất bại **trên chính 10 bản ghi đó**. Con số 90,34 vì vậy không chỉ là “lựa chọn hậu kiểm” về mặt nguyên tắc — nó là một siêu tham số đã được **khớp vào mẫu đánh giá**, và khi đem ra 65 bản ghi chưa thấy thì nó **rơi 21 điểm** xuống 69,33, tức **thấp hơn** cả quy tắc mù nhân mà nó từng thay thế.



### Quy tắc nhóm tự đặt cho mọi kết quả về sau


Một quy tắc chọn kênh (hay bất kỳ siêu tham số nào) chỉ được báo cáo nếu nó được **cố định trước khi nhìn tập đánh giá**. Con số 90,34 vi phạm điều đó và bị **rút khỏi mọi bảng chính**; nó chỉ còn xuất hiện trong §5.10.3 làm ví dụ về chính lỗi này. Mọi bảng từ đây trở đi dùng **79,40 (75 bản ghi, PSD mù nhân)** làm con số CinC 2013.

#### 5.10.5. Điều 75 bản ghi nói mà 10 bản ghi không nói được

1. **Sụp đổ xuyên hệ ghi CHƯA được chữa.** Với 75 bản ghi, vẫn còn **16 bản ghi dưới 50** (mô hình 22 ca). Kết luận của bản v3.2 — “không còn bản ghi nào dưới 50” — đúng trên 10 bản ghi và **sai** trên 75. Nhóm rút lại kết luận đó. Phân bố vẫn lưỡng cực; đây vẫn là bài toán mở, và vẫn là lý do đóng góp C3 tồn tại.
2. **Thêm dữ liệu vẫn giúp, và lần này có đủ mẫu để nói chắc.** +8,18 điểm với KTC 95% [+5,62; +11,09], thắng 53 thua 5 trên 75 bản ghi. Với  $n = 75$ , đây là kiểm định **đủ lực**, khác hẳn các so sánh  $n = 5$  ở §10. Nhưng Cliff  $\delta = 0,232$  chỉ là hiệu ứng **nhỏ**: lợi ích tập trung ở một nhóm bản ghi chứ không nâng đều toàn bộ.
3. **Quy tắc chọn kênh vẫn là điểm yếu lớn nhất ngoài miền.** Oracle đạt 86,87; quy tắc PSD đạt 79,40. Khoảng cách **7,47 điểm** chỉ do chọn sai kênh. Trong miền khoảng cách này là 0,02–1,90 điểm. Quy tắc PSD chọn trùng kênh oracle ở **22/75** bản ghi (29,3 %).
4. **Loại 7 bản ghi chú thích sai làm mọi con số tốt lên khoảng 1,3 điểm** (79,40  $\rightarrow$  80,70), không đổi kết luận nào. Nhóm báo cáo 75 bản ghi làm số chính vì quy tắc loại kia dựa trên một nguồn thứ cấp mà nhóm chưa tự kiểm chứng.

#### 5.10.6. Đường cong hiệu quả mẫu

Vì sao 22 ca giúp nhiều đến vậy? Nhóm đo trực tiếp bằng cách huấn luyện trên  $k$  sản phụ PhysioNet rồi chấm trên những người còn lại.

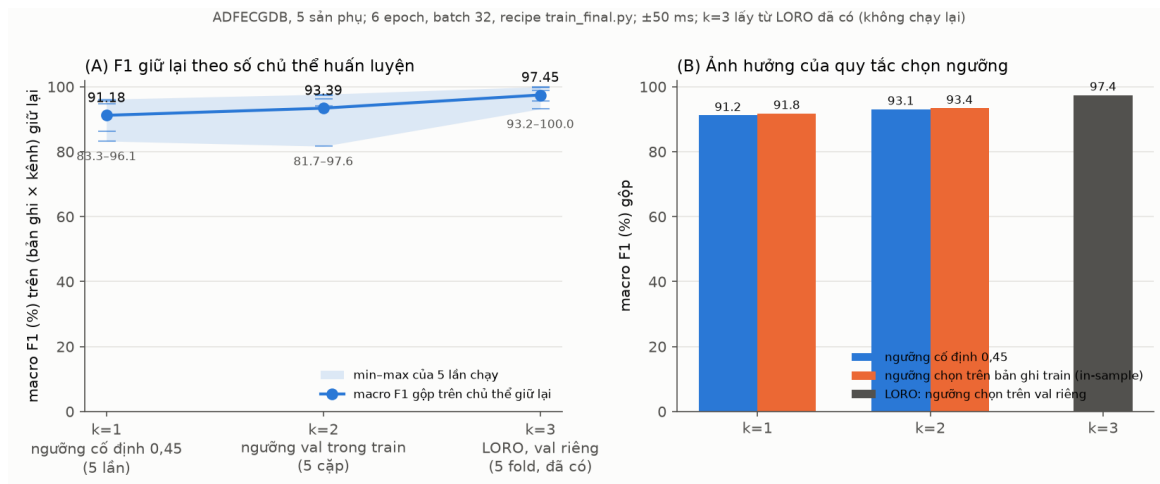

**Hình 14:** (A) Macro F1 trên chủ thể giữ lại theo số chủ thể huấn luyện; dải mờ là min-max của 5 lần chạy. (B) Ảnh hưởng của quy tắc chọn ngưỡng. Với  $k = 1$  không có chủ thể validation nên dùng ngưỡng cố định 0,45; với  $k = 2$  ngưỡng chọn trên một chủ thể trong tập huấn luyện — cả hai đều được ghi rõ.

**Bảng 30:** Hiệu quả mẫu trên ADFECGDB, 6 epoch, dung sai  $\pm 50$  ms.

| Số ca huấn luyện | Số lần chạy           | Macro F1 giữ lại | Min-max      | Ngưỡng                   |
|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 1                | 5                     | 91,18            | 83,3 – 96,1  | cố định 0,45             |
| 2                | 5 cặp                 | 93,39            | 81,7 – 97,6  | trên một ca trong train  |
| 3                | 5 fold (tách bản ghi) | <b>97,45</b>     | 93,2 – 100,0 | trên ca validation riêng |

Đường cong **chưa bão hoà** ở 3 ca. Kết hợp với kết quả 22 ca, đây là bằng chứng định lượng cho luận điểm xuyên suốt đề tài: trong bài toán này, đầu tư vào *dữ liệu* và *front-end* sinh lợi hơn đầu tư vào *kiến trúc*.

### 5.10.7. Giới hạn

Bốn epoch (loss vẫn giảm ở epoch cuối). Chưa đo riêng đóng góp của tăng cường dữ liệu — so sánh “có” và “không” tăng cường trên cùng fold là việc kế tiếp. Mô hình 22 ca chưa được chạy qua công tin cây học được; công đó hiệu chuẩn theo mô hình 5 ca. Silesia và PhysioNet cùng một bệnh viện, nên “22 sản phụ” vẫn là một trung tâm.

#### Độ ổn định theo seed — đã đo, không còn là giới hạn ngở


Bản 3.2 ghi “một seed” như một giới hạn chưa xử lý. Nhóm đã huấn luyện lại toàn bộ mô hình 22 chủ thể với **seed 1** (model/train\_22\_seed1.json). Trên 20 chủ thể chung, |hiệu số| F1 trung bình là **0,28 điểm**, lớn nhất 2,81 điểm (B2\_03) — **nhỏ hơn nhiều so với mọi hiệu ứng được báo cáo** trong đề cương.

Nhưng có một phát hiện phụ đáng lo: **ngưỡng từng fold kém ổn định hơn hẳn**. Seed 0 cho dải 0,20–0,80 (fold 10 ở 0,20, cực đoan); seed 1 cho dải 0,50–0,80 và **không tái lập** giá trị 0,20. Quy trình chọn ngưỡng trên một chủ thể validation duy nhất là điểm mong manh của pipeline (§10).

## 6. Đối chuẩn và kiểm chứng độc lập

Nhóm nhận được từ một thành viên khác trong nhóm nghiên cứu (Lê Xuân Khánh) một gói đối chuẩn đề nghị so ba hệ thống: mô hình DPSS (IEEE TBME 2023), mô hình Persistence Image của bạn ấy, và mô hình của nhóm. Nhóm đã chạy đúng giao thức đó, đồng thời kiểm chứng lại toàn bộ các con số tham chiếu.

### 6.1. Kết quả chạy đúng giao thức được đề nghị

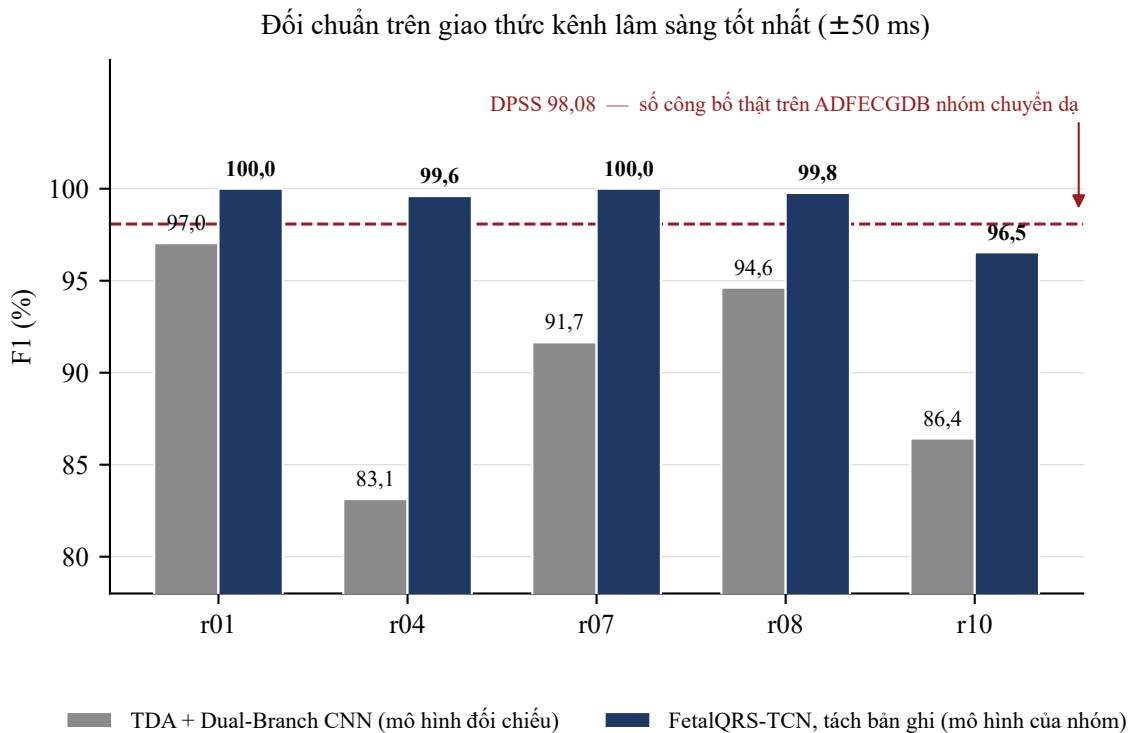

**Hình 15:** Đối chuẩn trên giao thức kênh lâm sàng tốt nhất, dung sai  $\pm 50$  ms. Đường đứt đỏ là con số **thật** mà bài DPSS công bố cho nhóm chuyên dạ.

Mô hình của nhóm đạt macro F1 **99,18** theo bản đồ đạo trình quy định, so với 90,57 của mô hình đối chiếu. Nhóm đã kiểm chứng lại bằng thuật toán khớp cặp tối ưu Hungarian độc lập: kết quả trùng khớp tuyệt đối trên cả năm bản ghi, chênh lệch 0,00 điểm.

### 6.2. Kiểm chứng các con số tham chiếu

Nhóm đọc toàn văn 13 trang bài DPSS gốc để kiểm tra bảng tham chiếu trong gói đối chuẩn. Đây là việc kiểm chứng học thuật thông thường giữa hai thành viên, mục đích là để báo cáo chung không chứa số liệu sai.

**Bảng 31:** Kiểm chứng từng tuyên bố về “kết quả đã công bố của DPSS”. Nguồn: Shokouhmand & Tavassolian, *IEEE Trans. Biomed. Eng.* 70(1):283–295, 2023, DOI 10.1109/TBME.2022.3189617.

| Tuyên bố trong gói đối chuẩn             | Đối chiếu với bài báo gốc                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 theo từng bản ghi r01–r10             | <b>Không có nguồn.</b> Các định danh r01, r04, r07, r08, r10 xuất hiện <b>0 lần</b> trong toàn văn.                                                                                |
| Macro F1 91,03                           | <b>Không có nguồn.</b> Con số thật là <b>97,7%</b> trên <b>22 tín hiệu</b> (10 thai kỳ + 12 chuyển dạ), và <b>98,08%</b> riêng nhóm chuyển dạ.                                     |
| Sáu con số jitter (22,0–28,5 ms)         | <b>Không có nguồn.</b> Bài không báo cáo jitter. Từ “jittering” trong bài là kỹ thuật tăng cường dữ liệu bằng nhiễu Gauss.                                                         |
| MAE fHR theo bpm                         | <b>Không có nguồn.</b> Bài dùng chỉ số khác: “FHR precision” = phần trăm cửa sổ có fHR sai lệch trong $\pm 5$ bpm, đạt 88,61%.                                                     |
| 6.800.000 tham số, 55,0 MB, >500 MB RAM  | <b>Không có nguồn.</b> Bài không nêu bất kỳ con số nào trong số này.                                                                                                               |
| Độ trễ 35–50 ms                          | <b>Sai.</b> Con số thật là <b>0,52 giây</b> cho một cửa sổ 4 giây trên CPU Intel 3,6 GHz.                                                                                          |
| “Bất khả thi Edge AI, cần máy chủ Cloud” | <b>Bài kết luận ngược lại.</b> DPSS đo được 1,2 s trên Raspberry Pi, 1,0 s trên Apple S7, và bài kết luận DPSS “phù hợp cho hệ thống theo dõi thai nhi thời gian thực”.            |
| Nhãn “chuẩn AAMI EC57 $\pm 50$ ms”       | <b>Nhãn sai.</b> Cụm “AAMI” và “EC57” xuất hiện <b>0 lần</b> trong bài DPSS. Ngưỡng 50 ms được trích từ Behar và cộng sự 2016. Chuẩn AAMI EC57 thật sự dùng cửa sổ <b>150 ms</b> . |

**Điều đúng trong gói đối chuẩn**

Nhóm ghi nhận rõ ba điểm:

- Cột số liệu mô hình Persistence Image là số chạy máy thật.** Nhóm tái tạo được cả năm giá trị MAE từ TP/FP/FN bằng chính công thức trong mã nguồn, khớp 5/5. Vấn đề nằm ở cột tham chiếu DPSS và ở định nghĩa chỉ số, **không nằm ở phép đo mô hình của bạn ấy.**
- Số nhịp nhãn chuẩn từng bản ghi (644/632/627/651/637, tổng 3.191) khớp tuyệt đối với tệp .qrs gốc.
- Bản đồ đạo trình được đề nghị là hợp lý về sinh lý, và trùng với quy tắc chọn kênh mù nhãn của nhóm ở 2/5 bản ghi.

**6.3. Hai lỗi kỹ thuật trong mã đánh giá**

**Hàm ghép cặp không phải song ánh.** Hàm bipartite\_aami\_ec57\_matching thực chất là thuật toán tham lam duyệt theo thứ tự mảng. Phản ví dụ nhóm đã chạy: với nhãn chuẩn tại {0, 60} và dự đoán tại {50, 100}, dung sai 50, hàm trả TP = 1 trong khi khớp cặp tối ưu cho

TP = 2. Đảo thứ tự dự đoán thành {100, 50} thì hàm lại trả TP = 2. Kết quả phụ thuộc thứ tự mảng.

Tuy nhiên nhóm cũng ghi rõ: **trên dữ liệu thật, sai khác này bằng không**. Nhóm đã so tham lam với Hungarian trên cả năm bản ghi và chênh lệch là 0,00 điểm. Đây là lỗi định danh thuật toán, không làm sai kết quả đã đo.

**Công thức MAE nhịp tim đo sai đại lượng.** Công thức trong mã rút gọn thành

$$\text{MAE}_{\text{fHR}} = \frac{|N_{\text{dự đoán}} - N_{\text{chuẩn}}|}{5},$$

tức chỉ đo **số lượng** nhịp, không đo **vị trí** nhịp. Nhóm dựng phản ví dụ và chạy thật: một mô hình dự đoán **hoàn toàn ngẫu nhiên**, F1 chỉ 20,96%, vẫn đạt MAE = 0,00 bpm — tức “tốt hơn” cả DPSS lẫn mô hình đối chiếu.

Nhóm đề nghị thay bằng định nghĩa tính theo khoảng RR trong từng đoạn 4 giây. Theo định nghĩa đúng đó, mô hình của nhóm đạt MAE 0,34 bpm và “FHR precision” 98,39% — so với 89,22% mà DPSS thật sự công bố cho nhóm chuyển dạ.

**Bảng 32:** Đối chuẩn sau khi đã sửa các con số tham chiếu. Đây là bảng nhóm sẽ dùng trong bài báo.

| Hệ thống                     | F1           | Bộ dữ liệu          | Số kênh | Độ trễ         |
|------------------------------|--------------|---------------------|---------|----------------|
| DPSS (TBME 2023)             | 98,08        | ADFECGDB<br>22 ca   | 1       | 520 ms         |
| Power-MF (Physiol Meas 2024) | 98,0 ± 3,0   | ADFECG<br>B2, 12 ca | 4       | bài không nêu  |
| Persistence Image + CNN      | 90,57        | ADFECGDB<br>5 ca    | 1       | 7,0 ms         |
| <b>FETALQRS-TCN (nhóm)</b>   | <b>99,21</b> | ADFECGDB<br>5 ca    | 1       | <b>4,35 ms</b> |

Cách đọc bảng 32 cho đúng

Bốn dòng này **không** đặt cạnh nhau được một cách nghiêm ngặt. DPSS huấn luyện trên dữ liệu tổng hợp rồi áp thẳng sang ADFECGDB không tinh chỉnh, tức là con số tổng quát hoá xuyên miền — khó hơn hẳn. Power-MF dùng bốn kênh trên bộ Silesia ở 500 Hz. Chỉ hai dòng cuối là cùng dữ liệu và cùng giao thức.  
Nhóm đưa bảng này vào để cho thấy vị trí tương đối, và sẽ ghi rõ cảnh báo này trong bài báo thay vì tuyên bố vượt trội.

## 7. Đóng góp C3 sau khi chạy prototype

Bản đề cương trước đặt C3 là “chỉ số chất lượng tín hiệu thai dựa trên đồng điều bền vững, có quyền từ chối trả lời” và thừa nhận nó chưa có một dòng dữ liệu nào. Nhóm đã xây prototype và chạy thí nghiệm có kiểm soát. **Kết quả là phủ định cho phần đồng điều bền vững, và khẳng định cho phần từ chối trả lời.** Mục này trình bày nguyên trạng.

### 7.1. Thiết kế thí nghiệm

Câu hỏi: *đặc trưng topo tính trên từng đoạn 4 giây có dự báo được khi nào mô hình sẽ sai không, và có hơn các chỉ số chất lượng cổ điển không?*

**Bảng 33:** Hai nhóm đặc trưng được so sánh. Mọi đặc trưng tính trên tín hiệu dư sau khử mẹ, 250 Hz, đoạn 4 giây, chuẩn hoá robust. Mã tại `fsqi/fsqi.py`.


| Nhóm                     | Số | Nội dung                                                                                                                            |
|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topo — Takens + ripser   | 11 | Nhúng trễ chiều 3, $\tau = 20$ ms, 300 điểm; tổng, cực đại, entropy và số thanh persistence của $H_0$ và $H_1$                      |
| Topo — sublevel $H_0$    | 5  | Đồng điều $H_0$ của lọc dưới mức trên tín hiệu 1 chiều (đối chiếu với <code>scipy prominence</code> : sai lệch 0,0 trên 2.011 đỉnh) |
| Cổ điển — chỉ tín hiệu   | 6  | SampEn, kurtosis, entropy phổ, tỉ lệ năng lượng 10–60 Hz, đỉnh PSD dải nhịp thai, trễ tự tương quan                                 |
| Cổ điển — đầu ra mô hình | 6  | CV khoảng RR, tỉ lệ RR hợp lý, bSQI, số đỉnh, xác suất trung bình tại đỉnh, xác suất cực đại                                        |

Giao thức chống rò rỉ: nhãn “đoạn lỗi” là F1 của mô hình trên đoạn đó dưới 80; bộ phân loại huấn luyện **chỉ trên ADFECGDB** (1.500 đoạn, checkpoint fold đúng), kiểm thử **xuyên miền trên CinC 2013** (600 đoạn, checkpoint production, zero-shot). Không chọn siêu tham số bằng nhãn kiểm thử. Bootstrap 1.000 lần theo đoạn và theo cụm bản ghi. Hai lần chạy độc lập cho kết quả trùng khớp 1.327/1.327 trường.

## 7.2. Kết quả


**Bảng 34:** Dự báo đoạn lỗi trên CinC 2013 (ngoài miền), bộ phân loại huấn luyện trên ADFECGDB. Cột cuối: macro F1 của các đoạn được giữ lại sau khi từ chối 20% đoạn kém tin cậy nhất.

| Nhóm đặc trưng                   | AUROC        | AUPRC          | F1, phủ 80%  | F1, phủ 50%  |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Từ chối ngẫu nhiên (đường cơ sở) | 0,500        | $\approx 0,52$ | 62,03        | 62,14        |
| <b>Topo</b> (16 đặc trưng)       | <b>0,566</b> | 0,564          | 63,40        | 64,44        |
| Cổ điển, chỉ tín hiệu (6)        | 0,666        | 0,686          | —            | —            |
| <b>Cổ điển</b> (12)              | <b>0,929</b> | 0,927          | <b>69,40</b> | <b>84,51</b> |
| Kết hợp topo + cổ điển (28)      | 0,905        | 0,899          | 69,41        | 82,44        |
| Oracle (biết F1 thật)            | —            | —              | 74,55        | 97,81        |

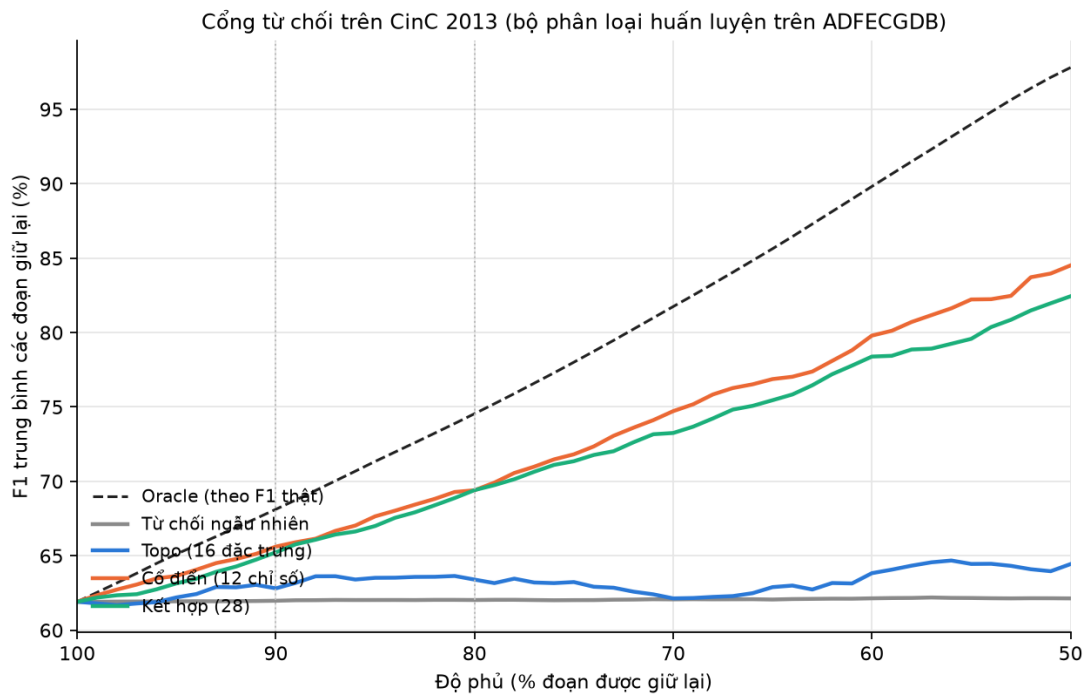

**Hình 16:** Đường cong rủi ro–độ phủ trên CinC 2013. Đường topo (xanh dương) gần như nằm sát đường từ chối ngẫu nhiên (xám) trên toàn bộ dải độ phủ. Đường cổ điển (cam) tách rõ và tiến về oracle (đứt).



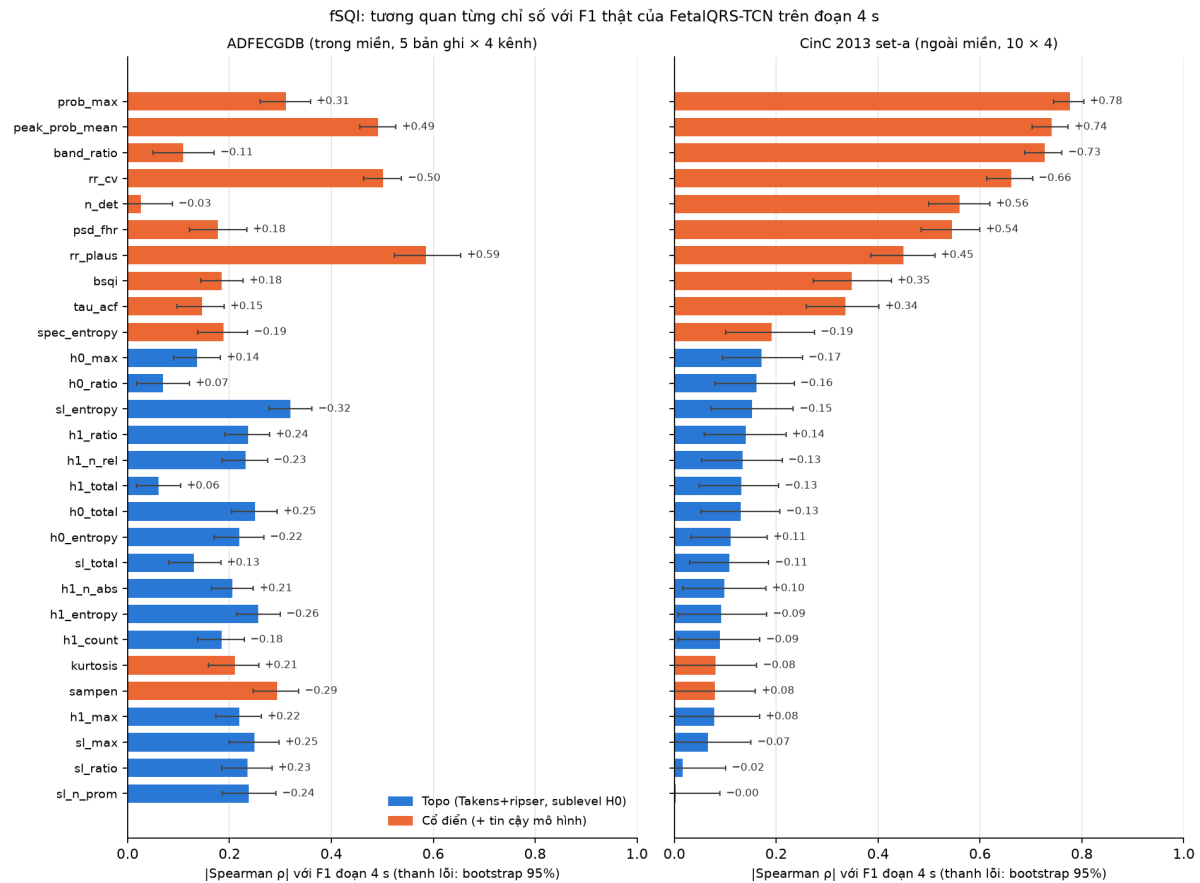

**Hình 17:** Tương quan Spearman của từng chỉ số với F1 đoạn, kèm khoảng tin cậy bootstrap 95%. Trái: trong miền. Phải: ngoài miền. Các chỉ số cổ điển (cam) **mạnh lên** khi ra ngoài miền; các chỉ số topo (xanh) **yếu đi** và nhiều chỉ số đổi dấu.

### 7.3. Đọc kết quả

1. **Topo không dự báo được lỗi ở mức hữu dụng.** AUROC 0,566 gần ngẫu nhiên. Cổng từ chối dựa trên topo chỉ hơn từ chối ngẫu nhiên 1,4 điểm ở độ phủ 80%. Trong miền có tín hiệu yếu ( $\rho = -0,32$  cho entropy sublevel), nhưng tín hiệu đó **không chuyển miền được**: bốn đặc trưng topo đổi dấu tương quan giữa ADFECGDB và CinC.
2. **Topo không bổ sung gì cho cổ điển.** Gộp 28 đặc trưng cho AUROC 0,905, *thấp hơn* 12 đặc trưng cổ điển đơn thuần (0,929). Thêm topo vào là thêm nhiễu.
3. **Ngay cả chỉ số cổ điển thuần tín hiệu cũng hơn topo** (0,666 so với 0,566), dù không dùng đầu ra mô hình.
4. **Cổng từ chối có tác dụng thật, nhưng bằng chỉ số khác.** Chỉ số dự báo lỗi mạnh nhất là **độ tự tin của chính mô hình** (prob\_max, AUROC đơn lẻ 0,970) và **độ đều của nhịp** (rr\_cv, 0,915). Chỉ số thuần tín hiệu tốt nhất là **tỉ lệ năng lượng 10–60 Hz** (0,904) — lần thứ ba dải tần này xuất hiện như biến quan trọng nhất của đề tài.
5. **Chi phí tính topo không phải rào cản.** Trung bình 65 ms mỗi đoạn, p95 80 ms. Vấn đề

không phải tốc độ mà là thông tin.

#### Con số 0,929 trả lời sai câu hỏi — đỉnh chính bắt buộc của bản 3.3

600 đoạn 4 giây trong bảng trên đến từ **10 bản ghi**, và đoạn trong cùng một bản ghi tương quan mạnh. Tính lại với cluster bootstrap **theo bản ghi** ( $n = 10$  cụm): AUROC = 0,929 [0,830; 0,982].

Quan trọng hơn: **5/10 bản ghi CinC không có đoạn xấu nào**, nên chúng không đóng góp gì vào AUROC gộp. Con số 0,929 vì vậy phần lớn trả lời câu hỏi “*bản ghi này có phải bản ghi xấu không*”. Câu hỏi mà cổng từ chối được bán như là thứ trả lời — “*đoạn 4 giây này trong bản ghi của bệnh nhân này có đáng tin không*” — có đáp số là **AUROC TRONG bản ghi** = 0,721 [0,517; 0,898], trung bình trên 5 bản ghi có cả đoạn tốt lẫn đoạn xấu ( $a_{01} = 0,914$ ;  $a_{06} = 0,390$ ;  $a_{07} = 0,889$ ;  $a_{09} = 0,886$ ;  $a_{10} = 0,526$ ).

Kết luận phủ định về topo **không đổi** (0,566 so với 0,929 hay so với 0,721 đều là thua). Nhưng tuyên bố khẳng định về cổng từ chối phải hạ xuống: nó **chưa** dùng được ở mức đoạn tại giường bệnh. Chi tiết ở §10.

#### Điều này làm gì với đóng góp C3

Nhóm **rút lại** phần “dựa trên đồng điều bền vững” trong phát biểu C3. Đây là lần thứ ba trong đề tài mà phân tích dữ liệu topo được kiểm chứng có kiểm soát và không mang lại lợi ích: (1) Persistence Image làm đặc trưng dò đỉnh đứng chót 16 kiến trúc; (2) sublevel  $H_0$  trùng 100% với độ nhô đỉnh cổ điển; (3) đặc trưng topo làm chỉ số chất lượng đạt AUROC 0,566 so với 0,929 của chỉ số cổ điển.

**C3 được phát biểu lại thành:** *cổng từ chối trả lời cho bộ dò fQRS đơn kênh, xây trên độ tự tin của mô hình và tính hợp lý của nhịp, kèm một kết quả phủ định có kiểm soát về đồng điều bền vững trong vai trò chỉ số chất lượng tín hiệu thai.*

Giả thuyết  $H_0$  trong bản đề cương trước đã dự phòng đúng tình huống này: kết quả phủ định có kiểm định, với đối chứng ngẫu nhiên và oracle, huấn luyện–kiểm thử xuyên miền, không chọn siêu tham số bằng nhãn kiểm thử, là một đóng góp công bố được.

## 7.4. Vì sao topo thất bại ở đây

Nhóm đưa ra ba lý do, đánh dấu rõ mức chắc chắn:

### Đã chứng minh — sublevel $H_0$ không phải đặc trưng mới.

Định lý Elder cho biết persistence của mỗi thanh  $H_0$  đúng bằng độ nhô của một đỉnh. Nhóm đã kiểm chứng sai lệch 0,0 trên 2.011 đỉnh. Nên nhóm 5 đặc trưng này chỉ là cách viết lại thống kê độ nhô, và độ nhô đã nằm trong bộ chỉ số cổ điển.

### Đã đo — đặc trưng $H_1$ của nhúng trễ không ổn định giữa bộ dữ liệu.

Hình 17 cho thấy dấu tương quan đổi chiều. Cấu trúc vòng trong không gian nhúng phụ

dấu vào biên độ tương đối của sóng mẹ còn sót và nhiễu cơ, hai thứ khác hẳn giữa hai bộ dữ liệu.

**Suy luận — lỗi mô hình là lỗi *nhịp*, không phải lỗi *hình dạng*.**

Ảnh chụp demo trên a02 (hình 19) cho thấy cơ chế thất bại chính: mô hình bám nhầm vào nhịp mẹ. Đó là lỗi ở thang thời gian hàng giây, trong khi đặc trưng topo trên đoạn 4 giây mô tả hình dạng ở thang mili giây. Hai thang không gặp nhau. Đây là lý do độ đều nhịp và tỉ lệ trùng đỉnh mẹ dự báo lỗi tốt hơn nhiều.

## 7.5. Giới hạn của thí nghiệm này

CinC 2013 set-a chỉ có 10 bản ghi  $\times$  1 phút, lỗi tập trung theo bản ghi nên khoảng tin cậy theo cụm rộng hơn nhiều so với theo đoạn. Chỉ một cấu hình topo được thử (chiều 3,  $\tau = 20$  ms, 300 điểm) và nhóm **cố ý không quét** tham số để tránh chọn theo nhãn kiểm thử — nên chưa loại trừ hoàn toàn khả năng một cấu hình khác tốt hơn. Bộ phân loại kết hợp (0,905) thấp hơn cả prob\_max đơn lẻ (0,970), tức một ngưỡng đơn có thể là công tốt hơn bộ học, và điều này chưa được đo riêng.

## 8. Bản demo và đèn tin cậy

Nhóm đã xây bản demo chạy được, tách thành hai tầng: `demo/core.py` chứa toàn bộ logic, không phụ thuộc thư viện giao diện và có bộ kiểm thử riêng; `demo/app.py` là giao diện web một trang bằng Gradio, chạy trên máy cá nhân bằng lệnh `python demo/app.py`.

### 8.1. Bố cục

Màn hình gồm bốn khối, xếp theo thứ tự người xem cần biết:

1. **Đầu vào:** tải tệp EDF/WFDB/CSV hoặc chọn bản ghi mẫu; chọn kênh tự động (quy tắc PSD mù nhãn) hoặc thủ công. Nếu chọn bản ghi ADFECGDB thì hệ thống *tự động* dùng checkpoint chưa từng thấy bản ghi đó, để kết quả hiển thị là kết quả trung thực.
2. **Tín hiệu qua từng bước**, năm tab: thô, đã lọc kèm vạch nhịp mẹ, sau khử mẹ kèm vạch nhịp thai thật nếu có nhãn, xác suất từng mẫu kèm ngưỡng, và kết quả. Người xem kéo thả phóng to được.
3. **Nhịp tim thai theo thời gian**, tô vùng bình thường 110–160 nhịp/phút.
4. **Bốn thẻ số:** nhịp tim trung bình, số nhịp, **đèn tin cậy**, thời gian xử lý. Nếu có nhãn thì hiện thêm Se/PPV/F1/jitter.

Chân trang cố định: “*Bản mẫu nghiên cứu. Không phải thiết bị y tế. Không dùng cho chẩn đoán.*”

# RelyFetal — dò phức bộ QRS thai nhi từ điện tim ổ bụng đơn kênh

FetalQRS-TCN (113 481 tham số, CPU) - khử QRS mẹ bằng mẫu trung vị - chọn kênh mũ nhân theo PSD - đèn tín còi. **Bản mẫu nghiên cứu. Không phải thiết bị y tế. Không dùng cho chẩn đoán.**

Nguồn dữ liệu

Bản ghi mẫu

Tải lên file

Bản ghi mẫu (ADFECDGB rXX dùng fold checkpoint chứa từng thấy rXX)

r01 — ADFECGDB · checkpoint fold r01

Kênh bụng

Tự động (PSD)

Phân tích

Đã phân tích **r01** (EDF, 300 s, 4 kênh) — kênh **4** (auto (PSD)) · PSD dài thai từng kênh: k1=796e-12, k2=760e-12, k3=1.21e-11, k4=3.91e-11 — checkpoint: *fold r01* (bản ghi r01 KHÔNG nằm trong tập huấn luyện).

FHR TRUNG BÌNH

129 bpm

median RR trong từng của số 4 s

SỐ NHỊP THAI PHÁT HIỆN

644

300 s · kênh 4 (auto (PSD))

ĐÈN TÍN CÂY

CAO (xanh)

điểm 0.86 / — quy tắc cứng tạm thời, sẽ thay bằng ISQT từ-pô

- Năng lượng 10-60 Hz trên phần dư: 31% (trung gian)
- Khoảng RR: CV = 0.05 (hơi bất thường)
- 100% đỉnh có xác suất > 0.9
- FHR trung bình 129 bpm nằm trong 100-200 bpm
- 16% nhịp thai trùng đỉnh R mẹ (±50 ms; ngẫu nhiên = 13-22%)

THỜI GIAN XỬ LÝ

690 ms

tiền xử lý + khử mẹ + mô hình, CPU 4 luồng - toàn bộ kể cả đọc file & vẽ; 1,560 ms checkpoint: fold r01 (bản ghi r01 KHÔNG nằm trong tập huấn luyện)

Tín hiệu (5 táng)

Nhịp tim thai theo thời gian

So sánh với nhân

Nhật ký (JSON)

Từ tín hiệu thô đến kết quả

— Thở — Đả lọc — Nhịp mẹ — Phần dư — Nhấn nhịp thai — Xác suất — Đỉnh chọn — TP (đúng): 644

[1] Tín hiệu thô, kênh 4 (1000 Hz, hiển thị 1/4 mẫu)

[2] Đả lọc 10-60 Hz + notch 50 Hz, 250 Hz — vạch đỏ: 413 nhịp mẹ (QRS mẹ)

[3] Sau khử mẹ (phần dư đưa vào mô hình) — vạch đen: 644 nhịp thai theo nhân

[4] Xác suất nhịp thai của FetalQRS-TCN — ngưỡng 0.40 (cố định từ tập validation)

[5] Kết quả: mô hình so với nhân — ● TP xanh, × FP đỏ, ▲ FN cam

thời gian (s) — kéo để phóng to, nhấp đúp để xem toàn bộ

Bản mẫu nghiên cứu. Không phải thiết bị y tế. Không dùng cho chẩn đoán.


Runs

Use via API

Built with Gradio

Settings

**Hình 18:** Ảnh chụp giao diện thật trên r01, kênh chọn tự động, checkpoint chưa thấy r01. Năm tầng tín hiệu, 644 nhịp, đèn xanh, 690 ms xử lý cho 5 phút tín hiệu.



**Hình 19:** Ảnh chụp trên a02, bản ghi tệ nhất của CinC 2013, zero-shot. Đèn **đỏ** vì 97% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ. Đồ thị nhịp tim cho thấy đúng cơ chế thất bại: đường mô hình bám ở nhịp mẹ ( $\approx 126$ ) trong khi nhân ở  $\approx 160$  nhịp/phút. Hệ thống tự phát hiện và từ chối, thay vì báo sai.

## 8.2. Đèn tin cậy

Đây là thành phần biến demo từ “một bộ dò QRS nữa” thành thứ khác biệt. Phiên bản hiện tại dùng **luật cứng** kết hợp bốn dấu hiệu, mỗi dấu hiệu chỉ dùng chính tín hiệu và đầu ra mô hình, không dùng nhân:

**Bảng 35:** Bốn dấu hiệu của đèn tin cậy phiên bản luật cứng. Trọng số cộng lại thành điểm 0–1; xanh nếu  $\geq 0,75$ , vàng nếu  $\geq 0,45$ , đỏ nếu thấp hơn. Có một luật ghi đề: nếu hơn 60% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ thì đèn đỏ bất kể điểm, vì đó là dấu hiệu bộ dò đang bám nhầm vào tim mẹ.

| Dấu hiệu                               | Ý nghĩa                                                        | Trọng số |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Tỉ lệ năng lượng 10–60 Hz trên phần dư | Phần dư còn chứa QRS thai hay chỉ còn nhiễu                    | 0,2      |
| Hệ số biến thiên khoảng RR             | Nhịp đều là dấu hiệu bất đúng; nhịp loạn là dấu hiệu bất nhiễu | 0,3      |
| Tỉ lệ đỉnh có xác suất $> 0,9$         | Mô hình có tự tin vào các đỉnh nó chọn không                   | 0,3      |
| Nhịp tim nằm trong 100–200 nhịp/phút   | Kiểm tra sinh lý                                               | 0,2      |

Luật này được cố định trước khi chạy, rồi chấm trên 15 bản ghi có nhãn.

**Bảng 36:** Đèn tin cậy chấm trên 15 bản ghi có nhãn, kênh chọn tự động. ADFECGDB dùng checkpoint chưa thấy bản ghi; CinC 2013 dùng checkpoint production, zero-shot.

| Bản ghi | Bộ        | Kênh | F1 thật | Đèn  | Điểm  | Độ trễ |
|---------|-----------|------|---------|------|-------|--------|
| r01     | ADFECDGB  | 4    | 100,00  | xanh | 0,86  | 758 ms |
| r04     | ADFECDGB  | 2    | 99,76   | vàng | 0,74  | 778 ms |
| r07     | ADFECDGB  | 2    | 100,00  | xanh | 0,80  | 661 ms |
| r08     | ADFECDGB  | 4    | 99,77   | xanh | 0,90  | 720 ms |
| r10     | ADFECDGB  | 1    | 96,54   | xanh | 0,92  | 732 ms |
| a03     | CinC 2013 | 1    | 100,00  | xanh | 0,99  | 124 ms |
| a04     | CinC 2013 | 4    | 100,00  | xanh | 0,94  | 131 ms |
| a05     | CinC 2013 | 4    | 100,00  | xanh | 0,94  | 137 ms |
| a08     | CinC 2013 | 4    | 100,00  | xanh | 1,00  | 144 ms |
| a01     | CinC 2013 | 2    | 59,18   | vàng | 0,57  | 118 ms |
| a06     | CinC 2013 | 1    | 42,75   | vàng | 0,48  | 119 ms |
| a07     | CinC 2013 | 2    | 29,82   | vàng | 0,48  | 125 ms |
| a10     | CinC 2013 | 2    | 21,05   | vàng | 0,63  | 127 ms |
| a02     | CinC 2013 | 2    | 21,75   | đỏ   | 0,87* | 132 ms |
| a09     | CinC 2013 | 2    | 16,96   | đỏ   | 0,27  | 127 ms |

\* điểm cao nhưng bị luật ghi đề: 89% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ — bộ dò bám nhầm vào tim mẹ.

**Bảng 37:** Tổng hợp theo màu đèn.

| Đèn         | Số bản ghi | F1 trung bình | F1 thấp nhất | F1 cao nhất |
|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Xanh</b> | 8          | <b>99,54</b>  | 96,54        | 100,00      |
| Vàng        | 5          | 50,51         | 21,05        | 99,76       |
| <b>Đỏ</b>   | 2          | 19,36         | 16,96        | 21,75       |

**Điều quan trọng nhất trong bảng 37**

**Không có bản ghi nào bị đèn xanh mà F1 dưới 96.** Tức là luật cứng đơn giản này đã đạt tính chất cần thiết nhất của một cổng an toàn: *khi nó nói “tin được” thì tin được*. Sai số duy nhất là theo chiều thận trọng — r04 bị đèn vàng dù F1 là 99,76.

**8.3. Đèn học được: thay luật cứng bằng bộ phân loại**

Sau kết quả §7, nhóm huấn luyện một bộ phân loại gradient boosting trên 12 chỉ số cổ điển của từng đoạn 4 giây (fsqi/train\_gate.py), **chỉ trên ADFECGDB**, ngưỡng hai mức cũng hiệu chuẩn chỉ trên ADFECGDB, rồi ghép vào demo làm chế độ học. Luật bám mẹ 60% được giữ làm luật ghi đè trong cả hai chế độ. Hai chế độ được chấm trên **32 bản ghi**: 5 ADFECGDB (fold), 10 CinC 2013 và 17 Silesia (production, zero-shot).

**Bảng 38:** Hai chế độ đèn trên 32 bản ghi. “Nguy hiểm” là xanh nhưng  $F1 < 90$ ; “thận trọng” là đỏ nhưng  $F1 \geq 95$ .

| Chế độ | Đèn         | Số bản ghi | F1 trung bình | F1 thấp nhất | F1 cao nhất | Lỗi nguy hiểm / thận trọng |
|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Học    | <b>xanh</b> | 14         | <b>99,92</b>  | 99,76        | 100,00      | <b>0 / 0</b>               |
|        | vàng        | 9          | 98,66         | 96,54        | 100,00      |                            |
|        | <b>đỏ</b>   | 9          | 44,99         | 16,96        | 80,90       |                            |
| Luật   | <b>xanh</b> | 22         | 99,41         | 96,54        | 100,00      | <b>0 / 0</b>               |
|        | vàng        | 7          | 58,18         | 21,05        | 99,76       |                            |
|        | <b>đỏ</b>   | 3          | 32,48         | 16,96        | 58,72       |                            |

Hai chế độ hoà nhau ở tiêu chí quan trọng nhất — không lỗi nguy hiểm — nhưng khác nhau ở cách xử lý vùng giữa. Chế độ học đưa **cả 6 bản ghi mô hình thất bại** (a01, a06, a07, a10, B1\_06, B2\_03) xuống đỏ, trong khi luật để chúng ở vàng lẫn với bản ghi tốt. Nhóm vàng của chế độ học vì vậy sạch (F1 thấp nhất 96,54); nhóm vàng của luật trộn 21,05 với 99,76. Tương quan Spearman giữa điểm tin cậy và F1 thật: học 0,90, luật 0,71.

Giá phải trả là độ phủ: chế độ học chỉ bật xanh 43,8% bản ghi so với 68,8% của luật. Trên 17 bản ghi Silesia — tập độc lập thật sự với cả hai chế độ — luật phủ xanh 82,4% (F1 thấp nhất 97,70) còn học chỉ 35,3%, cùng 0 lỗi nguy hiểm. Chế độ học *quá thận trọng* trên thai kỳ vì



ngưỡng hiệu chuẩn trên dữ liệu chuyển dạ. Nhóm giữ học làm mặc định vì an toàn hơn ở vùng giữa, và ghi rõ việc hiệu chuẩn lại ngưỡng trên dữ liệu thai kỳ là bước tiếp theo — **không được dùng 32 bản ghi này** để làm việc đó.

## 8.4. Giao diện lập trình và đóng gói

Ngoài giao diện web, nhóm bọc cùng lỗi demo/core.py thành dịch vụ REST (api/main.py, FastAPI): GET /health, GET /model, POST /analyze nhận EDF/CSV/NPY và trả JSON gồm vị trí nhịp, nhịp tim, đèn tin cậy và độ trễ. Lỗi đầu vào trả mã 4xx có thông điệp, không bao giờ là traceback. Đã kiểm thử bằng TestClient và bằng dịch vụ thật qua curl: /analyze trên 10 giây r01 trả 22 nhịp, 128,6 nhịp/phút, độ trễ mô hình 68 ms. Dockerfile và docker-compose.yml đã viết; chưa build được vì máy phát triển không chạy Docker engine, đã ghi rõ trong api/README.md.

Bộ kiểm thử tự động hiện có **53 test** (API 13, kiểm thử nhanh 16, lỗi demo 10, fSQI 6, baseline 4, loader Silesia 4), chạy 17 giây, và chạy trên CI với hai phiên bản Python.

## 8.5. Kịch bản trình bày ba phút

**Bảng 39:** Kịch bản demo. Phút cuối là phần quan trọng nhất.

| Thời điểm | Thao tác                        | Điều cần nói                                                                                      |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00–0:30 | Nạp r01, bấm Phân tích          | Năm phút tín hiệu, xử lý xong dưới một giây                                                       |
| 0:30–1:30 | Lướt năm tab tín hiệu           | Đây là chỗ nhịp thai bị chôn; đây là sau khi trừ mẹ                                               |
| 1:30–2:00 | Bật so sánh với nhãn            | 644 nhịp, không sót, không thừa, F1 100                                                           |
| 2:00–3:00 | <b>Nạp a02, bản ghi tệ nhất</b> | Đèn chuyển đỏ. Hệ thống tự biết nó bám nhầm tim mẹ và từ chối trả lời, thay vì báo một con số sai |

Demo chỉ chạy trên ca đẹp thì ai cũng làm được. Demo dám chạy trên ca xấu và *tự thừa nhận* mới là điểm khác biệt.

## 9. Chỉ số lâm sàng: hệ thống này dùng được đến đâu ở giường bệnh

F1 dò nhịp là chỉ số của người làm xử lý tín hiệu. Bác sĩ không quyết định gì dựa trên F1. Mục này đo bốn đại lượng mà một máy theo dõi tim thai thật sự phải trả lời, trên **32 bản ghi, 269,6 phút tín hiệu thật**: biến thiên ngắn hạn kiểu Dawes–Redman (STV), sai số nhịp tim thai theo Bland–Altman, độ phủ theo **thời lượng**, và tần suất khoá nhằm nhịp mẹ. Mã tại `analysis/clinical.py`, số liệu từng bản ghi tại `analysis/clinical_results.json`.

### Kết luận đặt ngay đầu mục, trước mọi con số

**Bộ dò này KHÔNG dùng được làm máy đo STV độc lập.** Trên tập con duy nhất đủ dài cho một trị số Dawes–Redman hợp lệ (10 bản ghi Silesia B1, 20 phút mỗi bản), giới hạn đồng thuận 95% là  $[-4,45; +8,14]$  ms quanh một ranh giới quyết định mà hai mốc lâm sàng 2,6 và 3,0 ms chỉ cách nhau **0,4 ms**. Ngay cả khi chỉ giữ những bản ghi mà công từ chối chấm “cao”, bề rộng vẫn là 1,00 ms — vẫn rộng gấp **2,5 lần** độ phân giải cần thiết. Nặng hơn: sai số **gần như chỉ đi một chiều**, 25/32 bản ghi máy đọc STV **cao hơn** sự thật. Đó đúng là chiều **trấn an giả**.

### 9.1. Giao thức, khai báo trước khi chạy

Epoch STV 3,75 giây (16 epoch/phút), trung bình khoảng RR trong epoch; STV là trung bình trị tuyệt đối hiệu giữa hai epoch liên tiếp. RR hợp lệ 0,25–0,75 s; epoch cần  $\geq 2$  khoảng RR hợp lệ. Cửa sổ nhịp tim thai 60 giây không chồng lấn (có quét thêm 5 / 10 / 30 giây). Dung sai khớp nhịp  $\pm 50$  ms.

### Một sai lệch có chủ ý so với kế hoạch, và lý do

Kế hoạch ban đầu dùng checkpoint `production_22` cho 17 bản ghi Silesia. Nhưng `production_22` được huấn luyện **trên chính 17 chủ thể đó** — đánh giá như vậy là trong mẫu. Nhóm thay bằng checkpoint fold giữ lại đúng chủ thể, rồi chạy thêm `production_22` chỉ để **đo mức thổi phồng**: F1 trung bình 22 chủ thể là 97,51 (ngoài mẫu) so với 99,31 (trong mẫu), và **độ chệch STV +1,51 ms ngoài mẫu so với +0,42 ms trong mẫu** — **đánh giá trong mẫu làm sai số STV nhỏ đi 3,6 lần**. Mọi con số trong mục này là ngoài mẫu.

9.2. Biến thiên ngắn hạn kiểu Dawes–Redman

**Bảng 40:** STV nhân so với STV mô hình. LoA là giới hạn đồng thuận Bland–Altman 95%.

| Tập             | <i>n</i> | STV nhân | STV mô hình | Độ chênh | LoA 95%          | Bề rộng |
|-----------------|----------|----------|-------------|----------|------------------|---------|
| ADFECGDB        | 5        | 9,62     | 9,95        | +0,33    | [−0,89; +1,55]   | 2,44    |
| Silesia B2      | 7        | 8,80     | 10,66       | +1,86    | [−6,90; +10,63]  | 17,53   |
| Silesia B1      | 10       | 7,74     | 9,59        | +1,84    | [−4,45; +8,14]   | 12,58   |
| CinC 2013 (PSD) | 10       | 5,54     | 26,04       | +20,50   | [−24,76; +65,76] | 90,52   |
| Tất cả          | 32       | 7,58     | 15,02       | +7,44    | [−23,05; +37,93] | 60,98   |

**Bảng 41:** Sai số STV bám rất sát chất lượng dò nhịp. Đơn vị ms.

| Dải F1                | <i>n</i> | Độ chênh | sai số  TB | sai số  max | Bề rộng LoA |
|-----------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| $F1 \geq 99,5$        | 18       | +0,10    | 0,13       | 0,71        | 0,92        |
| $99,0 \leq F1 < 99,5$ | 2        | +0,43    | 0,43       | 0,46        | 0,19        |
| $95 \leq F1 < 99$     | 3        | +1,17    | 1,17       | 1,61        | 2,12        |
| $F1 < 90$             | 9        | +25,78   | 25,78      | 67,14       | 79,48       |

Cơ chế rõ ràng và một chiều: mỗi dương tính giả hoặc âm tính giả làm nhiều một khoảng RR, nhiều đó cộng vào hiệu giữa hai epoch liên tiếp, nên **mọi lỗi dò nhịp đều đẩy STV LÊN**. Sai số không ngẫu nhiên — nó luôn đi về phía “biến thiên tốt, thai khỏe”. Đo được: 25/32 bản ghi cao hơn nhãn, 7 bản thấp hơn nhưng nhiều nhất chỉ −0,17 ms.

**Bảng 42:** Bảng quyết định ở ngưỡng lâm sàng TRUFFLE.

| Ngưỡng       | Bản ghi nhãn dương | Máy gắn cờ | TP | FN | FP |
|--------------|--------------------|------------|----|----|----|
| STV < 3,0 ms | 3 (a02, a07, a09)  | 0          | 0  | 3  | 0  |
| STV < 2,6 ms | 3 (a02, a07, a09)  | 0          | 0  | 3  | 0  |

STV mô hình trên ba bản ghi đó là 21,81 / 42,57 / 67,63 ms so với nhãn 1,18 / 0,93 / 0,49 ms — sai một đến hai bậc độ lớn, luôn về phía trấn an.

**Cảnh báo bắt buộc về ba bản ghi này**

Chúng dài **60 giây**. Dawes–Redman cần tối thiểu 10 phút. Vì vậy 1,18 / 0,93 / 0,49 ms **không phải trị số STV lâm sàng hợp lệ**, và nhóm **không** tuyên bố đó là ba thai bị suy. Nhóm đã kiểm tra: chuỗi RR nhãn không suy biến (a09 có 51 giá trị RR khác nhau, SD 16,1 ms) — trị số thấp là do RR so le lên xuống. Điều bảng này chứng minh được chỉ là:


**khi chuỗi tham chiếu nằm trong dải thấp, mô hình không tái tạo được nó.**

**Bảng 43:** Tập con hợp lệ nhất, và tại sao vẫn chưa đủ.

| Tập con                                                                   | <i>n</i> | Độ chệch | LoA 95%          | Bề rộng     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| Chỉ B1 — 20 phút, tập duy nhất đủ dài cho Dawes–Redman                    | 10       | +1,84    | [−4,45; +8,14]   | 12,58       |
| 22 chủ thể trong miền                                                     | 22       | +1,51    | [−4,88; +7,90]   | 12,78       |
| <b>Cổng chấm CAO + TRUNG BÌNH (= tất cả những gì máy thật sự trả lời)</b> | 23       | +0,27    | [−0,62; +1,16]   | <b>1,78</b> |
| Chỉ cổng chấm CAO                                                         | 15       | +0,11    | [−0,39; +0,61]   | 1,00        |
| Tất cả 32                                                                 | 32       | +7,44    | [−23,05; +37,93] | 60,98       |

Con số **có ý nghĩa vận hành** là hàng in đậm: sau khi cổng từ chối loại 9 bản ghi, LoA của những gì máy trả lời là [−0,62; +1,16] ms, bề rộng 1,78 ms. So với yêu cầu lâm sàng:

- Phân biệt 2,6 với 3,0 ms cần độ phân giải **0,4 ms**. LoA 1,78 ms rộng gấp **4,5 lần**; ngay cả 1,00 ms của nhóm “cao” cũng gấp **2,5 lần**.
- Bề rộng 1,78 ms bằng **59 %** của chính ngưỡng 3,0 ms, trên một thang mà bình thường là 5–9 ms.
- **Không một chủ thể nào trong 22 chủ thể trong miền có STV nhấn gần vùng bệnh lý** (thấp nhất 3,49 ms ở B1\_05). Nghĩa là **chưa có một điểm dữ liệu hợp lệ nào trong vùng ra quyết định** — khẳng định “mô hình phát hiện được STV thấp” hiện **không kiểm chứng được**, chứ không phải “đã bác bỏ”.

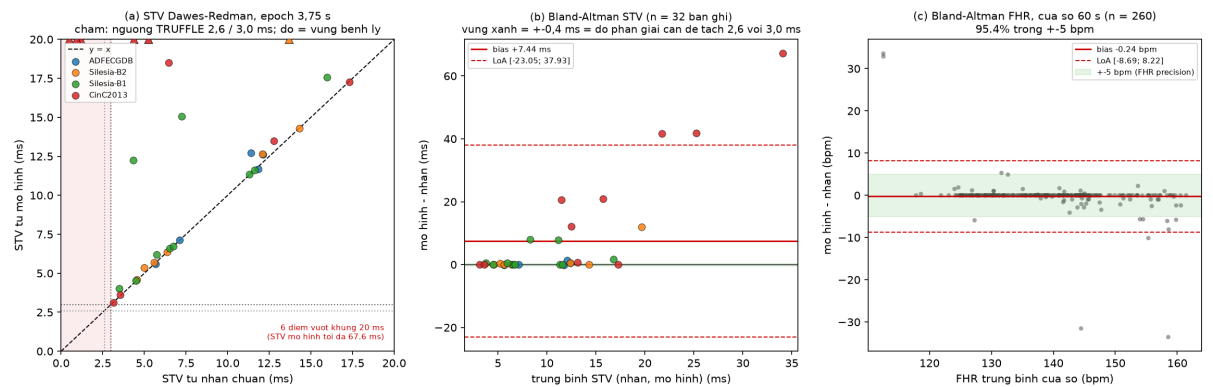

**Hình 20:** (a) STV nhận so với STV mô hình, phóng to vùng lâm sàng (vùng đỏ là bệnh lý). (b) Bland–Altman cho STV. (c) Bland–Altman cho nhịp tim thai, cửa sổ 60 giây. Nguồn: analysis/clinical.py.

### 9.3. Nhịp tim thai — đây là chỗ hệ thống thật sự dùng được

**Bảng 44:** Bland–Altman nhịp tim thai, cửa sổ 1 phút. Mẫu số là số cửa sổ nhân hợp lệ; 260/260 cửa sổ đều ghép cặp được, không cửa sổ nào bị loại vì mô hình không tính nổi.

| Tập             | $n$ cửa sổ | Độ lệch | LoA 95%          | MAE  | % trong $\pm 5$ bpm |
|-----------------|------------|---------|------------------|------|---------------------|
| ADFECGDB        | 25         | +0,11   | [−0,62; +0,83]   | 0,14 | <b>100,00</b>       |
| Silesia B2      | 35         | −0,41   | [−3,74; +2,91]   | 0,61 | 91,43               |
| Silesia B1      | 190        | +0,15   | [−6,88; +7,18]   | 0,70 | 97,37               |
| CinC 2013 (PSD) | 10         | −7,81   | [−34,60; +18,99] | 9,00 | <b>60,00</b>        |
| <b>Tất cả</b>   | 260        | −0,24   | [−8,69; +8,22]   | 0,95 | <b>95,38</b>        |

Độ lệch ổn định ở −0,23 bpm ở mọi độ dài cửa sổ: **không có sai lệch hệ thống về nhịp**; toàn bộ bề rộng LoA là do các bản ghi hỏng, không do sai số phân bố đều.

**Bảng 45:** Quét độ dài cửa sổ. Bài DPSS không nêu độ dài cửa sổ dùng cho “FHR precision 88,61 %”; cửa sổ càng dài càng dễ, nên nhóm quét cả dải. Giá trị là % cửa sổ trong  $\pm 5$  bpm.

| Tập           | 5 s                      | 10 s                     | 30 s              | 60 s              |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ADFECGDB      | <b>98,66</b> ( $n=299$ ) | <b>98,66</b> ( $n=149$ ) | 100,00 ( $n=50$ ) | 100,00 ( $n=25$ ) |
| Silesia B2    | 94,99 ( $n=419$ )        | 94,26 ( $n=209$ )        | 92,86 ( $n=70$ )  | 91,43 ( $n=35$ )  |
| Silesia B1    | 95,98<br>( $n=2389$ )    | 95,63<br>( $n=1190$ )    | 97,44 ( $n=390$ ) | 97,37 ( $n=190$ ) |
| CinC 2013     | 55,00 ( $n=120$ )        | 51,67 ( $n=60$ )         | 60,00 ( $n=20$ )  | 60,00 ( $n=10$ )  |
| <b>Tất cả</b> | 94,58<br>( $n=3227$ )    | 94,09<br>( $n=1608$ )    | 95,66 ( $n=530$ ) | 95,38 ( $n=260$ ) |

Trên ADFECGDB, **ngay ở cửa sổ ngắn nhất đã thử (5 giây) vẫn đạt 98,66 %**, cao hơn 88,61 % của DPSS. Đây là so sánh **bảo vệ được**: không thể nói nhóm thắng nhờ chọn cửa sổ dài. Vẫn phải kèm ba điều kiện: (i) DPSS chạy zero-shot từ FECGSYNDB tổng hợp còn đây là tách bản ghi trong miền — **hai giao thức khác nhau**; (ii) nhóm chưa chạy lại DPSS, đây là so với con số đã công bố; (iii)  $n = 5$  sản phụ.

## 9.4. Độ phủ theo THỜI LƯỢNG, không theo bản ghi

### Một cách gọi tên sai phải sửa

Con số 43,8 % trong facts\_phase2.json và trong bản v3.2 là **tỉ lệ BẢN GHI được chấm xanh, không phải độ phủ thời gian**. Hai đại lượng khác nhau và đang bị dùng lẫn. Từ đây mọi tuyên bố về độ phủ đều là **% thời lượng**.

Ba chính sách khai báo trước: **P1** trả lời trừ đoạn đỏ; **P2** chỉ trả lời đoạn xanh; **P3** như P1 nhưng bỏ cả bản ghi nếu độ tin cậy mức bản ghi là thấp.

**Bảng 46:** Độ phủ theo thời lượng và — quan trọng hơn — độ dài khoảng trống liên tục.

| Tập           | Thời lượng        | Đoạn 4 s | P1          | P2   | P3   | Khoảng trống P1: TV / p90 / max |
|---------------|-------------------|----------|-------------|------|------|---------------------------------|
| ADFECGDB      | 25,0 phút         | 375      | <b>96,0</b> | 88,8 | 96,0 | 4 s / 12 s / <b>12 s</b>        |
| Silesia B2    | 35,0 phút         | 525      | 88,2        | 61,3 | 81,0 | 4 s / 12 s / <b>56 s</b>        |
| Silesia B1    | 199,6 phút        | 2990     | 88,8        | 58,8 | 75,8 | 4 s / 12 s / <b>192 s</b>       |
| CinC 2013     | 10,0 phút         | 150      | <b>58,7</b> | 42,7 | 39,3 | 8 s / 33 s / 48 s               |
| <b>Tất cả</b> | <b>269,6 phút</b> | 4040     | <b>88,2</b> | 61,3 | 68,7 | 4 s / 16 s / <b>192 s</b>       |

**Bảng 47:** Đối chiếu với chuẩn lâm sàng. Các mốc CTG dưới đây do phản biện cung cấp và nhóm CHƯA đối chiếu bản gốc — phải kiểm chứng trước khi đưa vào bài báo.

| Chuẩn                    | Mất tín hiệu | RELYFETAL tương ứng                                                                          |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTG Doppler giai đoạn I  | 5–8 %        | ADFECGDB <b>4,0 %</b> đạt; Silesia 11,2–11,8 % <b>chưa đạt</b> ; CinC 41,3 % <b>chưa đạt</b> |
| CTG Doppler giai đoạn II | 9–20 %       | Silesia nằm trong dải này                                                                    |
| fECG bụng thương mại     | 5,3 %        | chỉ ADFECGDB đạt                                                                             |
| “Mất tín hiệu cao”       | > 20 %       | chỉ CinC vượt                                                                                |

### Tổng phần trăm không phải con số quan trọng nhất — độ dài khoảng trống mới là

Trung vị khoảng trống là 4 giây (một đoạn đơn lẻ), vô hại. Đuôi phân bố mới là chỗ nguy hiểm: **p90 = 16 giây, max = 192 giây** (B1\_07), và 48–64 giây ở B1\_06, B1\_10, B2\_03. Nhịp giảm muộn kéo dài 30–90 giây; nhịp giảm kéo dài theo định nghĩa là 2–10 phút. **Một khoảng trống 192 giây có thể giấu trọn một cơn giảm kéo dài mà máy không hề báo.** Ở chính sách P2 (chỉ tin đoạn xanh) khoảng trống lớn nhất là **528 giây**, không thể chấp nhận trên lâm sàng. Vì vậy mọi tuyên bố về độ phủ trong bài báo **bắt buộc** kèm p90 và max của khoảng trống.

Độ phủ chỉ 88,2 % vì công từ chối đang làm việc của nó. Nếu tắt công, máy trả lời 100 % thời lượng nhưng 9/32 bản ghi sẽ trả kết quả sai (F1 từ 19,35 đến 89,45). Đây là một **đánh đổi** và phải trình bày như đánh đổi, không được trình bày 88,2 % như khuyết điểm thuần túy hay 100 % như ưu điểm.

**Bảng 48:** Công từ chối có phân tầng đúng không.

| Mức công   | <i>n</i> | F1 TB | F1 min | $ \Delta\text{STV} $ TB | $ \Delta\text{STV} $ max |
|------------|----------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| cao        | 15       | 99,92 | 99,61  | 0,15 ms                 | 0,71 ms                  |
| trung bình | 8        | 98,81 | 96,54  | 0,56 ms                 | 1,61 ms                  |
| thấp       | 9        | 61,03 | 19,35  | 25,78 ms                | 67,14 ms                 |

**Lỗi nguy hiểm theo F1 (công nói cao/trung bình nhưng  $F1 < 90$ ): 0/32** — phân tầng sạch. **Nhưng lỗi nguy hiểm theo STV: 2** — r10 (+1,34 ms) và B1\_10 (+1,61 ms), cả hai đều có  $F1 \geq 96,5$ . Nghĩa là một công hiệu chuẩn cho việc dò nhịp vẫn để lọt sai số STV đủ lớn để lật một quyết định lâm sàng. Nếu muốn xuất STV thì phải hiệu chuẩn lại công theo tiêu chí STV.

## 9.5. Khoá nhằm nhịp mẹ — chế độ hồng nguy hiểm nhất

Nếu nhịp thai và nhịp mẹ độc lập, tỉ lệ trùng kỳ vọng là  $2 \times 50 \text{ ms} / \text{RR}_{\text{mẹ}}$ . Với RR mẹ 0,46–0,77 s trên 32 bản ghi, ngưỡng ngẫu nhiên này là **13,0–21,9 %**. Ước lượng giải tích khớp sát mô phỏng dịch vòng tròn 200 lần (a02: giải tích 21,9 % so với mô phỏng 21,2 %).

### Điểm phương pháp nhóm thêm vào

**Ngưỡng ngẫu nhiên KHÔNG phải mốc so đúng**, vì nhãn chuẩn cũng trùng đỉnh R mẹ đúng ở mức nền đó. Mốc đúng là **chính nhãn chuẩn của bản ghi đó** — nó hấp thụ mọi ghép cặp tần số thật giữa mẹ và thai. Nếu chỉ so với ngưỡng ngẫu nhiên sẽ báo động giả ở 6/32 bản ghi (r01, r08, a05, a08, B2\_03, B1\_06) mà nhãn chuẩn của chúng cũng vượt gần y hệt (r08: mô hình 20,4 % / nhãn 20,1 %; a08: 25,0 % / 25,0 %).

**Bảng 49:** Khoá nhịp mẹ, so với chính nhãn chuẩn của từng bản ghi.

| Tập           | Khoá mô hình | Khoá nhãn | Vượt TB | Vượt max | Vượt > 10 điểm |
|---------------|--------------|-----------|---------|----------|----------------|
| ADFECDGB      | 15,7 %       | 15,7 %    | −0,02   | +0,57    | 0              |
| Silesia B2    | 15,0 %       | 14,2 %    | +0,85   | +6,17    | 0              |
| Silesia B1    | 15,9 %       | 15,7 %    | +0,14   | +1,96    | 0              |
| CinC 2013     | 27,4 %       | 16,6 %    | +10,79  | +58,29   | 2              |
| <b>Tất cả</b> | 19,3 %       | 15,7 %    | +3,60   | +58,29   | 2              |

Trung vị trị tuyệt đối mức vượt trên 32 bản ghi là **0,32 điểm**: ở đại đa số bản ghi, mô hình

trùng nhịp mẹ **đúng bằng** mức mà nhãn thật cũng trùng — không có hiện tượng bám mẹ. Chỉ hai bản ghi thật sự khoá nhầm, cả hai đều ở CinC 13:


**Bảng 50:** Hai bản ghi khoá nhầm nhịp mẹ.

| Bản ghi | Mô hình       | Nhãn   | p95 rộng | Vượt  | F1    | Cổng gắn cờ?                                                         |
|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| a02     | <b>78,3 %</b> | 20,0 % | 44,2 %   | +58,3 | 24,91 | thấp — luật khoá mẹ kích hoạt                                        |
| a09     | <b>53,4 %</b> | 15,4 % | 24,6 %   | +38,0 | 19,35 | thấp — <b>nhưng qua <math>p_{bad}</math>, KHÔNG qua luật khoá mẹ</b> |

**a09 là bài học quan trọng nhất của mục này**

Hơn một nửa số “nhịp thai” mà mô hình trả về thực chất là nhịp mẹ, nhưng 53,4 % **nằm dưới ngưỡng cứng 60 %** nên luật ghi đề khoá mẹ **không kích hoạt**. Bản ghi được cứu là nhờ điểm  $p_{bad}$  của bộ phân loại SQI — **may, không phải thiết kế**.

**Khuyến nghị cụ thể, rõ và nên làm ngay:** thay luật ngưỡng tuyệt đối 60 % bằng **mức vượt so với phân phối rộng của chính bản ghi**. Cắt ở “vượt p95 mô phỏng hơn 10 điểm” bắt đúng cả a02 lẫn a09 và không tạo dương tính giả nào trong 30 bản ghi còn lại.

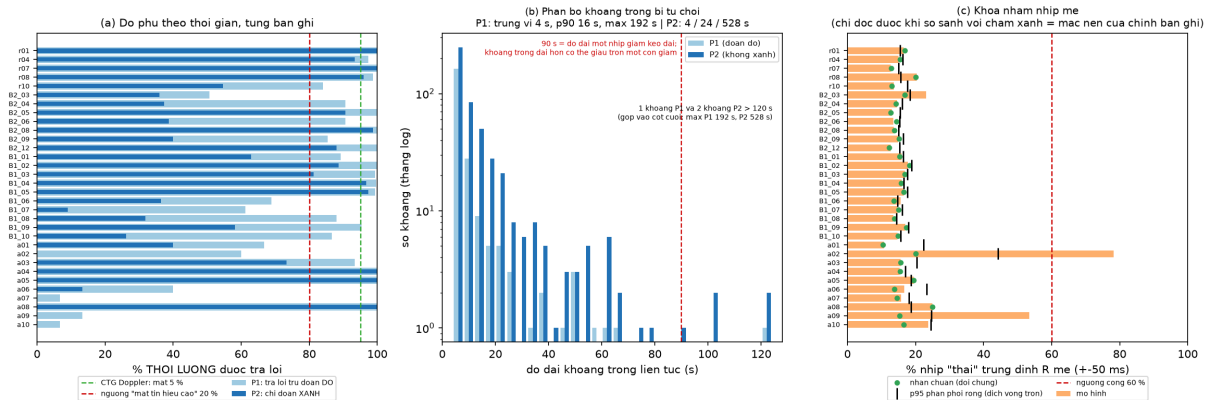

**Hình 21:** (a) % thời lượng trả lời từng bản ghi so với mốc CTG. (b) Phân bố độ dài khoảng trống, thang log, mốc 90 giây. (c) Khoá nhịp mẹ so với nhãn chuẩn và phân phối rộng.



## 9.6. Chọn kênh sửa được F1, nhưng không sửa được STV

**Bảng 51:** Bốn bản ghi CinC 2013 kém nhất: quy tắc PSD mù nhân so với kênh 0 hậu kiểm. STV tính bằng ms.

| Bản ghi | PSD: F1 / STV / phủ    | Kênh 0: F1 / STV / phủ | STV nhân |
|---------|------------------------|------------------------|----------|
| a01     | 80,99 / 18,52 / 66,7 % | 100,00 / 6,53 / 86,7 % | 6,45     |
| a07     | 45,63 / 42,57 / 6,7 %  | 86,92 / 12,47 / 80,0 % | 0,93     |
| a09     | 19,35 / 67,63 / 13,3 % | 94,25 / 6,37 / 93,3 %  | 0,49     |
| a10     | 47,13 / 46,16 / 6,7 %  | 70,89 / 27,58 / 46,7 % | 4,37     |

Điều đáng chú ý về lâm sàng: **ngay cả ở kênh 0 với F1 = 94,25, STV của a09 vẫn là 6,37 ms so với nhân 0,49 ms — sai 13 lần.** Vấn đề STV **không** sửa được bằng cách chọn kênh tốt hơn. Chọn kênh sửa được F1 và độ phủ; nó không sửa được độ phân giải STV.

## 9.7. Những gì mục này KHÔNG chứng minh được

1. **Không có dữ liệu trong vùng ra quyết định.** 22 chủ thể trong miền có STV nhân 3,49–15,97 ms; không ai gần 2,6–3,0 ms. Không thể ước lượng độ nhạy / độ đặc hiệu của cờ “STV thấp”.
2. **22/32 bản ghi ngắn hơn tối thiểu 10 phút của Dawes–Redman** (ADFECGDB và B2 là 5 phút, CinC là 1 phút). Chỉ 10 bản B1 cho một trị số STV hợp lệ về thời lượng.
3. **Không có thai dưới 38 tuần trong ADFECGDB**, trong khi giá trị lâm sàng của STV nằm ở tuần 24–37.
4. **Ngưỡng TRUFFLE 2,6 / 3,0 ms và các mốc mất tín hiệu CTG đều chưa được nhóm đối chiếu bản gốc.** Phải kiểm chứng và trích dẫn đúng trước khi đưa vào bài báo.
5. **STV Dawes–Redman gốc tính trên tín hiệu CTG Doppler lấy mẫu đều**, không phải trên chuỗi RR từng nhịp. Định nghĩa dùng ở đây là bản thích ứng hợp lý cho fECG nhưng **không đồng nhất** với thuật toán gốc.
6. **Một seed, một fold cho mỗi chủ thể.** B2\_03 — bản ghi có sai số STV lớn nhất trong miền (+11,99 ms) — cũng chính là bản ghi kém ổn định nhất theo seed (|hiệu| 2,81 điểm F1, xem §10). Sai số STV của nó có thể phần lớn là nhiễu huấn luyện.
7. Các hệ số tương quan ở bảng 40 ( $r = 0,986$  với  $n = 5$ ) là **mô tả**, không được trình bày như bằng chứng thống kê.

**Phát biểu cuối cùng về giá trị lâm sàng**

RELYFETAL hiện là **một bộ đếm nhịp tim thai tốt, không phải một máy đo biến thiên**. Nhịp tim thai: sai số trung bình dưới 1 bpm, 95,38 % cửa sổ trong  $\pm 5$  bpm trên 260 cửa sổ, và 98,66 % ngay ở cửa sổ 5 giây trên ADFECGDB — **dùng được**. STV: độ phân giải thiếu 2,5–4,5 lần, sai số một chiều về phía trấn an giả, 3/3 bản ghi tham chiếu thấp nhất bị bỏ sót — **chưa dùng được, và nhóm nói thẳng điều đó thay vì im lặng**. Độ phủ: đạt chuẩn CTG trên ADFECGDB, chưa đạt trên Silesia, hỏng trên CinC — và khoảng trống 192 giây là con số phải sửa trước khi nói đến thử nghiệm lâm sàng.

## 10. Kiểm định lại toàn bộ thống kê ở mức chủ thể

Mục này sửa một lỗi phương pháp có mặt trong **mọi** bản đề cương trước và trong bản thảo hội nghị: đơn vị phân tích. Mã tại `analysis/stats.py`, kết quả tại `analysis/stats_results.json` và `analysis/STATS.md`. Bootstrap cụm 10.000 lần, seed 0; biên tương đương khai báo trước  $\delta = 1,0$  điểm F1.

### 10.1. Lỗi đã sửa

**Bảng 52:** Sáu thay đổi phương pháp.

|                       | Cách cũ                                                   | Cách mới                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Đơn vị phân tích      | Cặp (bản ghi $\times$ kênh), 20–88 cặp                    | <b>Chủ thể</b> (trung bình 4 kênh trước), $n = 5\text{--}22$ |
| Giả định độc lập      | 4 kênh bụng của cùng một phụ nữ coi là 4 quan sát độc lập | Kênh là đo lặp lại trong cụm; chủ thể là đơn vị              |
| Khoảng tin cậy        | $t$ trên thang phần trăm                                  | Thang logit + bootstrap percentile                           |
| Biến thiên            | SD trên cặp                                               | Bootstrap cụm, lấy mẫu lại <b>chủ thể</b>                    |
| Đa so sánh            | không hiệu chỉnh                                          | Holm cho họ 7 kiến trúc                                      |
| Kết luận “không khác” | $p > 0,05$                                                | <b>TOST</b> biên 1,0 điểm                                    |

#### Giới hạn cứng của $n = 5$ — con số phải ghi nhớ

Với  $n = 5$  chủ thể, kiểm định Wilcoxon hạng có dấu hai phía có  $p$  **nhỏ nhất có thể đạt** là  $2/2^5 = \mathbf{0,0625}$ . Do đó **KHÔNG một so sánh nào** trên ADFECGDB (5 sản phụ) có thể đạt  $p < 0,05$  ở mức chủ thể, bất kể hiệu số lớn đến đâu.

Mọi  $p < 0,05$  từng báo cáo trên tập này —  $1,9 \times 10^{-6}$ ,  $5,7 \times 10^{-6}$ , 0,0000 — đều là **sản phẩm của giả lập** (pseudo-replication) trên 20–60 hàng (bản ghi  $\times$  kênh  $\times$  seed). Chúng đã bị gỡ khỏi toàn bộ đề cương.

10.2. Bảng tổng hợp: mọi so sánh chính, tính lại ở mức chủ thể

**Bảng 53:** Quy ước hiệu số: **A – B** với A là đối tượng đứng đầu trong tên so sánh. Cột “KTC 95% *t*” bảo thủ hơn; khi hai cột mâu thuẫn thì tin cột *t*.

| So sánh                                                                | <i>n</i> | <i>p</i> cũ<br>(giả lập) | <i>p</i> mới  | Hiệu số | KTC 95%<br>bootstrap | KTC 95% <i>t</i>       | Cliff |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------|-------|
| <i>ADFECGDB, trung bình 4 kênh — mô hình so với baseline cổ điển:</i>  |          |                          |               |         |                      |                        |       |
| vs TS                                                                  | 5        | $5,7 \times 10^{-6}$     | <b>0,0625</b> | +18,49  | [+6,38; +30,60]      | <b>[−1,81; +38,80]</b> | 1,000 |
| vs TS-PCA                                                              | 5        | $1,9 \times 10^{-6}$     | <b>0,0625</b> | +6,40   | [+4,70; +8,09]       | <b>[+3,69; +9,10]</b>  | 0,920 |
| vs Prominence                                                          | 5        | $1,9 \times 10^{-6}$     | <b>0,0625</b> | +11,06  | [+7,80; +14,51]      | <b>[+5,73; +16,38]</b> | 1,000 |
| <i>Mô hình 22 ca so với mô hình 5 ca, trung bình 4 kênh:</i>           |          |                          |               |         |                      |                        |       |
| PhysioNet                                                              | 5        | 0,2445                   | 0,8125        | +1,24   | [−0,35; +3,01]       | [−1,44; +3,91]         | 0,200 |
| Silesia B2                                                             | 7        | <b>0,0156</b>            | <b>0,4688</b> | +0,77   | [−0,16; +2,38]       | [−1,15; +2,68]         | 0,102 |
| Silesia B1                                                             | 10       | $4,3 \times 10^{-9}$     | 0,0039        | +5,71   | [+2,12; +10,17]      | [+0,79; +10,62]        | 0,500 |
| Toàn bộ 22                                                             | 22       | $1,5 \times 10^{-8}$     | 0,0029        | +3,12   | [+1,27; +5,48]       | [+0,76; +5,48]         | 0,264 |
| <i>Tầng 2 (ngữ cảnh) — TCN trường 1.516 ms so với CNN của số ngắn:</i> |          |                          |               |         |                      |                        |       |
| Tầng do ngữ cảnh                                                       | 5        | —                        | 0,0625        | +4,49   | [+1,58; +7,43]       | <b>[−0,29; +9,27]</b>  | 0,520 |

Ba điều phải đọc kèm bảng trên

- Mất ý nghĩa không tự động có nghĩa là mất hiệu ứng — nhưng với TS thì mất thật.** Với TS-PCA và Prominence, *p* tăng từ  $\sim 10^{-6}$  lên 0,0625 chỉ vì *n* = 5 làm sản kiểm định hạng, còn KTC 95% của hiệu số vẫn **loại trừ 0** ở cả bootstrap lẫn thang *t*. Với hai baseline này, *hướng* của kết quả giữ nguyên; chỉ là **không được tuyên bố ý nghĩa thống kê** từ 5 phụ nữ. Nhưng với **TS thì khác**: KTC 95% kiểu *t* là [−1,81; +38,80] — **chứa cả 0**. Hiệu số 18,49 điểm hoàn toàn do biến thiên giữa 5 bản ghi. Bảng baseline cũ trình bày cả ba như nhau; thực tế chúng không cùng độ chắc.
- Bootstrap với *n* = 5 cụm hẹp hơn thực tế.** Với *n* = 5–7 phải báo cáo cả hai cột.
- Sign test bảo thủ nhất và cho thấy độ mạnh thật.** Ví dụ “toàn bộ 22 chủ thể” có Wilcoxon *p* = 0,0029 nhưng sign test *p* = 0,0525 — kết quả phụ thuộc vào **độ lớn** của vài chủ thể, không phải vào việc đa số chủ thể đều cải thiện.

### 10.3. Khoảng tin cậy cho các con số đặt trên tiêu đề

**Bảng 54:** Cột “KTC 95% *t* trên %” là cột **đang có lỗi** trong các bản trước: nó **vượt 100%**. Cột in đậm là cột phải dùng trong bảng kết quả chính.

| Con số                          | <i>n</i> | TB    | KTC 95% <i>t</i><br>trên % (SAI) | KTC 95%<br>bootstrap | KTC<br>95% logit |
|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| ADFECGDB kênh PSD, mô hình 5 ca | 5        | 99,21 | [97,35; 101,08]                  | [97,87; 99,95]       | [98,21; 99,96]   |
| ADFECGDB 4 kênh, mô hình 5 ca   | 5        | 97,45 | [93,77; 101,13]                  | [94,94; 99,63]       | [90,65; 99,90]   |
| Silesia B1, mô hình 5 ca        | 10       | 93,30 | [83,67; 102,93]                  | [84,93; 99,37]       | [94,79; 99,72]   |
| Silesia B1, mô hình 22 ca       | 10       | 97,15 | [93,61; 100,69]                  | [94,00; 99,67]       | [97,85; 99,93]   |

#### Hai ước lượng điểm khác nhau, dùng nhầm là sai

Cột **bootstrap** là khoảng cho **trung bình số học** của F1 trên các chủ thể — đây là đại lượng mà đề cương đang báo cáo (99,21 / 93,30). Nó không bao giờ vượt 100% vì chỉ lấy lại mẫu từ các giá trị quan sát. Dùng cột này trong bảng kết quả chính.

Cột **logit** là “F1 điển hình của một chủ thể mới”, kéo về phía các giá trị cao, nên nó **có thể cao hơn** trung bình số học (Silesia B1: TB số học 93,30 nhưng điểm logit 98,78). Dùng cột này khi nói về **một ca lâm sàng mới**, và phải nói rõ đó là đại lượng **khác** — nếu báo cáo nhầm, con số sẽ bị thổi phồng.

Độ rộng thật: ADFECGDB  $n = 5$  cho KTC rộng vài điểm F1 (không phải  $\pm 1,5$  như SD gợi ý); Silesia B1 và CinC 2013 rộng hơn 10–30 điểm.

## 10.4. Họ kiến trúc: kiểm định tương đương (TOST), biên 1,0 điểm F1

**Bảng 55:** TOST với biên tương đương  $\delta = 1,0$  điểm F1,  $n = 5$  chủ thể, hiệu chỉnh Holm cho họ 7 so sánh.

| Kiến trúc | Macro F1 | Hiệu số | $p$ Wilc. | $p$ Holm | KTC 90% bootstrap | $p$ TOST | Kết luận                 |
|-----------|----------|---------|-----------|----------|-------------------|----------|--------------------------|
| cnn_1     | 92,43    | +0,73   | 0,125     | 0,625    | [+0,18; +1,22]    | 0,238    | không kết luận được      |
| mlp       | 91,64    | -0,07   | 1,000     | 1,000    | [-3,47; +3,52]    | 0,360    | không kết luận được      |
| cnn_gru   | 91,59    | -0,12   | 0,813     | 1,000    | [-0,72; +0,54]    | 0,058    | không kết luận được      |
| tcn       | 91,07    | -0,64   | 0,188     | 0,750    | [-1,13; -0,11]    | 0,183    | không kết luận được      |
| resnet1d  | 90,90    | -0,81   | 0,625     | 1,000    | [-1,79; +0,09]    | 0,389    | không kết luận được      |
| cnn_m     | 88,76    | -2,95   | 0,063     | 0,438    | [-4,55; -1,47]    | 0,930    | <b>KÉM HƠN vượt biên</b> |
| linear    | 37,47    | -54,24  | 0,063     | 0,438    | [-56,41; -50,49]  | 1,000    | khác biệt vượt biên      |

### Đây là đảo chiều lớn nhất của toàn bộ đợt rà soát

Tuyên bố trong bản v3.2 và trong kho mã — “tám kiến trúc không phân biệt được, không cái nào khác cnn\_dil 26k tham số” — **không sống sót qua kiểm định tương đương:**

- 0/7 kiến trúc chứng minh được tương đương trong biên  $\pm 1,0$  điểm F1; **6/7 không kết luận được.**
- Kết luận cũ rút ra từ  $p > 0,05$ . Với  $n = 5$  chủ thể,  $p > 0,05$  là kết quả **gần như đương nhiên** (ngưỡng khả thi nhỏ nhất là 0,0625) — nó đo **công suất thấp**, không đo sự giống nhau.
- Ngược lại, cnn\_m **KÉM HƠN rõ**: hiệu số -2,95 điểm, KTC 90% bootstrap [-4,55; -1,47] nằm **hoàn toàn ngoài** biên  $\pm 1,0$ . Tuyên bố “sáu kiến trúc nằm trong 1,5 điểm của nhau” không đúng với cnn\_m.
- cnn\_1 **tốt hơn** cnn\_dil 0,73 điểm, KTC 90% bootstrap [+0,18; +1,22] — không loại trừ được khả năng vượt biên 1,0.

**Phát biểu thay thế, là câu nhóm sẽ dùng:** “Với  $n = 5$  chủ thể, nghiên cứu này **không đủ lực** để phân biệt các kiến trúc trong biên 1,0 điểm F1; hiệu số quan sát được nằm trong khoảng -2,95 đến +0,73 điểm, nhỏ hơn nhiều so với +11,00 điểm của tầng front-end.”

Câu này giữ nguyên thông điệp chính (front-end quan trọng hơn kiến trúc) mà không tuyên bố điều chưa chứng minh.

## 10.5. Cổng từ chối: AUROC trong bản ghi mới là con số lâm sàng

**Bảng 56:** Cluster bootstrap theo **bản ghi** ( $n = 10$  cụm), không theo đoạn.

| Đại lượng                                                             | Giá trị      | KTC 95% cụm    | Báo cáo cũ               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| AUROC (12 SQI cổ điển, CinC 2013)                                     | 0,929        | [0,830; 0,982] | 0,929                    |
| Lợi ích F1 ở độ phủ 80%                                               | 7,49         | [2,94; 11,54]  | 7,37                     |
| AUROC nhóm đặc trưng tô-pô                                            | 0,566        | chưa tính được | 0,566                    |
| <b>AUROC TRONG bản ghi</b> (TB trên 5 bản ghi có cả đoạn tốt lẫn xấu) | <b>0,721</b> | [0,517; 0,898] | <b>chưa từng báo cáo</b> |

AUROC từng bản ghi:  $a_{01} = 0,914$ ;  $a_{06} = 0,390$ ;  $a_{07} = 0,889$ ;  $a_{09} = 0,886$ ;  $a_{10} = 0,526$ . Năm bản ghi còn lại không có đoạn xấu nào nên không đóng góp gì vào AUROC gộp.

### Phát hiện mới, quan trọng cho C3

AUROC gộp 0,93 **phần lớn là hiệu ứng GIỮA bản ghi** (tách bản ghi tốt khỏi bản ghi xấu), không phải khả năng xếp hạng đoạn **BÊN TRONG** một bản ghi. Trong ứng dụng thật — một thai phụ, một phiên đo — chỉ AUROC **trong** bản ghi mới có ý nghĩa, và con số đó là **0,721** [0,517; 0,898].

Con số 0,929 trên thực tế trả lời câu hỏi “*bản ghi này có phải bản ghi xấu không*”, trong khi cổng từ chối đang được bán như là thứ trả lời “*đoạn 4 giây này trong bản ghi của bệnh nhân này có đáng tin không*”. Đây là giới hạn phải nêu rõ, và là lý do kết quả C3 **chưa** thể tuyên bố là dùng được tại giường bệnh.

## 10.6. Độ ổn định theo seed

Tất cả kết quả chính chạy **một seed**. Nhóm đã huấn luyện lại toàn bộ mô hình 22 chủ thể với seed 1 (model/train\_22\_seed1.json) để đo biến thiên huấn luyện.

**Bảng 57:** So sánh seed 0 với seed 1 trên 20 chủ thể chung, kênh PSD mù nhân.

| Đại lượng                | Giá trị           | Đọc thế nào                       |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Số chủ thể chung         | 20                |                                   |
| hiệu số  F1 trung bình   | <b>0,28 điểm</b>  | nhỏ so với mọi hiệu ứng báo cáo   |
| hiệu số  lớn nhất        | 2,81 điểm (B2_03) | bản ghi kém ổn định nhất          |
| Ngưỡng từng fold, seed 0 | 0,20 – 0,80       | có một giá trị cực đoan 0,20      |
| Ngưỡng từng fold, seed 1 | 0,50 – 0,80       | <b>không tái lập giá trị 0,20</b> |

Hai kết luận. Thứ nhất, **biến thiên theo seed (0,28 điểm) nhỏ hơn nhiều so với mọi hiệu ứng được báo cáo** trong đề cương — +11,00 của front-end, +4,49 của ngưỡng cảnh, +8,18 của dữ liệu trên CinC 75 bản ghi. Các kết luận định tính không bị seed lật. Thứ hai, **ngưỡng từng fold kém ổn định hơn hẳn**: giá trị 0,20 của fold 10 ở seed 0 không tái lập ở seed 1 (dải 0,50–0,80). Đó là cảnh báo rằng quy trình chọn ngưỡng trên một chủ thể validation duy nhất là điểm mong manh của pipeline.

#### Mọi KTC trong đề cương này bao phủ cái gì

Bootstrap cụm trong mục này lấy mẫu lại **chủ thể**, nên KTC bao phủ **biến thiên giữa chủ thể**. Chúng **không** bao phủ biến thiên huấn luyện; phần đó được đo riêng ở bảng 57 và bằng 0,28 điểm trung bình.

## 10.7. Những gì KHÔNG kiểm chứng lại được từ artefact hiện có

**Bảng 58:** Ba mục nhóm không thể tự kiểm chứng lại, và hệ quả.

| Mục                                                               | Lý do                                                                                                                       | Hệ quả                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tầng 1 — front-end dải thông (+11,00 điểm, từng ghi $p < 0,001$ ) | pilot_evidence/band_ablation.json chỉ lưu tổng hợp (macro F1 $\pm$ SD cho mỗi dải), KHÔNG lưu F1 từng bản ghi $\times$ kênh | $p < 0,001$ <b>cho tầng 1 hiện KHÔNG kiểm chứng được.</b> Hiệu số +11,00 vẫn đứng; trị số $p$ đã bị gỡ. Phải chạy lại có lưu per-record |
| AUROC nhóm đặc trưng tô-pô (0,566)                                | fsqi/gate_segments.csv chỉ lưu $p_{bad}$ của bộ phân loại SQI cổ điển; muốn bootstrap theo cụm phải huấn luyện lại          | 0,566 vẫn dùng làm kết luận phủ định, nhưng chưa có KTC theo cụm                                                                        |
| Biến thiên theo seed cho các bảng cũ                              | Chỉ mô hình 22 ca có 2 seed; bảng kiến trúc và khảo sát dải chỉ 1 seed                                                      | KTC hiện có chỉ bao phủ biến thiên giữa chủ thể                                                                                         |



## 10.8. Nguyên tắc chung cho mọi con số từ đây

1. Báo cáo **ước lượng hiệu số kèm KTC** làm kết quả chính;  $p$ -value là phụ và phải luôn đi kèm  $n$  chủ thể.
2. Với  $n = 5-10$ , **không tuyên bố ý nghĩa thống kê ở bất kỳ đâu**.
3. Với kết luận “không khác nhau”, **bắt buộc** dùng TOST kèm biên được định trước.
4. Đơn vị phân tích luôn là **chủ thể**; kênh là đo lặp lại trong cụm.
5. Với  $n = 75$  (CinC 2013 toàn bộ) thì kiểm định **có** đủ lực và  $p$  được báo cáo bình thường — đó là tập duy nhất trong đề tài đủ lớn cho điều đó.

## 11. Khảo sát ý tưởng hệ thống nhiều mô hình

Một hướng nhóm cân nhắc là: thay vì một mô hình duy nhất, xây một hệ thống nhiều tác tử, mỗi nhiệm vụ con dùng mô hình tối ưu riêng cho nó. Mục này là kết quả khảo sát nghiêm túc ý tưởng đó, dựa trên bằng chứng từ 30 công trình đã đọc và từ số đo của chính nhóm.

### 11.1. Nhận xét đầu tiên: pipeline hiện tại đã là hệ dị thể

Pipeline của nhóm hiện gồm bốn khối dùng bốn loại công cụ khác nhau: lọc Butterworth (xử lý tín hiệu cổ điển), mẫu trung vị kết hợp bình phương tối thiểu (thống kê cổ điển), mạng tích chập giãn nở (học sâu), và lấy đỉnh có thời gian trễ (luật xác định). Đây **đã là** nguyên tắc “mỗi việc một công cụ tối ưu”. Thêm một tầng điều phối lên trên chỉ đổi tên gọi chứ không thêm năng lực.

### 11.2. Phân rã bảy nhiệm vụ con và mô hình tối ưu cho từng nhiệm vụ

**Bảng 59:** Bảy nhiệm vụ con của bài toán và mô hình tối ưu theo bằng chứng từ y văn cùng số đo của nhóm.

| # | Nhiệm vụ con                     | Mô hình tối ưu theo bằng chứng                                                     | Trạng thái             |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Đánh giá chất lượng tín hiệu     | Còn bỏ ngỏ. Heuristic phổ sục ngoài miền (§5.3)                                    | <b>Đây chính là C3</b> |
| 2 | Dò QRS mẹ                        | Luật cổ điển kiểu Pan–Tompkins                                                     | Đã có, đủ tốt          |
| 3 | Khử ECG mẹ                       | <b>Còn tranh chấp thật:</b> trừ mẫu, lọc Kalman mở rộng, hay mạng tái tạo          | Cơ hội cải tiến        |
| 4 | Dò QRS thai                      | Đôi kiến trúc chỉ đáng $-2,95$ đến $+0,73$ điểm; $n = 5$ không đủ lực để phân biệt | Đã có, dư địa nhỏ      |
| 5 | Sửa lỗi nhịp, nội suy khoảng mất | Làm mượt khoảng RR bằng luật sinh lý                                               | Chưa làm               |
| 6 | Ước lượng nhịp tim thai          | Tính trực tiếp từ khoảng RR                                                        | Đã có                  |
| 7 | Quyết định từ chối trả lời       | Chưa có tiền lệ cho tín hiệu thai                                                  | <b>Đây chính là C3</b> |

Trong bảy nhiệm vụ, **năm** có lời giải tốt nhất là giải pháp cổ điển xác định, **một** đã bão hoà, và chỉ **một** (khử ECG mẹ) còn tranh chấp thật sự về mô hình.

### 11.3. Y văn nói gì về hướng nhiều mô hình

Trong 30 công trình đã đọc, **không có công trình nào** dùng tác tử ngôn ngữ lớn hoặc kiến trúc hỗn hợp chuyên gia có công học được cho bài toán điện tim thai. Nhưng **có** tiền lệ rõ ràng cho hợp nhất, nối tầng và **cho chính cơ chế từ chối** (Andreotti và cộng sự 2017, fSQI; Shi và cộng sự 2023; Baldazzi và cộng sự 2023) — xem §3.4:

**Bảng 60:** Tiền lệ hợp nhất và nối tầng trong y văn, kèm mức lợi ích công bố.

| Công trình                        | Cơ chế                                   | Mức lợi ích công bố                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Behar và cộng sự 2014 (FUSE)      | Hợp nhất nhiều bộ trích xuất             | khoảng +3,0 điểm F1 so với phương pháp đơn tốt nhất |
| Shokouhmand & Tavassolian 2023    | Nối tầng khối khứ nhiều trước tách nguồn | +22,45 điểm                                         |
| Asadi và cộng sự 2025             | Nối tầng hai mạng U-Net                  | +1,1 đến +1,6 điểm độ nhảy                          |
| Behar và cộng sự 2014 (công bSQI) | <b>Cổng từ chối</b> theo chất lượng      | +0,95 đến +1,11 điểm khi chỉ loại 3,6% tín hiệu     |

#### Kết luận quan trọng nhất của mục này

Giá trị của “tác tử” trong y văn điện tim thai nằm ở **quyền chọn** và **quyền từ chối**, không nằm ở việc luân chuyển giữa nhiều mô hình dò. Điều này trùng khít với đóng góp C3 mà nhóm đã đề xuất.

### 11.4. Còn bao nhiêu dư địa để cải tiến

Trong miền, nhóm đang ở 99,21 (kênh mù nhãn) và 97,45 (trung bình bốn kênh). Trần là 100. Nghĩa là dư địa còn lại chỉ **0,79** đến **2,55** điểm. Trong khi đó, kiểm định tương đương ở biên 1,0 điểm cho **0/7** kiến trúc kết luận được với  $n = 5$  chủ thể (§10). Suy ra: **bất kỳ thành phần nào hứa hẹn dưới khoảng 1 điểm đều không chứng minh được với  $n = 5$** , nên không đáng xây — và điều này đúng theo nghĩa *thiếu công suất*, không theo nghĩa *đã chứng minh là vô ích*.

Chỗ sụp thật sự là ngoài miền: **64,04 trên 60 bản ghi sạch của CinC 2013** (mô hình 5 ca; 74,28 với mô hình 22 ca — §5.10.3), với 22 bản ghi dưới 50 (§5.10.3). Đó mới là nơi đáng đầu tư. Và mục tiêu định lượng đã rõ: quy tắc chọn kênh một mình đang mất **7,47 điểm** so với oracle ngoài miền, trong khi trong miền chỉ mất 0,02–1,90 điểm.

## 11.5. Rủi ro và khuyến nghị

### Rủi ro lớn nhất không phải tốc độ

Rủi ro lớn nhất của một hệ bảy tác tử là nó phá hỏng **hai tài sản duy nhất** khiến đề tài này có cửa đăng Q1:

1. **Tính đơn giản tái lập được:** 113.481 tham số, 0,48 MB, 4,35 ms. Rất hiếm trong 30 công trình đã đọc, và là điểm mạnh thật khi phản biện.
2. **Tính chặt chẽ thống kê trên  $n = 5$  sản phụ.** Mỗi thành phần học được thêm vào là một chỗ mới cho rò rỉ dữ liệu ẩn nấp và một siêu tham số mới phải biện minh.

Y vẫn có ví dụ cụ thể: FUSE với mười hai siêu tham số đã buộc chính tác giả phải báo cáo F1 trong mẫu.

### Khuyến nghị của nhóm, theo thứ tự ưu tiên:

1. **Xây công từ chối**, báo cáo bằng đường cong rủi ro–độ phủ kèm đường cơ sở công ngẫu nhiên. Đây là C3 — *đã làm* (§7); việc còn lại là thay luật cứng trong demo bằng bộ phân loại cổ điển đã huấn luyện.
2. **Làm mượt khoảng RR** bằng luật sinh lý, kèm bắt buộc so với đường cơ sở nhịp hằng số.
3. **Thí nghiệm chẩn đoán** vì sao ba bản ghi CinC sụp đổ.
4. Chỉ khi ba việc trên xong mới cân nhắc bộ chọn dải thông thích nghi — dạng “tác tử” duy nhất có căn cứ, vì nhóm đã chứng minh dải thông là biến quan trọng nhất.

**Không** xây hệ bảy tác tử. **Không** dùng mô hình ngôn ngữ lớn điều phối. Cả hai đều thêm độ phức tạp mà nhóm không chứng minh được là cần thiết, và phản biện Q1 sẽ đánh đúng vào đó.

## 12. Những chỗ đề tài còn yếu

Mục này nhóm viết ở vai phản biện của một tạp chí Q1, cố tình tìm cách bác bỏ chính mình. Nhóm đưa vào đề cương vì hội đồng sẽ hỏi những câu này, và tốt hơn là nhóm trả lời trước.

**Bảng 61:** Các điểm yếu nhóm tự xác định, mức nghiêm trọng và cách xử lý.

| Điểm yếu                                                                         | Mức độ                       | Cách xử lý                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chỉ 5 sản phụ, tất cả đang chuyển dạ                                             | <b>Đã xử lý</b>              | Đánh giá và <b>huấn luyện</b> đều trên 22 sản phụ độc lập, 10 thai kỳ (§5.8, §5.10). Còn lại: vẫn một bệnh viện, một hệ ghi                                                                                                             |
| Sụp đổ xuyên hệ ghi (CinC 2013)                                                  | <b>CHƯA xử lý</b>            | Bản 3.2 tuyên bố “đã xử lý phần lớn, không bản ghi nào dưới 50”. Tuyên bố đó dựa trên mẫu 10 bản ghi và <b>sai</b> trên toàn bộ 75: vẫn còn <b>16/75 bản ghi dưới 50</b> với mô hình 22 ca (§5.10.3). Đây là điểm yếu số một của đề tài |
| Mọi trị số $p$ tính trên cặp (bản ghi $\times$ kênh), tức giả lập                | <b>Đã xử lý</b>              | Tính lại toàn bộ ở mức chủ thể, bootstrap cụm, TOST cho kết luận tương đương (§10). Hệ quả: gỡ mọi $p$ trên ADFECGDB và rút hai kết luận                                                                                                |
| Khoảng tin cậy 95% của 99,21 với $n = 5$ vượt quá 100%                           | <b>Đã xử lý</b>              | Thay bằng bootstrap cụm: [97,87; 99,95]. Bảng đầy đủ ở §10                                                                                                                                                                              |
| Tuyên bố “8 kiến trúc không phân biệt được”                                      | <b>Đã RÚT</b>                | TOST biên 1,0 điểm cho 0/7 tương đương, 6/7 không kết luận được, và <b>cnm_m kém hơn</b> vượt biên. Phát biểu mới: “không đủ lực để phân biệt” (§10)                                                                                    |
| Bảng 16 kiến trúc chạy ở dải sai, một bản ghi, ngưỡng quét trên bản ghi đánh giá | <b>Đã xử lý</b>              | Chạy lại 8 kiến trúc ở 10–60 Hz, tách bản ghi đầy đủ, ngưỡng trên validation (§4). Còn thiếu: ba seed và ba kiến trúc nặng                                                                                                              |
| Chưa cài lại baseline nào                                                        | <b>Đã xử lý</b>              | Ba baseline cổ điển (§5.6), Power-MF <b>đa kênh</b> chạy lại qua GNU Octave, và Power-MF <b>đơn kênh</b> tự cài (§5.7). Không phân biệt được với bản đa kênh (−1,27; KTC [−3,08; +0,27]), hơn hẳn bản đơn kênh (+10,85; 22/22)          |
| Chưa có chỉ số lâm sàng nào                                                      | <b>Đã xử lý, kết quả xấu</b> | STV, Bland–Altman nhịp tim thai, độ phù theo thời lượng, khoá nhịp mẹ — 32 bản ghi, 269,6 phút (§9). Kết luận: <b>chưa dùng được làm máy đo STV</b>                                                                                     |
| Chỉ một seed                                                                     | <b>Đã xử lý</b>              | Seed 1 đã chạy:  hiệu số  trung bình 0,28 điểm trên 20 chủ thể; nhưng ngưỡng từng fold <b>không</b> ổn định theo seed (§10)                                                                                                             |
| Đóng góp C3 chưa có dữ liệu                                                      | <b>Đã xử lý</b>              | Prototype đã chạy. Phần topo cho kết quả phù định, phần công từ chối có tác dụng (§7, §8). <b>Nhưng AUROC trong</b> bản ghi chỉ 0,721, không phải 0,929 (§10)                                                                           |
| Khoảng trống dữ liệu dài tới 192 giây khi công từ chối                           | <b>Mới phát hiện</b>         | Đủ để giấu trọn một con giảm kéo dài. Phải sửa trước khi nói đến thử nghiệm lâm sàng (§9)                                                                                                                                               |
| Luật khoá nhịp mẹ dùng ngưỡng cứng 60 %                                          | <b>Mới phát hiện</b>         | a09 khoá mẹ 53,4 % mà luật không kích hoạt; được cứu nhờ $p_{bad}$ , tức nhờ may. Thay bằng “vượt p95 phân phối rộng > 10 điểm” (§9)                                                                                                    |
| Nhóm đoán nguyên nhân trước khi đo, hai lần trong một ngày                       | <b>Mới phát hiện</b>         | Cả hai lần đều đoán sai, và mỗi lần suýt dẫn tới một baseline bị sửa tham số hoặc một quy tắc chọn kênh khớp vào tập đánh giá. Nguyên tắc mới: không phát biểu nguyên                                                                   |

## 12.1. Đánh giá thẳng thắn ba đóng góp

### C2 — đủ mạnh, là xương sống, nhưng phải phát biểu khiêm tốn hơn.

Phân rã đóng góp ba tầng vẫn là phần vững nhất: chưa công trình nào ghép front-end, ngữ cảnh và họ kiến trúc vào **một** thí nghiệm duy nhất trong fECG. Nhưng ba điều phải nói thẳng: (i) luận điểm định tính **đã có** từ Andreotti và cộng sự 2016, nhóm chỉ thêm con số (§3.4); (ii) dải 10–60 Hz là dải nhóm **lấy từ Xu 2026**, không phải nhóm phát hiện; (iii) tầng 1 đo trên GBM chứ không trên TCN, và  $p$  của nó **không kiểm chứng lại được** (§10). **Và điều thứ tư, nặng hơn ba điều trên:** bản lặp lại tầng 1 trên chính TCN đã có kết quả sơ bộ và chỉ cho **+2,44 điểm** với KTC  $[-0,04; +6,29]$  **chạm số không** — tức ở  $n = 22$  tầng 1 **chưa được xác lập trên mô hình mà nhóm thực sự dùng** (§5.2.1). Phát biểu “front-end quan trọng hơn kiến trúc” từ nay chỉ được nói trong phạm vi bộ học cửa sổ 300 ms. Cụm từ “phản bác cả một dòng công trình” đã bị gỡ — đề tài này **tiếp nối**, không phản bác.

### C3 — đã chạy prototype; nửa khẳng định, nửa phủ định, và cơ chế không mới.

Phần *cổng từ chối* có tác dụng thật: +7,49 điểm F1 ở độ phủ 80% trên CinC 2013 so với từ chối ngẫu nhiên (KTC 95% cụm  $[+2,94; +11,54]$ ), và bản demo bắt đúng hai bản ghi tệ nhất mà không bỏ lọt bản ghi tốt nào. Nhưng: **(a)** cơ chế từ chối cho fECG **đã có chủ** — Andreotti và cộng sự 2017 (fSQI), Shi 2023, Baldazzi 2023. Điểm mới còn lại là *đánh giá xuyên hệ ghi, zero-shot*. **(b)** AUROC 0,929 phần lớn là hiệu ứng *giữa* bản ghi; AUROC *trong* bản ghi — đại lượng thật sự cần cho lâm sàng — chỉ là **0,721**  $[0,517; 0,898]$  (§10). **(c)** Phần *đồng điều bền vững* thất bại có kiểm soát: AUROC 0,566. Nhóm rút phần topo, giữ phần cổng, và công bố kết quả phủ định nguyên trạng — giả thuyết  $H_0$  đã dự phòng cho đúng tình huống này.

### C1 — yếu hơn nhóm tương, nhưng bản 3.3 đã gia cố một phần.

Kho mad-lab-fau/fecg-benchmarking đi kèm Power-MF đã tồn tại và đã làm một phần việc đối chuẩn. Định vị đúng của C1: không phải “đối chuẩn đầu tiên” mà là “đối chuẩn **giữa các họ biểu diễn** ở cấu hình **đơn kênh** với quy tắc chọn kênh **mù nhãn** đăng ký trước”. Gia cố mới của bản 3.4: Power-MF **đã được chạy lại thật ở cả hai cấu hình** — bốn đạo trình như bài gốc, và một đạo trình do nhóm tự cài lại — rồi chấm bằng cùng bộ chấm (§5.7). C1 không còn dựa vào con số trích từ y văn, và bản chạy lại tái lập số công bố của tác giả đến **0,06 điểm**. Kết quả: **không phân biệt được** với bản đa kênh ( $-1,27$  điểm; KTC 95%  $[-3,08; +0,27]$ ; trung vị  $+0,23$ ; thắng 18/22), và **hơn hẳn** bản đơn kênh ( $+10,85$  điểm; 22/22). *Ranh giới:* trên trung bình toàn tập nhóm vẫn thua 1,27 điểm, và ba bản ghi thua nặng là ba bản ghi mà *mọi* phương pháp đơn kênh đều hỏng.

## 12.2. Nhóm đã đoán sai nguyên nhân hai lần trong một ngày

Mục này nhóm đưa vào không phải để tự trách. Nó ở đây vì nó là bằng chứng kiểm tra được rằng những con số còn lại trong đề cương đã đi qua một quy trình biết tự bắt lỗi. Một đề cương không có mục này thì người đọc chỉ có thể *tin*; có mục này thì người đọc *kiểm tra* được.

Ngày 12/09/2026, trong khoảng mười hai tiếng, nhóm phát biểu hai nguyên nhân trước khi đo được chúng. Cả hai lần đều sai, và cả hai lần cái sai đều đi theo hướng **có lợi cho câu chuyện nhóm muốn kể**. Đó là điều đáng lo nhất.

### 12.2.1. Lần một — “Power-MF hỏng vì tham số 340 ms quá sát”

**Quan sát:** Power-MF chạy lại hỏng trên 6 trên 10 bản ghi Silesia B1. Hai bản cho Se  $\approx 50\%$  với PPV  $\approx 99,7\%$ ; bốn bản trả về rỗng.

**Nhóm đoán:** ms\_minpeakdistance = 340 ms quá sát khoảng RR của thai 155 nhịp/phút, nên bộ dò bỏ mất một nhịp trên hai. Giả thuyết này *nghe rất đúng*: chữ ký Se  $\approx 50\%$  với PPV gần 100% đúng là chữ ký kinh điển của bắt cách nhịp, và nhịp tim thai thì thật sự nhanh.

**Đo thật:** nhóm đo phân bố RR từ nhãn tham chiếu của từng bản ghi (baselines/powermf\_rr\_diag.json). Trên B1\_01, tỉ lệ khoảng RR ngắn hơn 340 ms là **0,00%**. Trên cả 27 bản ghi đã kiểm tra, giá trị lớn nhất là 0,15%. Ràng buộc 340 ms chưa từng chặn một nhịp thật nào. **Giả thuyết sai.**

**Nguyên nhân thật:** findpeaks của gói signal trong Octave cài MinPeakDistance bằng một ma trận khoảng cách đôi một,  $O(k^2)$  bộ nhớ, và tràn trên bản ghi 2.395.600 mẫu. Lỗi bị try/catch nội bộ nuốt. MATLAB dùng thuật toán tham  $O(k \log k)$  nên không bao giờ gặp. Se  $\approx 50\%$  không phải bắt cách nhịp — đó là **mất đúng nửa sau của bản ghi** (§5.7).

**Nếu nhóm không đo:** nhóm sẽ tăng tham số cho Power-MF chạy được. Power-MF khi đó đạt khoảng 94,87 và mô hình của nhóm “thắng” +2,74 điểm. Một kết quả đẹp, đăng được, và **sai hoàn toàn**: baseline đã bị nhóm sửa tham số nên không còn đối chiếu được với bài gốc. Sau khi vá đúng, Power-MF đạt 98,83 và nhóm *thua* 1,27 điểm.

### 12.2.2. Lần hai — “quy tắc kênh 0 cố định tốt hơn quy tắc PSD”

**Quan sát:** trên mẫu 10 bản ghi CinC 2013, quy tắc chọn kênh theo mật độ phổ công suất chỉ cho 69,31, trong khi lấy cố định kênh 0 cho **90,34**.

**Nhóm đoán:** quy tắc PSD không hợp với hệ ghi CinC, và kênh 0 của tập này tình cờ là kênh tốt. Bản 3.2 đưa 90,34 lên làm con số chính — con số đó nay **đã bị rút**.

**Đo thật:** chạy **toàn bộ 75 bản ghi** set-a (benchmark\_dpss/eval\_cinc75.json). Quy tắc kênh 0 rơi xuống **69,33**, trong khi quy tắc PSD mù nhãn đạt **79,40** (cả hai số này tính trên 75 bản, đã rút ở bản 3.5; trên 60 bản sạch: kênh 0 = 61,78, PSD = 74,28 — kết luận định tính giữ nguyên). Kênh 0 hoá ra là quy tắc **tệ nhất trong bốn quy tắc**, kém quy tắc PSD hơn 10 điểm. **Giả thuyết sai.**



**Bảng 62:** Bốn quy tắc chọn kênh, mô hình 22 ca, trên mẫu 10 bản ghi so với toàn bộ 75 bản ghi. **Cột “mẫu 10 bản ghi” (69,31 và 90,34) là các con số ĐÃ BỊ RÚT**, giữ lại chỉ để đối chiếu. Nguồn: benchmark\_dpss/eval\_cinc75.json.

| Quy tắc chọn kênh                       | Mẫu 10 bản ghi (đã rút) | Toàn bộ 75 bản ghi | Lệch   |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| PSD mù nhãn (số chính)                  | <b>69,31</b>            | <b>79,40</b>       | −10,09 |
| Kênh 0 cố định (hậu kiểm)               | <b>90,34</b>            | <b>69,33</b>       | +21,01 |
| Trung bình 4 kênh                       | —                       | 74,09              | —      |
| Oracle (kênh tốt nhất, không dùng được) | —                       | 86,87              | —      |

**Nguyên nhân thật:** “kênh 0” được chọn *sau khi* nhóm nhìn thấy quy tắc PSD thất bại trên đúng 10 bản ghi đó. Đó là một siêu tham số đã khớp vào chính tập đánh giá. Dem ra 65 bản ghi chưa thấy, nó rơi 21 điểm.

**Nếu nhóm không đo:** 90,34 sẽ đứng trong bài báo, kèm kết luận “không còn bản ghi nào dưới 50”. Trên 75 bản ghi, vẫn còn **16 bản dưới 50**. Đó sẽ là một tuyên bố sai về chính điểm yếu lớn nhất của đề tài.

#### Điểm chung của hai lần đoán sai — và nguyên tắc nhóm rút ra

Cả hai lần, giả thuyết sai đều **nghe hợp lý, khớp với dữ liệu nhóm đang nhìn, và có lợi cho nhóm**. Lần một cho nhóm một chiến thắng +2,74 điểm; lần hai cho nhóm một con số 90,34 đẹp hơn 79,40. Không lần nào nhóm cố ý gian lận — và đó chính là lý do nó nguy hiểm.

Điểm chung thứ hai: cả hai lần, dữ liệu để bác bỏ đều **đã nằm sẵn trên đĩa**. RR thật nằm trong nhãn tham chiếu; 65 bản ghi CinC còn lại nằm trong cùng thư mục. Nhóm không cần thêm dữ liệu, chỉ cần chịu đo.

**Ba nguyên tắc nhóm áp dụng từ đây:**

1. **Không phát biểu nguyên nhân trước khi đo được nguyên nhân.** Một bản ghi hỏng thì đọc *log* của chính nó, không suy diễn từ tham số.
2. **Ngghi ngờ mạnh nhất với giả thuyết có lợi cho mình.** Nếu một cách giải thích làm con số của nhóm đẹp lên, đó là giả thuyết phải đo trước, không phải giả thuyết được tin trước.
3. **Không bao giờ chốt số trên tập con của một tập có sẵn đầy đủ.** Nếu có 75 bản ghi thì chạy 75. Mẫu 10 bản ghi đã lệch, và lệch theo *hai hướng ngược nhau* tùy quy tắc.

Nhóm giữ mục này trong bản nộp hội đồng. Lý do thẳng thắn: một phản biện Q1 sẽ tìm đúng loại lỗi này, và tốt hơn là họ thấy nhóm đã tự tìm ra, tự đo, và tự rút — kèm con số đúng và mã chạy lại được — thay vì họ tự phát hiện. Mục này làm đề cương **đáng tin hơn**, không làm

nó yếu đi. Nó cũng là lý do nhóm dám đề nguyên ba bản ghi thua nặng trong §5.7 thay vì loại chúng ra.

12.3. Kiến trúc nhóm đã cân nhắc và loại

Để phòng câu hỏi “sao không dùng kiến trúc mới nhất”, nhóm đã rà soát các họ kiến trúc 2024–2026.

Bảng 63: Các họ kiến trúc mới được cân nhắc và lý do loại.

| Họ kiến trúc                                  | Quyết định   | Lý do                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiền huấn luyện tự giám sát kiểu wav2vec      | Nên thử      | Nhóm chỉ có 5 chủ thể có nhãn, trong khi có sẵn kho tín hiệu ổ bụng không nhãn lớn. Đây là lý do đáng tin duy nhất |
| Mamba, S4, S6 (mô hình không gian trạng thái) | Loại         | Ưu thế của chúng là chuỗi rất dài. Ở đây chuỗi chỉ 1.000 mẫu và quét trường tiếp nhận đã bão hoà ở 1,5 giây        |
| KAN, RetNet, xLSTM, PatchTST                  | Loại         | Không tìm thấy căn cứ nào cho tín hiệu 4 giây ở 250 Hz                                                             |
| Neural ODE                                    | Loại         | Chi phí lớn, không có lợi thế rõ cho bài toán định vị đỉnh                                                         |
| Transformer                                   | Đã thử, loại | Chậm gấp 21,7 lần cnn_di1 để đổi lấy 0,25 điểm                                                                     |

Ranh giới của khẳng định trên

Nhóm **không tìm thấy** công trình nào áp dụng Mamba cho dò QRS thai từ điện tim ổ bụng. “Không tìm thấy” khác với “không tồn tại”. Nếu muốn khẳng định trong bài báo, nhóm phải tự chạy thí nghiệm loại bỏ, chứ không được trích dẫn suy luận.

# 13. Kế hoạch triển khai 24 tuần

## 13.1. Mười hai giai đoạn

**Bảng 64:** Kế hoạch 12 giai đoạn trong 24 tuần, kèm hai công quyết định.

| Mã                                                                                                                              | Tuần  | Nội dung                                                                                              | Sản phẩm              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P0                                                                                                                              | 1–2   | Bổ sung dữ liệu: Silesia B1/B2, FECGSYNDB, NInFEA. Viết thẻ dữ liệu và quy trình chống rò rỉ bốn tầng | Kho dữ liệu có mã băm |
| P1                                                                                                                              | 3–4   | Chạy lại bảng kiến trúc ở 10–60 Hz, tách bản ghi đầy đủ, ba seed                                      | Bảng kiến trúc đã sửa |
| P2                                                                                                                              | 5–6   | Cài lại bốn baseline cổ điển; chạy lại mã mở Power-MF ở cả hai cấu hình đạo trình                     | Baseline chạy được    |
| P3                                                                                                                              | 7–8   | Tăng cường dữ liệu; huấn luyện lại mô hình chính                                                      | Mô hình v2            |
| <b>Cổng 1 (tuần 8):</b> nếu chưa đạt $F1 \geq 95\%$ với $n \geq 15$ chủ thể thì dùng mở rộng, tập trung viết C1 + C2            |       |                                                                                                       |                       |
| P4                                                                                                                              | 9–11  | Cài đặt đặc trưng đồng điều bền vững cho đánh giá chất lượng                                          | Thư viện fSQI         |
| P5                                                                                                                              | 12–13 | So fSQI topo với SampEn, bSQI, kurtosis, entropy phổ                                                  | Bảng tương quan       |
| P6                                                                                                                              | 14–16 | Cổng từ chối trả lời; đường cong rủi ro–độ phủ                                                        | Kết quả C3            |
| <b>Cổng 2 (tuần 16):</b> nếu fSQI không đạt $ \rho  \geq 0,6$ thì công bố kết quả phủ định có kiểm định, vẫn đủ cho một bài báo |       |                                                                                                       |                       |
| P7                                                                                                                              | 17–18 | Tiền huấn luyện FECGSYNDB rời tinh chỉnh (E7)                                                         | Kết quả chuyển miền   |
| P8                                                                                                                              | 19–20 | Đường cong F1–SNR, đường cong hiệu quả mẫu, kiểm định thống kê đầy đủ                                 | Bộ hình cho bài báo   |
| P9                                                                                                                              | 21    | Đóng gói: API, bảng điều khiển, Docker                                                                | Sản phẩm chạy được    |
| P10                                                                                                                             | 22–23 | Viết bài hội nghị 4 trang và bản thảo tạp chí                                                         | Hai bản thảo          |
| P11                                                                                                                             | 24    | Hoàn thiện, nộp, báo cáo Euréka                                                                       | Hồ sơ nộp             |

**Những phase đã được kéo lên làm sớm trong đợt thực thi ngày 10–11/09/2026**

- **P0** một phần: Silesia đã tải, kiểm tra rò rỉ, đánh giá zero-shot (§5.8). Còn FECGSYNDB và NInFEA.
- **P1** phần lớn: 8 kiến trúc chạy lại đúng giao thức (§4). Còn ba seed và ba kiến trúc nặng.
- **P2 xong hoàn toàn** (12/09): ba baseline cổ điển (§5.6), Power-MF **4 đạo trình** chạy lại qua GNU Octave sau bảy bản vá, và Power-MF **1 đạo trình** tự cài lại bằng Python —

cả ba chấm bằng cùng bộ chấm (§5.7).

- **P4–P6** prototype xong với kết quả phủ định cho topo và khẳng định cho cổng từ chối (§7). Việc còn lại: thay luật cứng trong demo bằng bộ phân loại cổ điển, và thay luật khoá mẹ ngưỡng 60 % bằng mức vượt phân phối rộng (§9).
- **P8** phần lớn: đường cong F1–SNR với nhiễu MIT-BIH (§5.9), đường cong hiệu quả mẫu (§5.10), **kiểm định thống kê đầy đủ ở mức chủ thể** (§10), và **đánh giá CinC 2013 trên toàn bộ 75 bản ghi** (§5.10.3) xong. Còn ba seed cho bảng kiến trúc.
- **P9** phần lớn: demo Gradio với đèn học được, API REST, 53 test, CI (§8). Docker đã viết chưa build.
- **P10** bản nháp: bài Computing in Cardiology 4 trang đã viết và qua một vòng phản biện đối kháng nội bộ. **Bản thảo đó nay phải sửa lại**: nó chứa các con số CinC trên mẫu 10 bản ghi và các trị số  $p$  giả lập đã bị gỡ ở bản 3.3.
- **P3** xong: huấn luyện lại trên 22 sản phụ, 11 fold theo nhóm, có tăng cường dữ liệu; 12 checkpoint, **cộng một bộ đầy đủ ở seed 1** để đo độ ổn định (§5.10). Còn: đo riêng đóng góp của tăng cường; hiệu chuẩn lại công tin cậy cho mô hình 22 ca.
- **Mới, ngoài kế hoạch**: bộ chỉ số lâm sàng trên 32 bản ghi / 269,6 phút (§9) — không nằm trong 12 giai đoạn ban đầu, nhưng là mục mà hội đồng và phản biện Q1 sẽ hỏi trước tiên.

Chưa động tới: P7 (tiền huấn luyện FECGSYNDB, cần 40 GB — sau khi thấy 16/75 bản ghi CinC vẫn dưới 50, mục này **trở lại thành ưu tiên** chứ không còn “có thể không cần thiết” như bản 3.2 viết), P11 (nộp bài).

## 13.2. Phân vai ba sinh viên

**Bảng 65:** Phân vai và trách nhiệm chính.

| Vai              | Trách nhiệm chính                                 | Giai đoạn phụ trách |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Chủ nhiệm đề tài | Kiến trúc mô hình, huấn luyện, thống kê, viết bài | P1, P3, P8, P10     |
| Thành viên 2     | Dữ liệu, chống rò rỉ, baseline, tái lập           | P0, P2, P7          |
| Thành viên 3     | Đặc trưng topo, fSQI, cổng từ chối, đóng gói      | P4, P5, P6, P9      |

## 14. Sản phẩm và công bố

### 14.1. Sản phẩm bàn giao

**Bảng 66:** Danh mục sản phẩm, kèm trạng thái hiện tại.

| Sản phẩm                            | Mô tả                                                                          | Trạng thái      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Thư viện <code>fqrs_model.py</code> | Cài đặt tham chiếu đầy đủ pipeline                                             | <b>Đã có</b>    |
| Sáu checkpoint mô hình 5 ca         | Năm mô hình tách bản ghi + một mô hình sản xuất                                | <b>Đã có</b>    |
| Mười hai checkpoint mô hình 22 ca   | Mười một fold theo nhóm + một mô hình sản xuất, có tăng cường                  | <b>Đã có</b>    |
| Công cụ tải dữ liệu                 | Tải trực tiếp từ PhysioNet, ghi mã băm SHA-256                                 | <b>Đã có</b>    |
| Công cụ suy luận dòng lệnh          | Hỗ trợ EDF, WFDB, CSV, NPY                                                     | <b>Đã có</b>    |
| Bộ mã đối chuẩn                     | Chạy đúng giao thức, kiểm chứng chéo Hungarian                                 | <b>Đã có</b>    |
| Ba baseline cổ điển                 | TS, TS-PCA, Prominence; cùng giao thức, Wilcoxon                               | <b>Đã có</b>    |
| Thư viện <code>fSQI</code>          | 28 đặc trưng topo và cổ điển, có kiểm thử tự đối chiếu                         | <b>Đã có</b>    |
| Cổng từ chối trả lời                | Đường cong rủi ro–độ phủ, đối chứng ngẫu nhiên và oracle                       | <b>Đã có</b>    |
| Bản demo web                        | Gradio, năm tầng tín hiệu, đèn tín cạy hai chế độ, kiểm thử ba tầng            | <b>Đã có</b>    |
| Cổng tin cạy học được               | GBM trên 12 chỉ số, hiệu chuẩn chỉ trên ADFECGDB, 0 lỗi nguy hiểm / 32 bản ghi | <b>Đã có</b>    |
| API REST                            | FastAPI, ba điểm cuối, kiểm thử bằng dịch vụ thật                              | <b>Đã có</b>    |
| Đóng gói Docker                     | Dockerfile và compose đã viết; chưa build vì máy không có Docker engine        | Một phần        |
| Đường cong F1–SNR                   | 4 loại nhiễu MIT-BIH $\times$ 6 mức, mô hình và TS-PCA                         | <b>Đã có</b>    |
| Bản thảo Computing in Cardiology    | 4 trang, hai cột, 12 tài liệu, đã qua phản biện đối kháng                      | <b>Bản nháp</b> |
| Bộ kiểm thử                         | 53 test, CI hai phiên bản Python                                               | <b>Đã có</b>    |

### 14.2. Kế hoạch công bố

- Hội nghị Computing in Cardiology** (4 trang, hạn tháng 4): trình bày C2, phân rã đóng góp ba tầng. Đây là kết quả đã có, viết được ngay sau Phase P1.
- Tạp chí** — *IEEE JBHI* hoặc *Biomedical Signal Processing and Control* (Q1 Scimago)

nếu có được bộ dữ liệu thứ ba có nhãn thật để xác nhận quy tắc chọn kênh; nếu không, *Physiological Measurement* (sân nhà của fECG, nhưng là **Q2/Q3 Scimago 2024, không phải Q1** như bản 3.4 ghi): bài đầy đủ gồm C1, C2, C3.

3. **Báo cáo Eureka:** bản tiếng Việt, nhấn mạnh sản phẩm chạy được và giá trị ứng dụng.

#### Vì sao đề tài có cửa Q1

Bốn lý do, xếp theo độ vững — và mỗi lý do kèm ranh giới của nó:

1. **Phân rã ba tầng trong một thí nghiệm duy nhất (C2)**, trên dữ liệu thật, ở mức chủ thể. Chưa ai làm điều này trong fECG. *Ranh giới:* luận điểm định tính đã có từ Andreotti 2016; nhóm thêm con số, không thêm ý tưởng.
2. **Liên chính phương pháp có thể kiểm tra được.** Bản 3.3 tự rút bốn phát biểu của bản 3.2, mỗi lần kèm con số đúng và mã chạy lại được. Một phản biện Q1 khó tìm ra lỗi mà nhóm chưa tự nêu. *Ranh giới:* điều này làm bài báo đáng tin, không làm nó mới.
3. **Một đối chuẩn công bằng thật, và một câu hỏi đo được (C1):** Power-MF chạy lại trên cùng máy, cùng bộ chắm, ở **cả hai cấu hình đạo trình**. Điều đó cho phép nhóm hỏi một câu mà chưa ai hỏi bằng số trong fECG: *một mạng đơn kênh lấy lại được bao nhiêu phần lợi ích của tách nguồn đa kênh?* Đáp số: tách nguồn đa kênh đáng 12,12 điểm F1 cho chính Power-MF, mạng đơn kênh lấy lại 10,85 điểm, tức **89,5 %** (§5.7.6). *Ranh giới:* so với Power-MF đa kênh đầy đủ thì đây là **hoà**, không phải thắng — và tỉ số 89,5 % chưa có khoảng tin cậy.
4. **Một cổng từ chối đã đo được** cho C3: +7,49 điểm F1 ở độ phủ 80% ngoài miền, kèm một kết quả phủ định có kiểm soát về TDA. *Ranh giới:* cơ chế không mới (Andreotti 2017), và AUROC trong bản ghi chỉ 0,721.

Và kể cả khi C3 thất bại, giả thuyết  $H_0$  đã dự phòng: đối chuẩn cộng phân rã cộng kết quả phủ định có kiểm định vẫn là một bài báo hoàn chỉnh.

**Điều nhóm KHÔNG còn nói:** “front-end quan trọng hơn kiến trúc 27 lần” — tỉ số đó lấy từ 0,41 điểm, một con số nay đã được thay bằng khoảng  $-2,95$  đến  $+0,73$  điểm mà nghiên cứu không đủ lực để thu hẹp. Tỉ số “bao nhiêu lần” không tính được từ dữ liệu này.

## 15. Tài liệu tham khảo

Ba mươi công trình dưới đây nhóm đã đọc **toàn văn**, không dừng ở tóm tắt. Bản PDF được lưu trong thư mục papers/ kèm tệp papers\_records.json ghi nguồn tải và mức truy cập của từng bài.

- [1] Zhong W, Liao L, Guo X, Wang G. "A deep learning approach for fetal QRS complex detection." *Physiological Measurement* (IOP Publishing / IPEM), vol. 39, no. 4, art. 045004, 9 trang, 2018. DOI: 10.1088/1361-6579/aab297. Nhan bai 15/12/2017, sua 22/02/2018, chap nhan 27/02/2018, xuất ban 20/04/2018. Sun Yat-sen University, Guangzhou, Trung... (p01)
- [2] Mohebbian MR, Vedaiei SS, Wahid KA, Dinh A, Marateb HR, Tavakolian K. "Fetal ECG Extraction From Maternal ECG Using Attention-Based CycleGAN." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)*, vol. 26, no. 2, pp. 515-526, 2022. DOI: 10.1109/JBHI.2021.3111873. University of Saskatchewan (Canada), University of Isfahan (Iran), UPC... (p03)
- [3] Basak P, Sakib AHMN, Chowdhury MEH, Al-Emadi N, Yalcin HC, Pedersen S, Mahmud S, Kiranyaz S, Al-Maadeed S. "A novel deep learning technique for morphology preserved fetal ECG extraction using 1D-CycleGAN." *Expert Systems with Applications* (Elsevier), vol. 235, art. 121196, 2024. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.121196. University of Dhaka... (p04)
- [4] Arash Shokouhmand, Negar Tavassolian, "Fetal Electrocardiogram Extraction Using Dual-Path Source Separation of Single-Channel Non-Invasive Abdominal Recordings", *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 70, no. 1, pp. 283-295, January 2023. DOI: 10.1109/TBME.2022.3189617. (Nhan 09/05/2022, chỉnh sửa 18/06/2022, chap nhan... (p05)
- [5] Lin Chen, Shuicai Wu, Zhuhuang Zhou, "Fetal ECG Signal Extraction from Maternal Abdominal ECG Signals Using Attention R2W-Net", *Sensors*, vol. 25, no. 3, art. no. 601, 2025. DOI: 10.3390/s25030601. (MDPI, open access CC BY. Nhan 22/10/2024, chỉnh sửa 18/01/2025, chap nhan 19/01/2025, xuất ban 21/01/2025. College of Chemistry and Life... (p06)
- [6] Amirreza Asadi, Aboozar Ghaffari, Zahra Hatami, "U-Net-Based Deep Learning Framework for Single-Channel Fetal ECG Extraction Using Time-Delay Representation", *IEEE Access*, vol. 13, pp. 206367-206379+ (bai dai 14 trang), 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3639272. (Nhan 05/11/2025, chap nhan 26/11/2025, xuất ban 03/12/2025. Biomedical... (p07)
- [7] Xu, Xiaojian; Zhang, Yifan; Rao, Yufei; Xu, Yinru; Gao, Yang; Tu, Huating. "A Deep Learning-Guided Ensemble Empirical Mode Decomposition Method for Single-Channel Fetal Electrocardiogram Extraction." *Sensors* (MDPI), 2026, tap 26, so 7, bai so 2037. DOI: 10.3390/s26072037. Nhan bai 29/01/2026, chap nhan 23/03/2026, xuất ban 25/03/2026.... (p09)
- [8] Esmacili Alidash, Kimia; Danandeh Hesar, Hamed. "Deep learning-based approach for accurate detection of fetal QRS complexes in abdominal ECG signals." *Scientific Reports* (Nature Portfolio),

- 2025, tap 15, bai so 39260. DOI: 10.1038/s41598-025-22999-9. Department of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.... (p10)
- [9] Orvas, Iulia; Radu, Andrei; Galli, Alessandra; Neacsu, Ana; Peri, Elisabetta. "A Complex UNet Approach for Non-Invasive Fetal ECG Extraction Using Single-Channel Dry Textile Electrodes." Preprint arXiv:2506.22457v1 [eess.SP], 16/06/2025, ghi ro "preprint submitted to IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics". Don vi: SIGMA... (p11)
- [10] Wahbah M, Zitouni MS, Al Sakaji R, Funamoto K, Widadalla N, Krishnan A, Kimura Y, Khandoker AH (2024). "A deep learning framework for noninvasive fetal ECG signal extraction." *Frontiers in Physiology*, 15:1329313. DOI: 10.3389/fphys.2024.1329313. Nhan 28/10/2023, chap nhan 22/03/2024, xuất ban 22/04/2024. Giay phep CC BY. File PDF 13... (p12)
- [11] Behar J (2014). "Extraction of Clinical Information from the Non-Invasive Fetal Electrocardiogram." Luan an Tien si (DPhil), Balliol College, University of Oxford. Nguoi huong dan: Prof. Gari D. Clifford (dong huong dan: Dr Julien Oster). Michaelmas 2014, 249 trang. LUU Y VE TRICH DAN: ten file trong repo ghi "arxiv" va (o ban p14) ghi... (p13)
- [12] Behar J (2014), Chuong 7 "Fetal QRS detection with no maternal chest reference", trang 114-137 trong luan an Tien si "Extraction of Clinical Information from the Non-Invasive Fetal Electrocardiogram", Balliol College, University of Oxford, Michaelmas 2014. Ban tap chi tuong ung (ghi trong danh muc cong bo cua chinh luan an, muc [9]... (p14)
- [13] Andreotti, Fernando; Behar, Joachim; Zaunseder, Sebastian; Oster, Julien; Clifford, Gari D. "An open-source framework for stress-testing non-invasive foetal ECG extraction algorithms." *Physiological Measurement*, tap 37, so 5, nam 2016, trang 627-648. DOI: 10.1088/0967-3334/37/5/627. (Ban PDF trong thu muc la ban luu tru CC BY-NC-ND 4.0... (p15)
- [14] Niknazar, Mohammad; Rivet, Bertrand; Jutten, Christian. "Fetal ECG Extraction by Extended State Kalman Filtering Based on Single-Channel Recordings." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, tap 60, so 5, nam 2013, trang 1345-1352. DOI: 10.1109/TBME.2012.2234456. (Ban PDF trong thu muc la ban luu tru HAL, ma hal-00831928.) (p16)
- [15] Castillo, Encarnacion; Morales, Diego P.; Garcia, Antonio; Parrilla, Luis; Ruiz, Victor U.; Alvarez-Bermejo, Jose A. "A clustering-based method for single-channel fetal heart rate monitoring." *PLoS ONE*, tap 13, so 6, nam 2018, bai e0199308, 22 trang. DOI: 10.1371/journal.pone.0199308. Nhan 06/06/2017, chap nhan 05/06/2018, dang... (p17)
- [16] Eleonora Sulas, Monica Urru, Roberto Tumbarello, Luigi Raffo, Danilo Pani. "Systematic analysis of single- and multi-reference adaptive filters for non-invasive fetal electrocardiography". *Mathematical Biosciences and Engineering (MBE)*, Volume 17, Issue 1, trang 286-308, 2020. DOI: 10.3934/mbe.2020016. Nhan bai 10/06/2019, chap nhan... (p19)



- [17] Gari D. Clifford, Ikaro Silva, Joachim Behar, George B. Moody. "Non-invasive fetal ECG analysis" (tieu de trong metadata ghi la "Noninvasive Fetal ECG analysis"). *Physiological Measurement*, Volume 35, Issue 8, trang 1521-1536, 2014. DOI: 10.1088/0967-3334/35/8/1521. Day la bai xa luan (editorial) mo dau so dac biet ve cuoc thi... (p20)
- [18] Adam Matonia, Janusz Jezewski, Tomasz Kupka, Michal Jezewski, Krzysztof Horoba, Janusz Wrobel, Robert Czabanski, Radana Kahankova. "Fetal electrocardiograms, direct and abdominal with reference heartbeat annotations". *Scientific Data (Nature)*, volume 7, so bai 200, nam 2020. DOI: 10.1038/s41597-020-0538-z. Nhan bai 22/11/2019, chap nhan... (p21)
- [19] Jose A. Perea, John Harer. "Sliding Windows and Persistence: An Application of Topological Methods to Signal Analysis". File PDF trong thu muc la BAN TIEN AN arXiv:1307.6188v2 [math.AT], nop 25/11/2013, ghi ngay 22/11/2013, 34 trang; PDF KHONG ghi ten tap chi va KHONG co DOI. Ban xuất bản chính thức (trich duoc tu danh muc tham khao cua... (p22)
- [20] Henry Adams, Tegan Emerson, Michael Kirby, Rachel Neville, Chris Peterson, Patrick Shipman, Sofya Chepushtanova, Eric Hanson, Francis Motta, Lori Ziegelmeier. "Persistence Images: A Stable Vector Representation of Persistent Homology". *Journal of Machine Learning Research* 18 (2017) 1-35. Nop 7/2016, xuất bản 2/2017. Bien tap vien:... (p23)
- [21] Mathieu Carriere, Frederic Chazal, Yuichi Ike, Theo Lacombe, Martin Royer, Yuhei Umeda. "PersLay: A Neural Network Layer for Persistence Diagrams and New Graph Topological Signatures". *Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2020, Palermo, Italy. PMLR Volume 108*. Ban quyên... (p24)
- [22] Anirudh Som, Hongjun Choi, Karthikeyan Natesan Ramamurthy, Matthew P. Buman, Pavan Turaga. "PI-Net: A Deep Learning Approach to Extract Topological Persistence Images". Metadata của file PDF ghi subject = "IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops" (CVPRW), nam 2020. Ma nguôn:... (p25)
- [23] Renata Turkes (University of Antwerp), Guido Montufar (UCLA), Nina Otter (Queen Mary University of London). "On the Effectiveness of Persistent Homology". arXiv:2206.10551v3 [math.AT], ban v3 ngay 16 thang 1 nam 2023 (ban PDF day du kem phu luc, 39 trang). Ban rut gon 17 trang trong cung thu muc (p26\_Turkes2022-EffectivenessPH.pdf) co... (p26)
- [24] Quoc Hoan Tran, Yoshihiko Hasegawa (Department of Information and Communication Engineering, Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo). "Topological time-series analysis with delay-variant embedding". arXiv:1803.00208v4 [physics.data-an], ban v4 ghi ngay 10-11 thang 1 nam 2019. Ma nguôn:... (p27)
- [25] Eugene Tan, Shannon Algar, Débora Corrêa, Michael Small, Thomas Stemler, David Walker. "Selecting embedding delays: An overview of embedding techniques and a new method using persistent homology." arXiv:2302.03447v1 [math.DS], nộp 7-2-2023, trang đầu ghi ngày 8-2-2023. Complex Systems Group, Department of Mathematics and Statistics, The... (p28)

- [26] Yonglian Ren, Feifei Liu, Shengxiang Xia, Shuhua Shi, Lei Chen, Ziyu Wang. "Dynamic ECG signal quality evaluation based on persistent homology and GoogLeNet method." *Frontiers in Neuroscience*, tập 17, số bài 1153386, 2023. DOI: 10.3389/fnins.2023.1153386. Nhận 29-1-2023, chấp nhận 20-2-2023, xuất bản 8-3-2023. Đơn vị: School of Science,... (p29)
- [27] Meryll Dindin, Yuhei Umeda, Frédéric Chazal. "Topological Data Analysis for Arrhythmia Detection through Modular Neural Networks." arXiv:1906.05795v1 [cs.LG], 13-6-2019. Đơn vị: École Centrale Paris (Dindin), Fujitsu Nhật Bản (Umeda), INRIA (Chazal). File PDF này KHÔNG ghi DOI và KHÔNG ghi tên hội nghị. LƯU Ý: trong danh mục tài liệu... (p30)
- [28] Yu-Min Chung, Chuan-Shen Hu, Yu-Lun Lo, Hau-Tieng Wu. "A Persistent Homology Approach to Heart Rate Variability Analysis with an Application to Sleep-Wake Classification". Ban trong file la tien an pham arXiv:1908.06856v2 [eess.SP], 02/05/2020, 38 trang. FILE PDF NAY KHONG IN TEN TAP CHI VA KHONG IN DOI. Ban xuất bản chính thức được... (p31)
- [29] Andy Dominguez-Monterroza, Alfonso Mateos Caballero, Antonio Jimenez-Martin (Department of Artificial Intelligence, Universidad Politecnica de Madrid, Tay Ban Nha). "Age-dependent patterns of cardiac complexity unveiled by topological data analysis of pediatric heart rate variability". *PLoS One*. 2025;20(12):e0337620. doi:... (p32)
- [30] Alperen Karan, Atabey Kaygun (Department of Mathematical Engineering, Istanbul Technical University, 34467 Istanbul, Tho Nhi Ky). "Time Series Classification via Topological Data Analysis". arXiv:2102.01956v2 [stat.ML], 11/06/2021, 31 trang. Email: karana@itu.edu.tr, kaygun@itu.edu.tr. FILE PDF NAY KHONG IN TEN TAP CHI VA KHONG IN DOI -... (p33)

### Tài liệu bổ sung phát hiện trong quá trình rà soát

- [31] Jaeger KM, Nissen M, Rahm S, Titzmann A, Fasching PA, Beilner J, Eskofier BM, Leutheuser H. Power-MF: robust fetal QRS detection from non-invasive fetal electrocardiogram recordings. *Physiological Measurement* 45(5):055009, 2024. DOI 10.1088/1361-6579/ad4952. Mã nguồn: [github.com/mad-lab-fau/fecg-benchmarking](https://github.com/mad-lab-fau/fecg-benchmarking). **Đã chạy lại (§5.7).**
- [32] Andreotti F, Behar J, Zaunseder S, Oster J, Clifford GD. An open-source framework for stress-testing non-invasive foetal ECG extraction algorithms. *Physiological Measurement* 37(5):627–648, 2016. DOI 10.1088/0967-3334/37/5/627. **Tiền lệ của luận điểm “tiền xử lý đảo thứ hạng thuật toán”.**
- [33] Andreotti F, Zaunseder S, Malberg H, và cộng sự. Robust fetal ECG quality assessment. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2017. DOI 10.1109/TBME.2017.2675543. **Tiền lệ của cổng từ chối / fSQI cho fECG.**
- [34] Fotiadou E, van Sloun RJG, van Laar JOEH, Vullings R. A dilated inception CNN-LSTM network for fetal heart rate estimation. *Physiological Measurement* 42(4):045007, 2021.

DOI 10.1088/1361-6579/abf7db. **Tiền lệ của việc quét lịch giãn nở / trường tiếp nhận trong fECG.**

- [35] Zahid MU, Kiranyaz S, Ince T, và cộng sự. Robust R-peak detection in low-quality Holter ECGs using 1D convolutional neural network. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 69(1):119–128, 2022. DOI 10.1109/TBME.2021.3088218 (arXiv:2101.01666). **Tiền lệ của đầu ra theo từng mẫu cho dò đỉnh R.**
- [36] Huang và cộng sự. TCGAN: Temporal Convolutional GAN for fetal ECG extraction using single-channel abdominal ECG. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2025. DOI 10.1109/JBHI.2024.3524085. **Đối thủ trực tiếp nhất ở cấu hình đơn kênh.**
- [37] Baldazzi G, Pani D. Open data: valuable resources and opportunities for the researchers in fetal cardiac monitoring. Trong: *Innovative Technologies and Signal Processing in Perinatal Medicine*, Springer, 2023. DOI 10.1007/978-3-031-32625-7\_12. **Đã nêu trước sự trùng lặp ADFECGDB ↔ bộ dữ liệu Matonia.**

**Vì sao bảy tài liệu bổ sung này quan trọng hơn bảy tài liệu thường**

Sáu trong bảy tài liệu trên **làm yếu đi** một tuyên bố của nhóm, chứ không củng cố nó. Nhóm đưa chúng vào đúng vì lý do đó: một phản biện Q1 tìm ra TCGAN hoặc Fotiadou 2021 mà thấy đề tài không trích dẫn sẽ từ chối bài vì khảo sát y văn thiếu. Danh mục đầy đủ và phân tích từng bài ở survey/scout\_novelty.md.

## Phụ lục A — Cách chạy lại toàn bộ kết quả

```
pip install numpy scipy scikit-learn torch mne wfdb
```

```
# 1. Tải dữ liệu trực tiếp từ PhysioNet, ghi mã băm SHA-256
```

```
cd model
```

```
python download_data.py --root data --only adfecgdb
```

```
# 2. Huấn luyện lại toàn bộ (khoảng 30 phút CPU), sinh 6 checkpoint
```

```
python train_final.py --epochs 6 --seed 0
```

```
# 3. Suy luận trên một bản ghi bằng checkpoint chưa từng thấy bản ghi đó
```

```
python predict.py --input data/adfecgdb/r01.edf --lead 1 --annot qrs \
    --checkpoint checkpoints/fetalqrs_tcn_fold_r01.pt
```

```
# 4. Chạy đối chuẩn và quy tắc chọn kênh mù nhãn
```

```
cd ../benchmark_dpss
```

```
python run_dpss_protocol.py --mode loro
```

```
python full_measure.py
```

```
python blind_lead.py
```

## Phụ lục B — Cấu trúc thư mục bàn giao

| Thư mục         | Nội dung                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| model/          | Thư viện tham chiếu, mã huấn luyện, mã suy luận, 6 checkpoint, dữ liệu ADFECGDB |
| pilot_evidence/ | Mã và nhật ký của toàn bộ thí nghiệm tiền khả thi                               |
| benchmark_dpss/ | Mã đối chuẩn, kiểm chứng Hungarian, quy tắc chọn kênh mù nhãn                   |
| papers/         | 30 bản PDF toàn văn và ma trận bằng chứng                                       |
| survey/         | Dữ liệu khảo sát 30 công trình, tệp số liệu đã kiểm chứng                       |
| de_cuong_latex/ | Mã nguồn LaTeX của đề cương này, hình vector, mã sinh bảng                      |

nhóm ghi rõ. Nơi nào bản đề cương trước đó của nhóm phát biểu sai, nhóm nêu rõ chỗ sai và con số đúng (§5, §5.3). Nhóm không tuyên bố “vượt trội” ở những chỗ giao thức không cho phép so sánh trực tiếp.