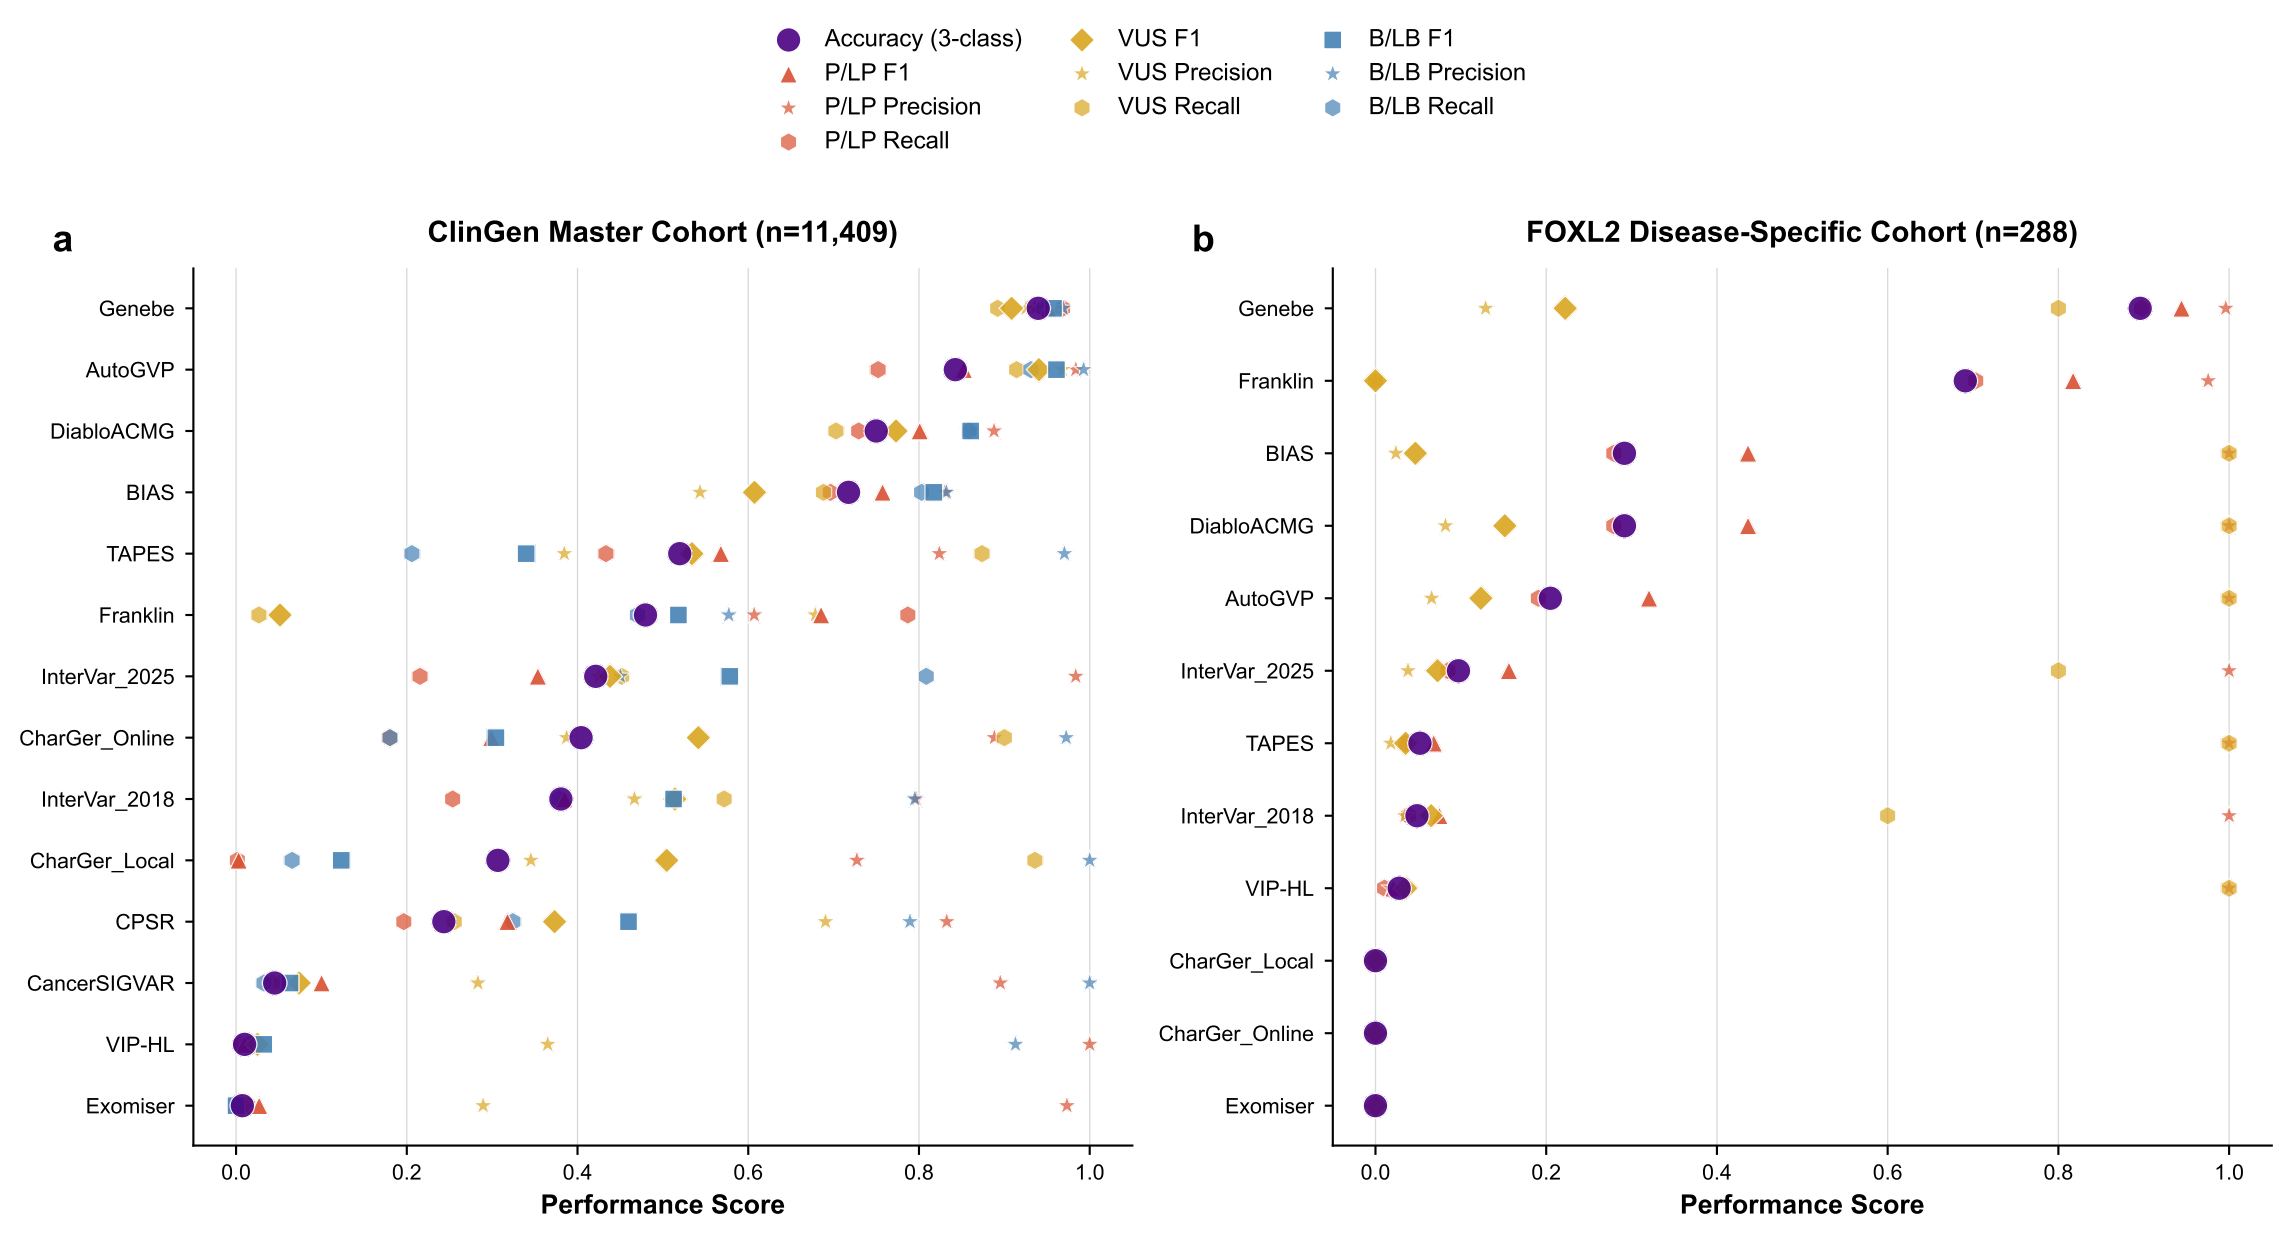
Accuracy (3-class)
P/LP F1
P/LP Precision
P/LP Recall
VUS F1
VUS Precision
VUS Recall
B/LB F1
B/LB Precision
B/LB Recall
a
ClinGen Master Cohort (n=11,409)
Genebe
AutoGVP
DiabloACMG
BIAS
TAPES
Franklin
InterVar_2025
CharGer_Online
InterVar_2018
CharGer_Local
CPSR
CancerSIGVAR
VIP-HL
Exomiser
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Performance Score
b
FOXL2 Disease-Specific Cohort (n=288)
Genebe
Franklin
BIAS
DiabloACMG
AutoGVP
InterVar_2025
TAPES
InterVar_2018
VIP-HL
CharGer_Local
CharGer_Online
Exomiser
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Performance Score