



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 081.18/I-PNJ/IKO/II/2025


Tanggal	17 Februari 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IKO			
Alasan Pengajuan	Penambahan alat baru dan penggantian instrument lama rusak			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1	Orthopedi	13 instrumen	
	2	Bedah dan Obgyn	10 Instrumen	
	3	Urologi	6 Instrumen	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk operasi orthopaedi 2. Untuk Operasi Urologi 3. Untuk Operasi Laparotomy		
3.	Penempatan alat**	Set Obgyn, Set Laparotomy, Set Orthopedi dan Set Urologi		
4.	Merk/Tipe**	Dufner (Terlampir)		
5.	Spesifikasi**	Stainlees		
Yang Mengajukan Kepala Instalasi Kamar Operasi	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
dr. Arief Heru Wicaksono Sp.An	Puput Sekar Nari Ratih AMd.,Keb	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, MMRS	dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN

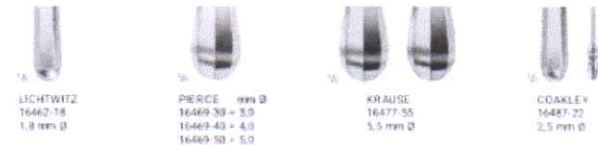


Kieferlichttrokare, Antrum Puncture Trocars, Trocarts pour ponction du seno maxillaire, Trocarts per puntura del seno maxillare

152



Saugrohre
Suction Tubes
Tubos aspiradores
Tubes d'aspiration
Cannule per aspirazione


16

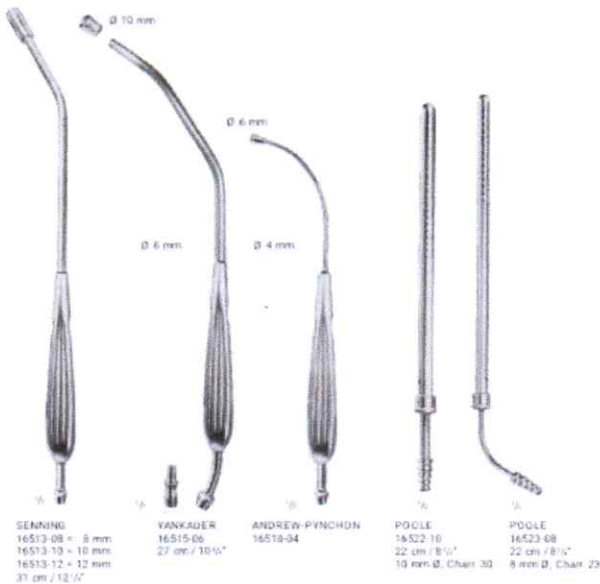

Saugrohre
Suction Tubes
Tubos aspiradores
Tubes d'aspiration
Cannule per aspirazione



Präparier- und Ligaturinstrumente
Dissecting and Ligature Instruments

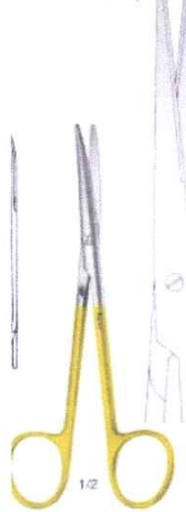

Ligaturschere/scissors
Top dur
04949-14

Speziell zum Schneiden von Nahtmaterial.

Der spezielle Schliff verhindert das Abgleiten des Nahtmaterials von der Schneide.

Die Hartmetallschneide garantiert höchste Standzeit auch bei höchster Belastung.


Die abgerundete Schlußführung verhindert das Einklemmen des Nahtmaterials.

Especially for cutting suture materials.

The special cut avoids slipping out of suture material from the blade.

The tungsten carbide blade guarantees highest standing time, even with highest load.

The rounded end design avoids, that the suture material jams.

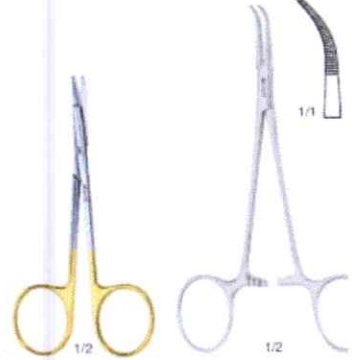

Greenberg Par Top dur
Schere/Scissors, 11.5 cm/4 1/2"
04963-11


Mixer-Baby
08275-01
14 cm / 5 1/2"



Mosquito-Micro
08292-10 = 10 cm / 4"
08292-12 = 12 cm / 4 1/4"




Mosquito-Micro
08293-10 = 10 cm / 4"
08293-12 = 12 cm / 4 1/4"

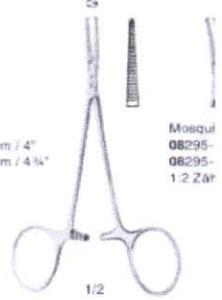

Mosquito
08295-
08295-
1.2 Zähne • Teeth

ICRON® Nadelhalter
verfügbar mit Castro-
Griff, eingesetzt und/
gebogener Spitze

ICRON® Needle
or also available with
rovielo handle, Ryder
and/or curved

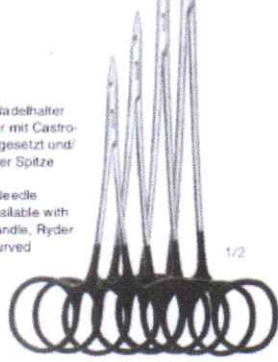

18100-13

DIMICRON Nadelhalter, Maul
gerade, 12.5 cm/5"

DIMICRON †
straight, 12.5

18100-15

DIMICRON Nadelhalter, Maul
gerade, 14.5 cm/5 1/2"

DIMICRON †
straight, 14.5

18100-16

DIMICRON Nadelhalter, Maul
gerade, 16.5 cm/6 1/2"

DIMICRON †
straight, 16.5

18100-18

DIMICRON Nadelhalter, Maul
gerade, 18.5 cm/7 1/2"

DIMICRON †
straight, 18.5

Tidak ada yang lain...



23:46 ▶ ↑

74

< Surgeonious_MIS_product-4-Pe...

22/24

08275-01	08275-02	08275-03	08275-04	08275-05	08275-06	08275-07	08275-08	08275-09	08275-10	08275-11	08275-12	08275-13	08275-14	08275-15	08275-16	08275-17	08275-18	08275-19	08275-20	08275-21	08275-22	08275-23	08275-24	08275-25	08275-26	08275-27	08275-28	08275-29	08275-30	08275-31	08275-32	08275-33	08275-34	08275-35	08275-36	08275-37	08275-38	08275-39	08275-40	08275-41	08275-42	08275-43	08275-44	08275-45	08275-46	08275-47	08275-48	08275-49	08275-50	08275-51	08275-52	08275-53	08275-54	08275-55	08275-56	08275-57	08275-58	08275-59	08275-60	08275-61	08275-62	08275-63	08275-64	08275-65	08275-66	08275-67	08275-68	08275-69	08275-70	08275-71	08275-72	08275-73	08275-74	08275-75	08275-76	08275-77	08275-78	08275-79	08275-80	08275-81	08275-82	08275-83	08275-84	08275-85	08275-86	08275-87	08275-88	08275-89	08275-90	08275-91	08275-92	08275-93	08275-94	08275-95	08275-96	08275-97	08275-98	08275-99	08275-100
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

21

DUFNER
specials and more!

Präparier- und Ligaturinstrumente
Dissecting and Ligature Instruments



Speziell zum Schneiden von
Nahmaterial.

Der spezielle Schliff verhin-
dert das Abgleiten des Nah-
materials von der Schneide.

Die Hartmetallschneide
garantiert höchste Standzeit
auch bei höchster Belastung.


Die abgerundete Schlußaus-
führung verhindert das Ein-
klemmen des Nahmaterials.

Especially for cutting suture
materials.

The special cut avoids slip-
ping out of suture material
from the blade.

The tungsten carbide blade
guarantees highest stand-
ing time, even with highest load.

The rounded end design avoids
that the suture material jams.

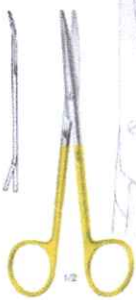


Ligaturschere/scissors
Top dur
04349-14



Greening Pair Top dur
Schere/Scissors, 11.5 cm/4 1/2"
04349-11

Miner-Baby
08275-01
14 cm / 5 1/2"

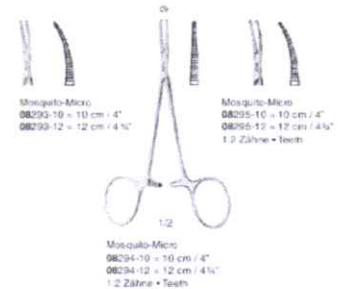

Mosquito-Micro
08292-10 = 10 cm / 4"
08292-12 = 12 cm / 4 1/2"

Mosquito-Micro
08292-10 = 10 cm / 4"
08292-12 = 12 cm / 4 1/2"
1.2 Zähne • Teeth

181000-01	DIMICRON Nadelhalter, Maul gerade, 12.5 cm/5"	DIMICRON Needle holder, jaw straight, 12.5 cm/5"
181000-02	DIMICRON Nadelhalter, Maul gerade, 14.5 cm/5 1/2"	DIMICRON Needle holder, jaw straight, 14.5 cm/5 1/2"
181000-03	DIMICRON Nadelhalter, Maul gerade, 16.5 cm/6 1/2"	DIMICRON Needle holder, jaw straight, 16.5 cm/6 1/2"
181000-04	DIMICRON Nadelhalter, Maul gerade, 18.5 cm/7 1/2"	DIMICRON Needle holder, jaw straight, 18.5 cm/7 1/2"

DIMICRON® Nadelhalter-
auch verfügbar mit Castro-
vajo-Griff, eingeseit und/
oder gebogener Spitze

DIMICRON® Needle
holder also available with
Castrovajo handle, Ryder
style and/or curved



Slideshow

Berbagi

Cari

Rotasi




12

Wundhaken
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori




SENN-GREEN
15 cm / 6"

RAGNELL-DAVIS
12136-14
14 cm / 5 1/2"

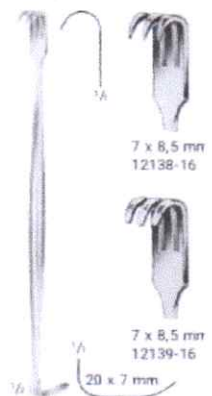

SENN-MILLER
16 cm / 6 1/2"

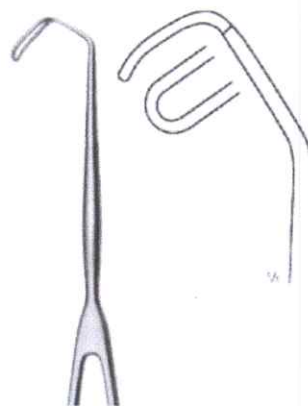

12133-02
20 x 6 mm

12133-01
10 x 6 mm



12138-16
7 x 8.5 mm

12139-16
7 x 8.5 mm

Tidak ada yang lainnya lagi



19:23 ▶ ▶

83

< Surgeonous_MIS_product-4-Pe...

15/24



MICTEC Needle Holder Top der, gerade,
Y-Grip mit Finger-Sperrin, mit Spülschlauch,
Ø 2,0 mm, 240 mm, Arbeitssäge

MICTEC Needle Holder Top der, abgewinkelt,
Y-Grip mit Finger-Sperrin, mit Spülschlauch,
Ø 2,0 mm, 240 mm, Arbeitssäge

als oben, jedoch ohne Sperrin

als abgewinkelt, jedoch ohne Sperrin



Mikro Präparier- und Rekonstruktions Set
Micro Dissection and Reconstruction Set



Spezialinstrumenten-set für Hypoplastie,
Cryptorchismus, Hernienkorrektur oder
als extra feines Set für ästhetische
Chirurgie z.B. feine Lippen, Ohren, Augen
(Blepharoplastik), Hand- und Fuß-
chirurgie

Special Instrument set for Hypoplasia,
Cryptorchismus, hernia correction or for
use in extra delicate cosmetic surgery,
fine lips, ears, eyes (blepharoplasty),
hands and feet

18100-13

DUFNER Mikro Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

bestehend aus:

18100-13

DUFNER Mikro Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

bestehend aus:

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm

04317-03-010

Isolateral Crural Shears Präparier- und Rekonstruk-
tions Set 11 cm



54453-24
24,5 cm / 9"

1/2



1/1



1/1



1/2



1/1

54454-24
22 cm / 8 3/4"



Rotasi



Slideshow



Berbagi



Cari



01A9000


06.378.52

Mikro Adson chirurgische
Pinzette, 1x2 Zähne, 12 cm


Micro Adson tissue forceps,
1x2 teeth, 12 cm



8 mm



10 mm



1/2

LANGENBECK
54467-20
20 cm / 8"





1/2

LANGENBECK
54469-20
20 cm / 8"




NO	NAMA INSTRUMEN	KODE	JUMLAH
	Orthopaedi		
1	Pemotong Wire	52495-22	1
2	Pemotong Wire	52480-25	1
3	Vasgrip		2
4	Elevator	54469-20	2
5	Knabel tang	54799-18	2
6	Kikir	54453-24	1
7	Scapel aple	54279-05	2
8	Elis Klem	08230-13	2
9	Koker Besar	08386-20	4
10	Koker Sedang	08386-16	3
11	Nald Fuder	18362-18	4
12	Pinset anatomis	06096-14	2
13	Pinset cirugis	06096-14	2
	Bedah/Obgyn		
1	Kanul Suction	16522-10	3
2	Hanfat mess no.3	02102-03	6
3	Gunting Kasar emas	04883-17	3
4	Gunting Halus		3
5	Pean Besar hysterectomy	08383-20	8
6	Mosquito	08293-12	6
7	Sonde	14072-16	1
8	Nald foudor	18362-16	4
9	Pinset bebek cirugis	06378-12	2
10	Pinset bebek anatomis	06376-12	2
	Urologi		
1	Klem cantik	08293-10	10
2	Gunting micro	04402-50	1
3	Pinset bebek cirugis	06378-12	2
4	Pinset bebek anatomis	06140-12	2
5	Sanmiler	12133-02	2
6	Tray (Tempat set micro)		1

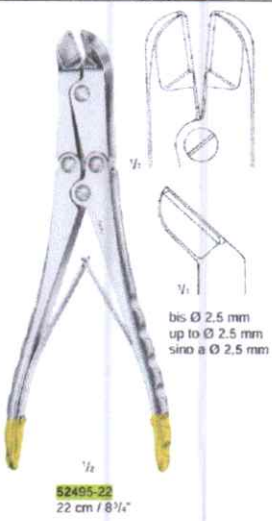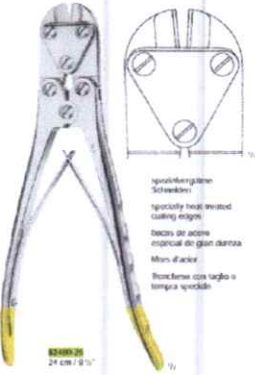

No	Nama Instrumen	Kode	Jumlah	Gambar		Keterangan
	Orthopaedi			Saat Ini	Pengajuan	
1	Pemotong Wire (ukuran kecil 22cm)	52495-22	1			Penggantian alat rusak (patah saat digunakan untuk memotong wire)
2	Pemotong Wire (ukuran besar 25 cm)	52480-25	1	-		Penambahan alat : 1. Pemakaian pemotongan wire bertambah (fast moving) 2. Diagnosa yang menggunakan instrument ini : Fraktur manus, Fraktur pedism Fraktur radius, Fraktur digiti, Fraktur ulna, Fraktur Fibula, Fraktur humerus, dan semua fraktur dengan pemakaian wire 3. saat ini yang berjalan dengan tidak adanya alat ini, pemakaian instrument menggunakan instrument pemotong wire yang kecil, apabila diteruskan, maka akan bisa rusak karena jika

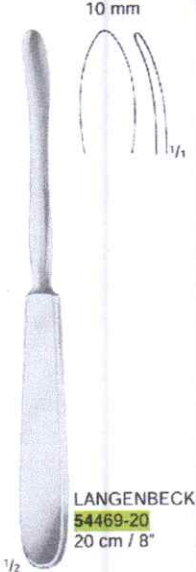

						ukurannya besar, dengan adanya operasi ortopedi yang bersamaan, maka salah satu harus menggunakan yang kecil yang bisa berpotensi patah.
3	Vasgrip	-	2			Penggantian alat rusak (mulut sudah tidak menggigit sehingga tidak maksimal dalam memutus wire)
4	Elevator	54469-20	2	-		Penambahan alat : Diagnosa : Semua fraktur pada kasus ortopedi Saat ini yang berjalan : Karena 2 set ortopedi yang baru tidak ada elevator langenbeck ini, maka Jika ada 2 atau lebih operasi yang bersamaan, elevator akan diambilkan di set bedah plastic atau set yang lain, yang dapat berpotensi serah terima set di CSSD menjadi rancu. Karena harusnya masuk set ortopedi, tetapi



						diambilkan set yang lain.
5	Knabel tang	54799-18	2			Penggantian alat rusak (ujung tidak tajam sehingga tidak dapat memotong tulang)
6	Kikir	54453-24	1	-		Penambahan alat : Tidak pernah punya instrument ini, untuk kasus pro amputasi. Sehingga setelah proses amputasi, ada tahap lagi proses KIKIR Saat ini yang berjalan : DPJP ortopedi dan bedah komplain karena harusnya jika alat ini ada, proses operasi yang harusnya 15 menit (proses kikir), bisa memanjang menjadi 60 menit karena memakai instrument pinset yang ada gerigi nya. jika yang di amputasi bagiannya kecil, masih tidak masalah karena mungkin prosesnya 30







						menit, tetapi apabila bagiannya besar, pernah terjadi sampai 2 jam untuk kikir nya, sehingga menjadi kendala pelayanan operasi pada jam selanjutnya yang sudah terjadwal.
7	Scapel aple	54279-05	2	-		Penambahan alat : Jumlah tersedia : 2 pcs Permintaan : 2 pcs Alasan : Alat ini digunakan untuk debridement, dan curet tulang DPJP ortopedi menjadwalkan operasi bisa lebih dari 2 pasien, ditambah ada pasien bedah yang membutuhkan alat tersebut di jam yang sama. Saat ini hampir semua tindakan operasi ortopedi menggunakan Scapel aple untuk mengerok sisa bagian Tengah tulang yang sudah dipotong. Saat ini untuk mengganti



						scapel aple tersebut, IKO menggunakan alat "pean" , yang berpotensi alat tersebut mudah renggang dan tidak cengkeram sehingga jaringan mudah lepas
8	Elis Klem	08230-13	2	-		Penambahan alat : Diagnosa : STT, MOW, hemorroid, Tumor, perlengketan usus. Alat tersebut sering dipakai sehingga jika hanya 2 pcs, jumlahnya kurang. Saat ini yang berjalan : menjapit dengan pean yang berpotensi pean rusak
9	Koker Besar	08386-20	4			Penggantian alat rusak (Ujung maloklusi sehingga saat digunakan selalu lepas)

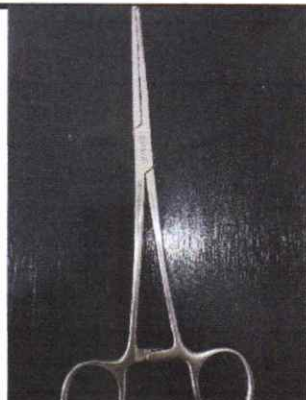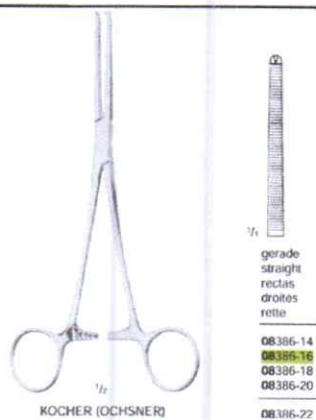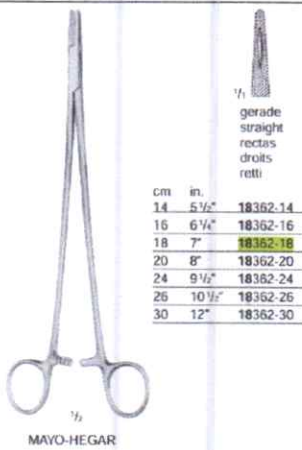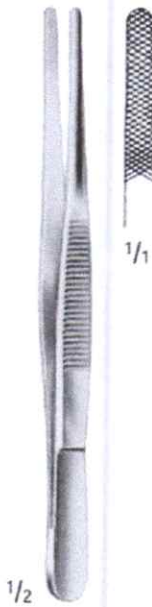

10	Koker Sedang	08386-16	3		 gerade straight rectus droits rette 08386-14 08386-16 08386-18 08386-20 08386-22 KOCHER (OCHSNER)	Penggantian alat rusak (Ujung maloklusi sehingga saat digunakan selalu lepas)																								
11	Nald Fuder	18362-18	4	-	 gerade straight rectus droits rette <table><tr><th>cm</th><th>in.</th><th></th></tr><tr><td>14</td><td>5 1/2"</td><td>18362-14</td></tr><tr><td>16</td><td>6 1/4"</td><td>18362-16</td></tr><tr><td>18</td><td>7"</td><td>18362-18</td></tr><tr><td>20</td><td>8"</td><td>18362-20</td></tr><tr><td>24</td><td>9 1/2"</td><td>18362-24</td></tr><tr><td>26</td><td>10 1/2"</td><td>18362-26</td></tr><tr><td>30</td><td>12"</td><td>18362-30</td></tr></table> MAYO-HEGAR	cm	in.		14	5 1/2"	18362-14	16	6 1/4"	18362-16	18	7"	18362-18	20	8"	18362-20	24	9 1/2"	18362-24	26	10 1/2"	18362-26	30	12"	18362-30	Penambahan alat : Digunakan untuk menjahit semua operasi. Kondisi saat ini operasi dalam satu hari ada 10-15 operasi (hari aktif). Satu pasien membutuhkan 2-3 nald foudor. Selama ini dalam 1 set (4 set) hanya ada 2 nald foudor sehingga masing" butuh tambahan 1
cm	in.																													
14	5 1/2"	18362-14																												
16	6 1/4"	18362-16																												
18	7"	18362-18																												
20	8"	18362-20																												
24	9 1/2"	18362-24																												
26	10 1/2"	18362-26																												
30	12"	18362-30																												
12	Pinset anatomis	06096-14	2	-	 1/2 1/1	Penambahan alat: Digunakan untuk semua operasi. Kondisi saat ini terdapat 1 set alat yang seharusnya bisa digunakan untuk 2 pasien, tetapi karena pinset anatomisnya hanya 2 jadi tidak bisa digunakan untuk 2 pasien.																								




13	Pinset cirugis	06273-14	2	-	 <table><tr><th>cm</th><th>in.</th><th>1 x 2</th></tr><tr><td>10,5</td><td>4 1/4"</td><td>06273-10</td></tr><tr><td>11,5</td><td>4 1/2"</td><td>06273-11</td></tr><tr><td>13,0</td><td>5"</td><td>06273-13</td></tr><tr><td>14,5</td><td>5 1/2"</td><td>06273-14</td></tr></table>	cm	in.	1 x 2	10,5	4 1/4"	06273-10	11,5	4 1/2"	06273-11	13,0	5"	06273-13	14,5	5 1/2"	06273-14	Penambahan alat: Digunakan untuk semua operasi. Kondisi saat ini terdapat 1 set alat yang seharusnya bisa digunakan untuk 2 pasien, tetapi karena pinset sirurgisnya hanya 2 jadi tidak bisa digunakan untuk 2 pasien.
cm	in.	1 x 2																			
10,5	4 1/4"	06273-10																			
11,5	4 1/2"	06273-11																			
13,0	5"	06273-13																			
14,5	5 1/2"	06273-14																			
14	Bone Reduction	Ukuran 17 cm	2			Penambahan alat : 1. Pemakaian untuk memegang tulang kecil 2. Diagnosa yang menggunakan instrument ini : semua fraktur. 3. saat ini yang berjalan dengan tidak adanya alat ini, pemakaian instrument menggunakan instrument bone reduction yang ujungnya tidak menggigit (lebih kecil), sehingga menyulitkan proses operasi.															





		Ukuran 19 cm	2			Penambahan alat : 1. Pemakaian untuk memegang tulang kecil 2. Diagnosa yang menggunakan instrument ini : semua fraktur. 3. saat ini yang berjalan dengan tidak adanya alat ini, pemakaian instrument menggunakan instrument bone reduction yang ujungnya tidak menggigit (lebih kecil), sehingga menyulitkan proses operasi.
	Bedah/Obgyn					
1	Kanul Suction	16522-10	3	-	 POOLE 16522-10 22 cm / 8 3/4" 10 mm Ø, Charr. 30	Penambahan alat: pemakaian untuk tindakan semua laparotomy. Selama ini menggunakan tutup spinocan sehingga risiko cedera pada organ.

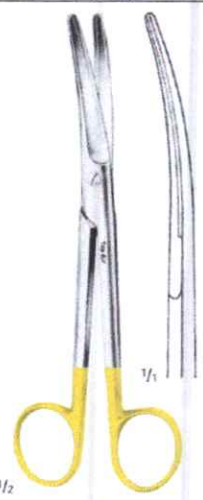

2	Handfat mess no.3	02102- 03	6	-	 E. ON VICIUM LITAE O. S. 1000 P. 1000 O. 1000	Penambahan alat: Digunakan untuk semua operasi. Adanya klem cantik urologi yang sudah tidak cocok untuk urologi maka klem cantik tsb akan digunakan oleh bedah lainnya, tetapi jika itu digunakan sebagai set bedah maka harus ada penambahan handfat mess no.3
3	Gunting Kasar emas	04883- 17	3		 1/2 MAYO 04883-14 04883-17	Penggantian alat rusak (Tidak tajam)
4	Gunting Halus	04911- 18	3		 METZGER 04911-14 = 14 cm / 5 1/2" 04911-18 = 18 cm / 7" 04911-20 = 20 cm / 8"	Penggantian alat rusak (Tidak tajam)

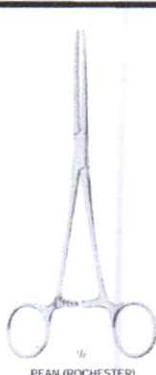


5	Pean Besar hysterectomy	08383-20	8		 PEAN (ROCHESTER) gibbogen curved curves courbes curve 08383-14 08383-16 08383-18 08383-20	Penggantian alat rusak (Maloklusi sehingga jika digunakan untuk menjepit akan merusut)
6	Mosquito	08293-12	6	-	 MICRO-MOSQUITO 08293-10 = 10 cm / 4" 08293-12 = 12 cm / 4 1/2"	Penambahan alat digunakan untuk menghentikan perdarahan dll. Kondisi saat ini tidak ada mosquito pada 2 set sehingga perlu ditambahkan. Selama ini menggunakan pean besar sehingga area yang terkena couther lebih luas.
7	Sonde	14072-16	1	-	 2 mm Ø 14072-10 14072-11 14072-13 14072-14 14072-16	Penambahan alat Kondisi saat ini tidak punya sehingga saat akan melakukan tindakan tracking fistula menggunakan pean sehingga alat tsb terlalu besar dan kadang kurang menjangkau.




8	Nald foudor	18362-16	4		 <table><tr><td>cm</td><td>in.</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>5 1/2"</td><td>18362-14</td></tr><tr><td>16</td><td>6 1/4"</td><td>18362-16</td></tr><tr><td>18</td><td>7"</td><td>18362-18</td></tr><tr><td>20</td><td>8"</td><td>18362-20</td></tr><tr><td>24</td><td>9 1/2"</td><td>18362-24</td></tr><tr><td>26</td><td>10 1/2"</td><td>18362-26</td></tr><tr><td>30</td><td>12"</td><td>18362-30</td></tr></table> MAYO-HEGAR	cm	in.		14	5 1/2"	18362-14	16	6 1/4"	18362-16	18	7"	18362-18	20	8"	18362-20	24	9 1/2"	18362-24	26	10 1/2"	18362-26	30	12"	18362-30	Penggantian alat rusak (Ujung ompong sehingga akan merusak jika digunakan untuk menarik benang)
cm	in.																													
14	5 1/2"	18362-14																												
16	6 1/4"	18362-16																												
18	7"	18362-18																												
20	8"	18362-20																												
24	9 1/2"	18362-24																												
26	10 1/2"	18362-26																												
30	12"	18362-30																												
9	Pinset bebek cirugis	06378-12	2		1x2  MICRO-ADSON 06378-12	Penggantian alat (salah satu gigi sudah ompong sehingga tidak dapat menarik jaringan)																								
10	Pinset bebek anatomis	06376-12	2	-	 MICRO-ADSON 06376-12	Penambahan alat: Digunakan untuk semua operasi. Adanya klem cantik urologi yang sudah tidak cocok untuk urologi maka klem cantik tsb akan digunakan oleh bedah lainnya, tetap jika itu digunakan sebagai set baru maka harus ada penambahan pinset anatomis bebek.																								
	Urologi																													

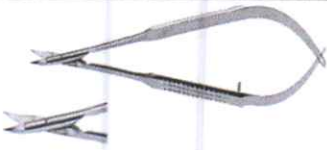

1	Klem cantik	08293-10	10		 MICRO-MOSQUITO 08293-10 = 10 cm / 4" 08293-12 = 12 cm / 4 1/2"	Penggantian alat rusak (Maloklusi sehingga jika digunakan untuk menjepit akan merusut)
2	Gunting micro (GEBOGEN 10.5CM TITANIUM VERSION)	04402-50	1	-		Penambahan alat Digunakan untuk operasi urologi micro. Kondisi saat ini memiliki 1 dan sering operasi urologi bareng 2 operator sehingga perlu penambahan alat.
3	Pinset bebek cirugis	06378-12	2	-	 1x2 MICRO-ADSON 06378-12	Penambahan alat: Digunakan untuk semua operasi. Adanya klem cantik urologi yang sudah tidak cocok untuk urologi maka klem cantik tsb akan digunakan oleh bedah lainnya, tetap jika itu digunakan sebagai set baru maka harus ada penambahan pinset sirurgi bebek.

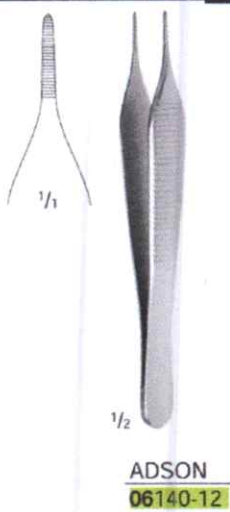

4	Pinset bebek anatomis	06140-12	2	-	 ADSON 06140-12	Penambahan alat: Digunakan untuk semua operasi. Adanya klem cantik urologi yang sudah tidak cocok untuk urologi maka klem cantik tsb akan digunakan oleh bedah lainnya, tetapi jika itu digunakan sebagai set baru maka harus ada penambahan pinset anatomis bebek.
5	Sanmiler	12133-02	2	-	 12133-02 20 x 6 mm SENN-GREEN 15 cm / 6"	Penambahan alat Kondisi saat ini tidak punya sehingga saa akan menggunakan ini menggunakan alat milik bedah plastic sehingga ketika bedah plastic juga memakai akan kesulitan.
6	Sterilization box plastic (inner Dimensions 262 x 465 x 59 mm)		1			Penambahan alat kondisi saat ini tidak punya. Akan digunakan untuk tempa alat urologi.



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 21 / 2 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IKO

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Instrument orthopedi	Kode Inventaris	:
2	Instrument Bedah & obgyn	Merk	: penz.
3	Instrument urologi	Type	:
		Nomor Seri	:
		Warna	: silver.
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 11 / 01 / 2025 2. 20.00 WIB	alat patah, tidak layak pakai Instrument IKO rusak, tidak bisa dipulihkan order baru
Spare part yang rusak	: Instrument IKO	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Siki Indayoh)	 (Galma Gura P.)	 (Mosa'adah)	 (Rudi Indah P.)	 (Raddis)
Ka. Unit IKO	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Penunjang Medis	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



97126