



**BERITA ACARA PENYESUAIAN STOK OPNAME SEDIAAN FARMASI
NOMOR : 156/I-BAC/IFRS/III/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 03 Maret 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : apt. Yuanita Eka Lestari, S,Farm
NIP : DPM-218032701
Jabatan : Kepala Instalasi Farmasi RS

Telah melakukan penelusuran selisih stok beberapa item yaitu:

- **F01387 FOLEY CATH NO 14 - RUSCH**

1. Stok opname bulan Februari ditemukan hasil stok FOLEY CATH NO 14 - RUSCH selisih kurang 90 pcs di Gudang Farmasi.
2. Hasil telusur FOLEY CATH NO 14 - RUSCH ditemukan hasil verifikasi SO oleh auditor PT. DPM tidak ditemukan selisih kurang sehingga tidak ada arahan dari auditor untuk di cek perhitungan ulang jadi hanya dilakukan random stok barang lain. Namun setelah dilakukan tarikan laporan SO ditemukan FOLEY CATH NO 14 - RUSCH ada selisih kurang dan sudah ditelusur petugas salah input jumlah SO.
3. Farmasi menemukan akar selisih bahwa petugas salah input jumlah SO (Fisik 195 namun diinput 100) dan tidak ada konfirmasi dari auditor PT untuk dilakukan perhitungan ulang.
4. Perlu dilakukan penyesuaian stok FOLEY CATH NO 14 - RUSCH sebanyak 90 pcs agar dapat digunakan.

- **F01702 PD PLATE-M2 (BIPOLAR) - ProDevice**

1. Stok opname bulan Februari ditemukan hasil stok PD PLATE-M2 (BIPOLAR) - ProDevice selisih kurang 5 pcs di Gudang Farmasi.
2. Hasil telusur PD PLATE-M2 (BIPOLAR) - ProDevice ditemukan hasil verifikasi SO oleh auditor PT. DPM tidak ditemukan selisih kurang sehingga tidak ada arahan dari auditor untuk di cek perhitungan ulang jadi hanya dilakukan random stok barang lain. Namun setelah dilakukan tarikan laporan SO ditemukan PD PLATE-M2 (BIPOLAR) - ProDevice ada selisih kurang dan sudah ditelusur petugas salah input jumlah SO.
3. Farmasi menemukan akar selisih bahwa petugas salah input jumlah SO (Fisik 149 namun diinput 144) dan tidak ada konfirmasi dari auditor PT untuk dilakukan perhitungan ulang.
4. Perlu dilakukan penyesuaian stok PD PLATE-M2 (BIPOLAR) - ProDevice sebanyak 5 pcs agar dapat digunakan.

- **F02271 EYE DOP**

1. Stok opname bulan Februari ditemukan hasil stok EYE DOP selisih lebih 5 pcs di Gudang Farmasi.
2. Hasil telusur EYE DOP ditemukan hasil verifikasi SO oleh auditor PT. DPM tidak ditemukan selisih lebih sehingga tidak ada arahan dari auditor untuk di cek perhitungan ulang jadi hanya dilakukan random stok barang lain. Namun setelah dilakukan tarikan laporan SO ditemukan EYE DOP ada selisih lebih dan sudah ditelusur petugas salah input jumlah SO.
3. Farmasi menemukan akar selisih bahwa petugas salah input jumlah SO (Fisik 32 namun diinput 37) dan tidak ada konfirmasi dari auditor PT untuk dilakukan perhitungan ulang.
4. Perlu dilakukan penyesuaian stok EYE DOP menjadi 10 pcs agar tidak selisih pada saat SO bulan berikutnya.

- **F01311 CVC SET TRIPLE LUMEN. 7FR (CERTOVIX)**

1. Stok opname bulan Februari ditemukan hasil stok CVC SET TRIPLE LUMEN. 7FR (CERTOVIX) selisih lebih 1 pc di Gudang Farmasi.
2. Hasil telusur CVC SET TRIPLE LUMEN. 7FR (CERTOVIX) ditemukan hasil verifikasi SO oleh auditor PT. DPM tidak ditemukan selisih lebih sehingga tidak ada arahan dari auditor



untuk di cek perhitungan ulang jadi hanya dilakukan random stok barang lain. Namun setelah dilakukan tarikan laporan SO ditemukan CVC SET TRIPLE LUMEN. 7FR (CERTOVIX) ada selisih lebih dan sudah ditelusur petugas salah input jumlah SO.

3. Farmasi menemukan akar selisih bahwa petugas salah input jumlah SO (Fisik 6 namun diinput 7) dan tidak ada konfirmasi dari auditor PT untuk dilakukan perhitungan ulang.
4. Perlu dilakukan penyesuaian stok EYE DOP menjadi 6 pcs agar tidak selisih pada saat SO bulan berikutnya.

Demikianlah berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
PLT Kepala Bidang Penunjang Medik RS
Prima Husada .

Putri Indah Purnamasari, A.Md.Keb

Malang, 03 Maret 2025

Dibuat Oleh

Kepala Instalasi Farmasi RS Prima Husada

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada

dr. Nur Mazidah




LAMPIRAN

F01387 FOLEY CATH NO 14 - RUSCH




F01702 PD PLATE-M2 (BIPOLAR) - ProDevice

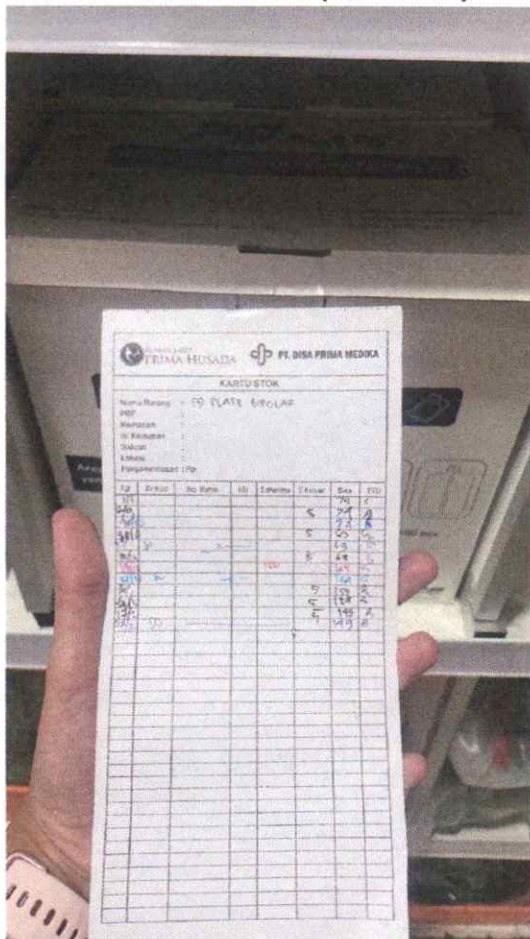



F02271 EYE DOP

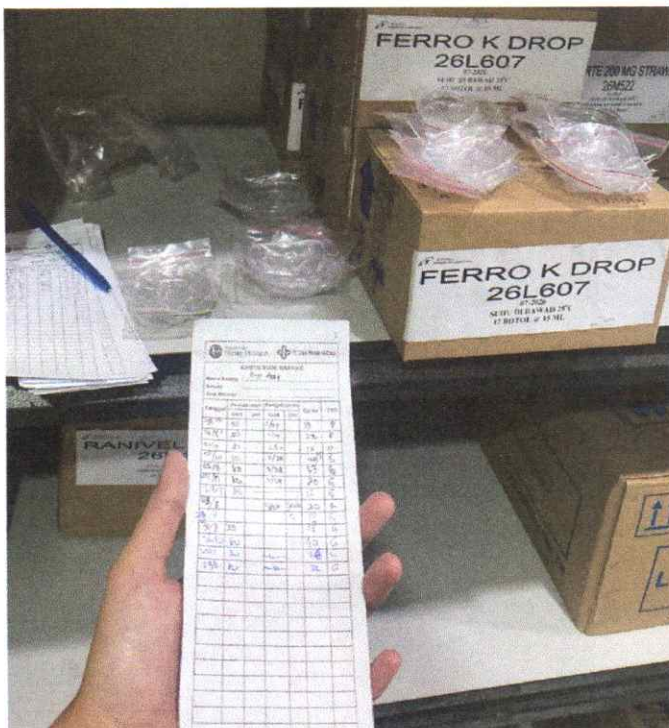

F01311 CVC SET TRIPLE LUMEN. 7FR (CERTOVIX)

