

Malang, 17 Juni 2025

Nomor : 596/I-PNJ/DIR/VI/2025
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Instal Ulang Software USG Mindray D-32 unit ICU ke Pihak ke-3

Kepada Yth.

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Direktur PT. Disa Prima Medika

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil pemeliharaan dan pemeriksaan rutin ATEM IPSRS terhadap USG merk Mindray serial number 9Q-83000084 unit ICU, ditemukan bahwa :

1. Hasil bacaan *noise*
2. Warna kontras berkurang
3. Sensitivitas penggunaan alat berkurang

Demi meningkatkan pelayanan yang aman dan meningkatkan performa alat tersebut, maka kami mengajukan untuk instal ulang software USG Mindray D-32 serial number 9Q-83000084 oleh ke pihak-3 yaitu PT. Tri Tunggal Alkesindo (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang




dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Karu ICU
5. Ka Ins IPSRS



DOKUMENTASI

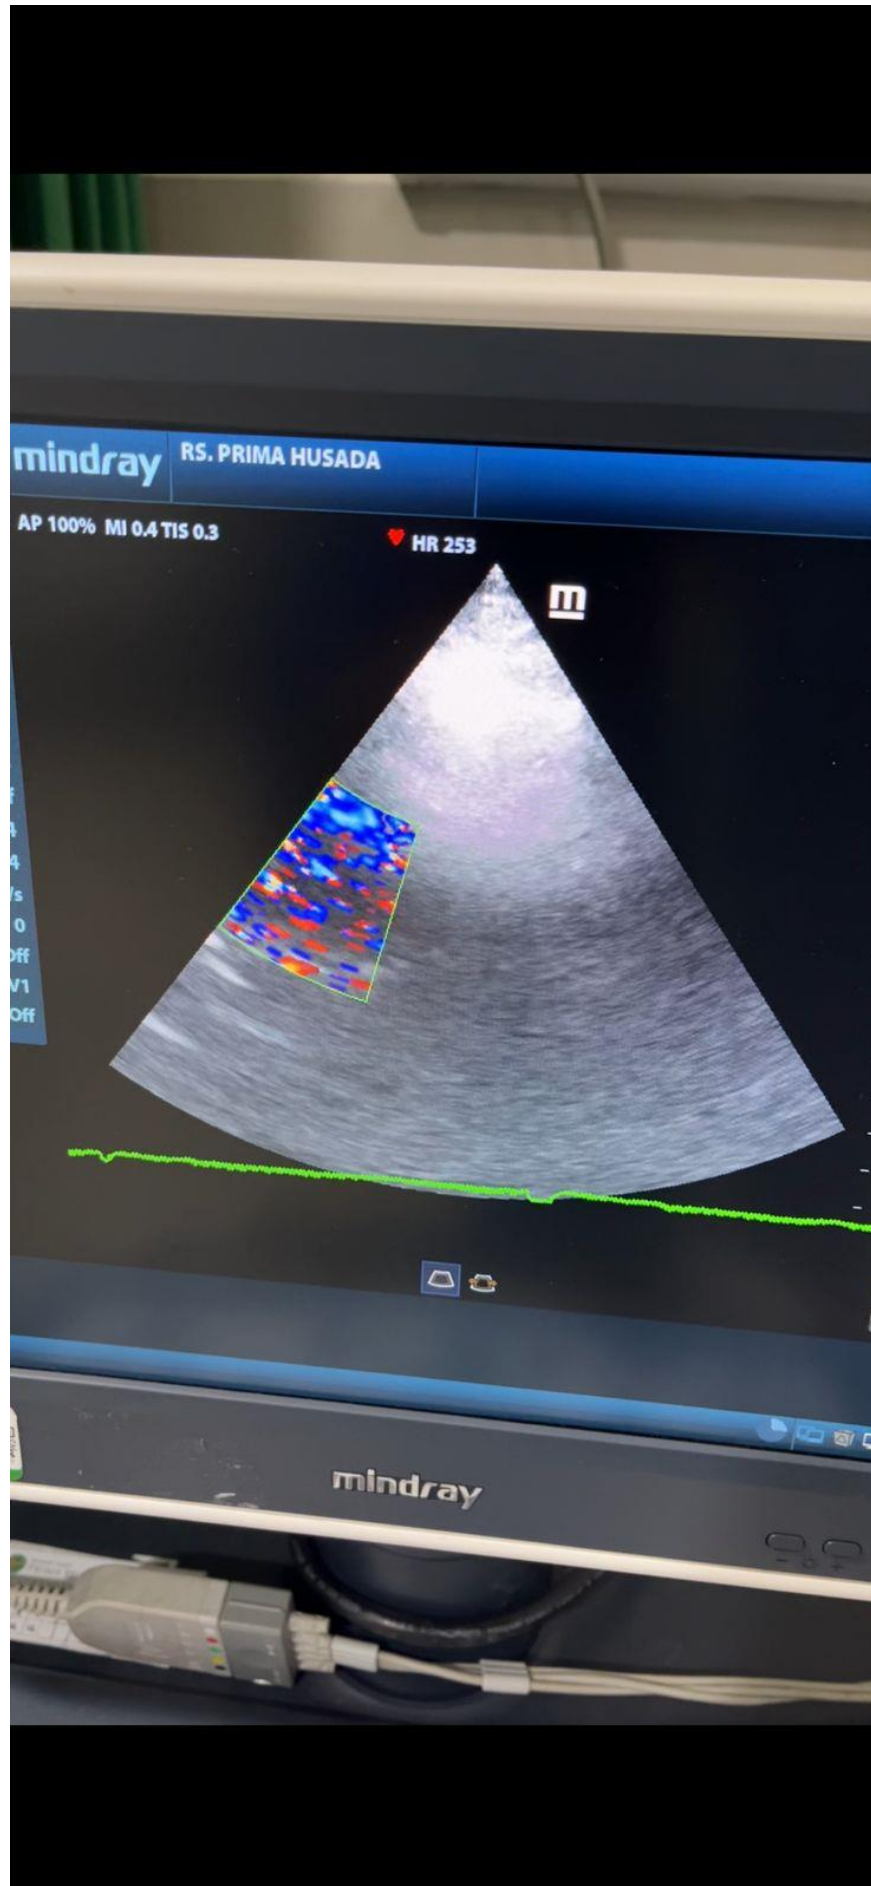



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 13 / 06 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : ICU

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	USG Mindray DC-32 9A-83000084	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	: : : : : : -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 13 / 06 / 2025 2. 10.00 WIB	1. Hasil bacaan noise 2. Warna kontras monitor berkurang 3. Sensitivitas pengukuran alat berkurang. Saran diujikan nilai software ke alat ke-3 PT. Tri Tunggul Alkesindo.
Spare part yang rusak	: Software	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit ICU	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Personal dan Umum	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

