
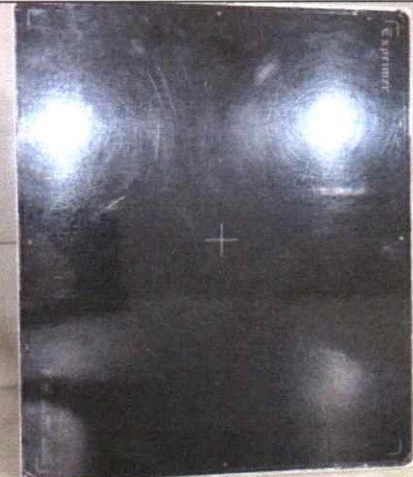
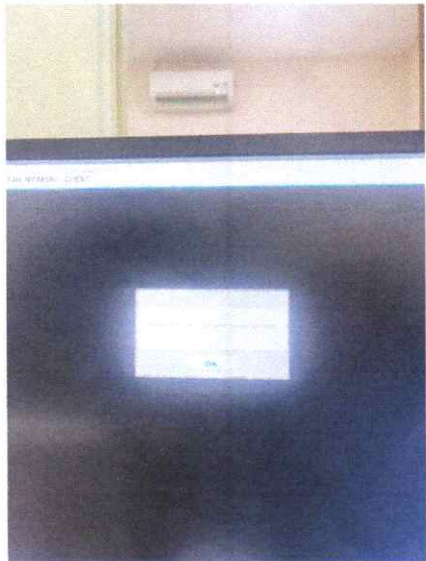


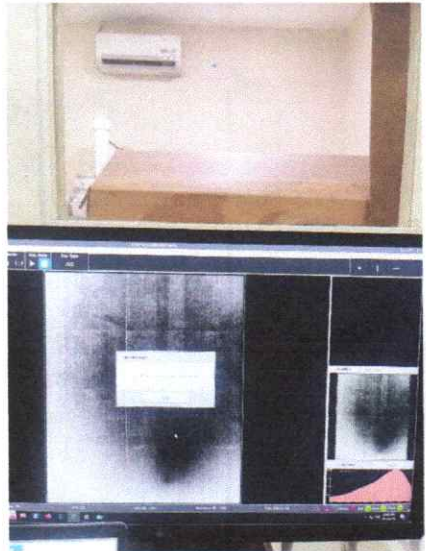

LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Kegagalan konektifitas kaset DR
2	Unit Kerja	Radiologi
3	Nama staff	Isma Mufida, Amd,Rad
4	Tanggal Kejadian	Senin, 20 Oktober 2025
5	Temuan kejadian atas	Detektor kaset DR tidak konek.
6	Kerugian	Alat tidak bisa digunakan
7	Barang Bukti	

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

TANGGAL	KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
Senin, 20 Oktober 2025	Pukul 10.00, pengaturan kaset DR diubah ke mode AP untuk pengambilan foto ke perinatologi, tetapi tidak dapat tersambung dengan telepon genggam radiologi. Kemudian, pada mode <i>stay</i>, jaringan Wi-Fi dari kaset DR terdeteksi. Dicoba untuk <i>ekspos</i> satu kali tanpa objek dan hasilnya muncul. Selanjutnya, jaringan Wi-Fi dari kaset DR ke komputer tidak dapat tersambung dan muncul notifikasi di komputer (<i>AED will restart for detector protection</i>). Pukul 10.15, menghubungi teknisi alat untuk konfirmasi kendala kaset DR. Diminta untuk <i>re-start kaset</i> dan komputer DR tetapi masih belum tersambung. Teknisi meminta komputer untuk disambungkan dengan Wi-Fi agar teknisi dapat mengakses komputer DR secara <i>remote</i>. Pukul 11.35, menghubungi IT untuk dibantu menyambungkan komputer DR dengan Wi-Fi. Pukul 11.53, menghubungi ATEM untuk konfirmasi bahwa komputer DR akan disambungkan dengan internet. Pukul 13.45 hingga 15.30, alat DR diakses secara <i>remote</i> oleh teknisi dan notifikasi (<i>AED will restart for detector protection</i>) tetap muncul.	 



II. HASIL TELUSUR

Sudah di lakukan pengecekan oleh teknisi alat DR tapi kaset DR lama tetap tidak bisa di gunakan karena tidak konek dengan komputer DR.

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

Sesuai dengan kronologi kejadian
Analisa dari teknisi Alat DR terjadi troble pada panel kaset DR

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Alat tidak bisa digunakan (off sementara) dan untuk pelayanan foto rontgen menggunakan kaset DR backup

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Eksternal

M mendatangkan teknisi dari vendor untuk pengecekan langsung kaset DR

Internal

Sudah dilakukan pengecekan oleh ATEM IPSRS (internal), hasil masih tetap tidak berubah.

Malang, 21 Oktober 2025

Yang Melaporkan,		Diketahui Oleh,	
Pelaksana ATEM IPSRS	Karu Radiologi	PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis,	Kepala Bidang Umum & Keuangan
			
Salma Gita Pramesti, AMd.T	Isma Mufida, Amd. Rad	Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	drg. Eddy Wira Pradana, M.MRS
Disetujui, PLT Direktur RS Prima Husada Malang			
 dr. Resti Lestantini, M.Kes			