

Malang, 28 April 2026

Nomor : 269/I-PNJ/DIR/IV/2026
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan CT-Scan ke Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pengecekan teknisi ATEM IPSRS bahwa ditemukan adanya kegagalan scan yaitu munculnya artefak dan terjadi notifikasi error system saat dilakukan air calibration, sehingga membuat hasil bacaan tidak dapat terbaca secara normal, maka kami mengajukan perbaikan ke pihak ke-3 yaitu PT. Philips Indonesia (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang

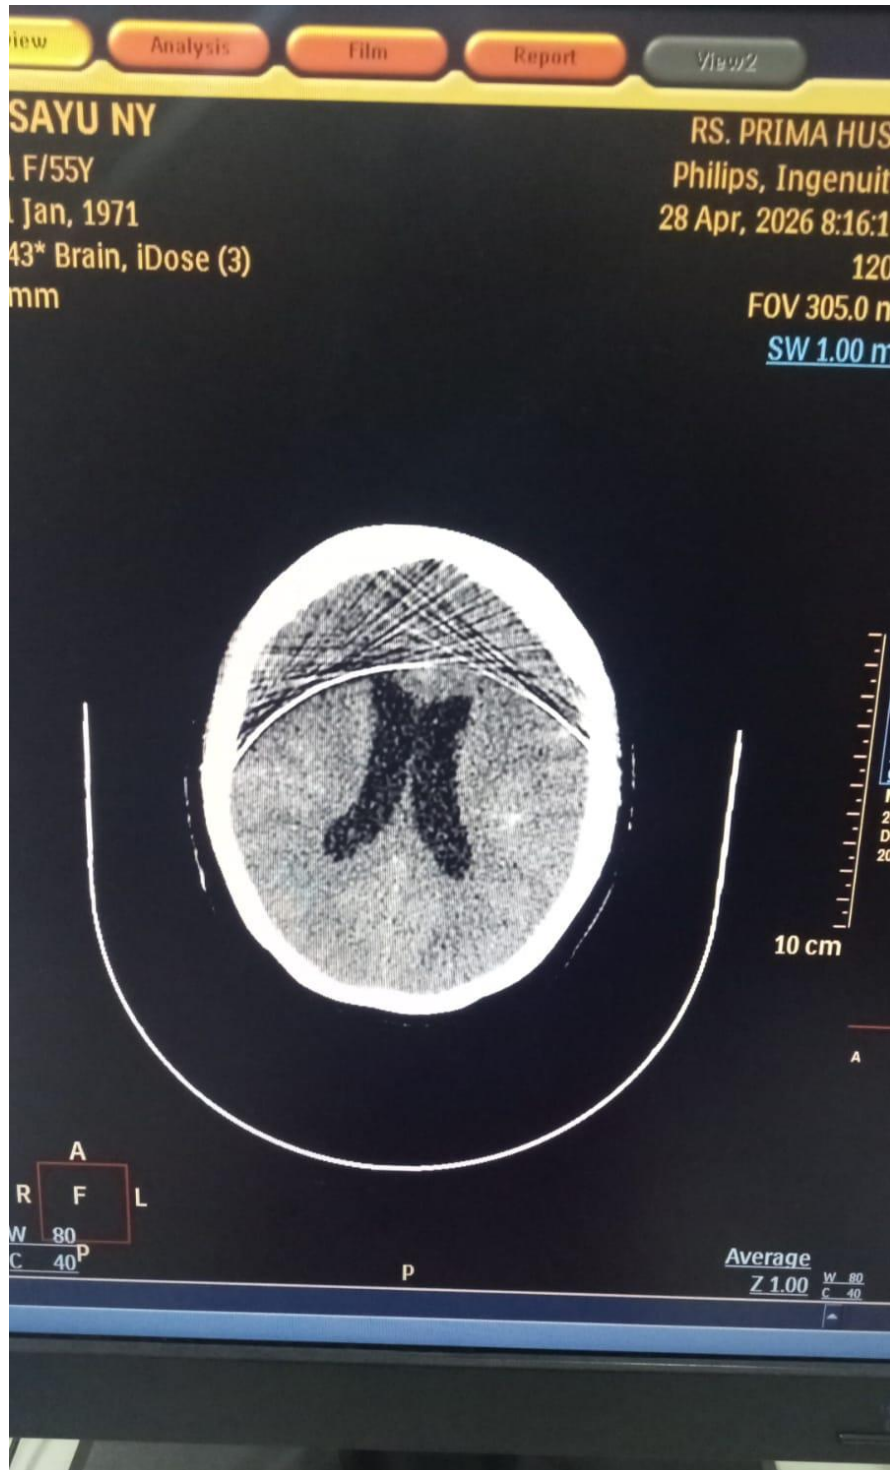


dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis
4. Kepala Instalasi Radiologi
5. Kepala Bagian Umum
6. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI



Gambar 1. Bacaan CT-Scan Terdapat Artefak

FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 25 / 9 / 2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Radio logi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	CT - Scan	Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	Philips Ingenuity CT 45801407831 Punin

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 10 April 2026 s.d 2. 28 April 2026	Saat scan muncul artefak (scan brain). Saat scan abdomen muncul artefak. kembali sudah dilakukan air calibration & short tube test. Saran di gantikan kebocoran ke pihak te-3 PT. Philips Indonesia
Spare part yang rusak	: CT - Scan	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (<u>Ka. Unit Radio logi</u>)	 (<u>Petugas Alat Elektromedis</u>)	 (<u>Ka. IPSRS</u>)	 (<u>Kabid Umum</u>)	 (<u>Ka. Gudang Umum/ Farmasi</u>)

*) Pilih (v) salah satu.

View

Analysis

Film

Report

View2

SAYU NY

F/55Y

Jan, 1971

43* Brain, iDose (3)

mm

RS. PRIMA HUS

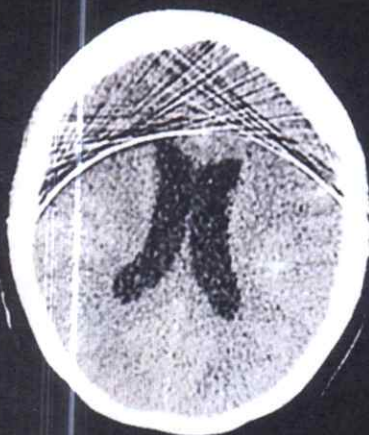
Philips, Ingenuit

28 Apr, 2026 8:16:1

120

FOV 305.0 m

SW 1.00 m



10 cm

A
R F L
W 80
C 40 P

P

Average
Z 1.00W 80
C 40