



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 276/RSPHS/I-PM/IRJA/II/2024


Tanggal		4-3-2023			
Pengajuan Dari Unit*		IRJA (Poli Rehab Medik)			
Alasan Pengajuan		1. Untuk mengganti barang yang lama sudah tidak lengket 2. Pengajuan Baru untuk pemberat saat melakukan tindakan SWD 3. Pengajuan alat baru			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Strap Electroda / Tali Pad Electroda	12	12	Untuk mengganti yang lama Sudah tidak lengket
	2.	Sand Bag 2kg (pemberat)	2	0	Belum belum pernah ada
	3.	Gym Ball ukuran 65 cm	1	0	Belum pernah ada
	4.	Mainan anak untuk tes sensorik dan motorik	6	0	Belum pernah ada
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Strap Elctroda Fungsinya sebagai Tali Pengikat pad Fisioterapi 2. SandBag Fungsinya Pemberat yang biasa diikatkan di pergelangan tangan atau kaki untuk menambah beban saat berolahraga. Tujuannya untuk melatih dan membentuk otot lebih cepat dan lebih kuat. 3. Gymball Fungsi untuk exercise stimulasi anak 4. Mainan anak fungsinya untuk tes respon auditori, tes sensoris dan tes focus anak			
3.	Penempatan alat**	Poli Rehab Medik			
4.	Merk/Tipe**	1. Menyesuaikan 2. Menyesuaikan 3. Speeds 4. Menyesuaikan			
5.	Spesifikasi**	1. Elastic band pad kwd with velcro tali pad elektroda panjang 65cm dan 70 cm lebar 8cm 2. Pemberat yang biasa diikatkan di pergelangan tangan atau kaki untuk menambah beban saat berolahraga – Bahan lembut berisi neoprene iron sand. – Dilengkapi pengikat supaya lebih kuat dan tidak mudah lepas Blue: 2 kg / pcs Ukuran: Panjang 35 cm x Lebar 15 cm 3. Bahan: PVC Diameter: 25cm 55cm 65cm 75cm Maks. Kapasitas Berat: 280kgs 4. Sensory Cube yang kami buat memiliki spesifikasi sbb: Ukuran : 6x6x6cm Bahan : Kubus Kayu dan aksesoris Plastik, Karet dan Polyester.			



Yang Mengajukan  Hendi Wijayanto, S.Kep, Ns	Mengetahui Kabid Jangmed  dr. Ham Dwika P	Mengetahui Kabid Yanmed  Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Menyetujui Direktur  dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

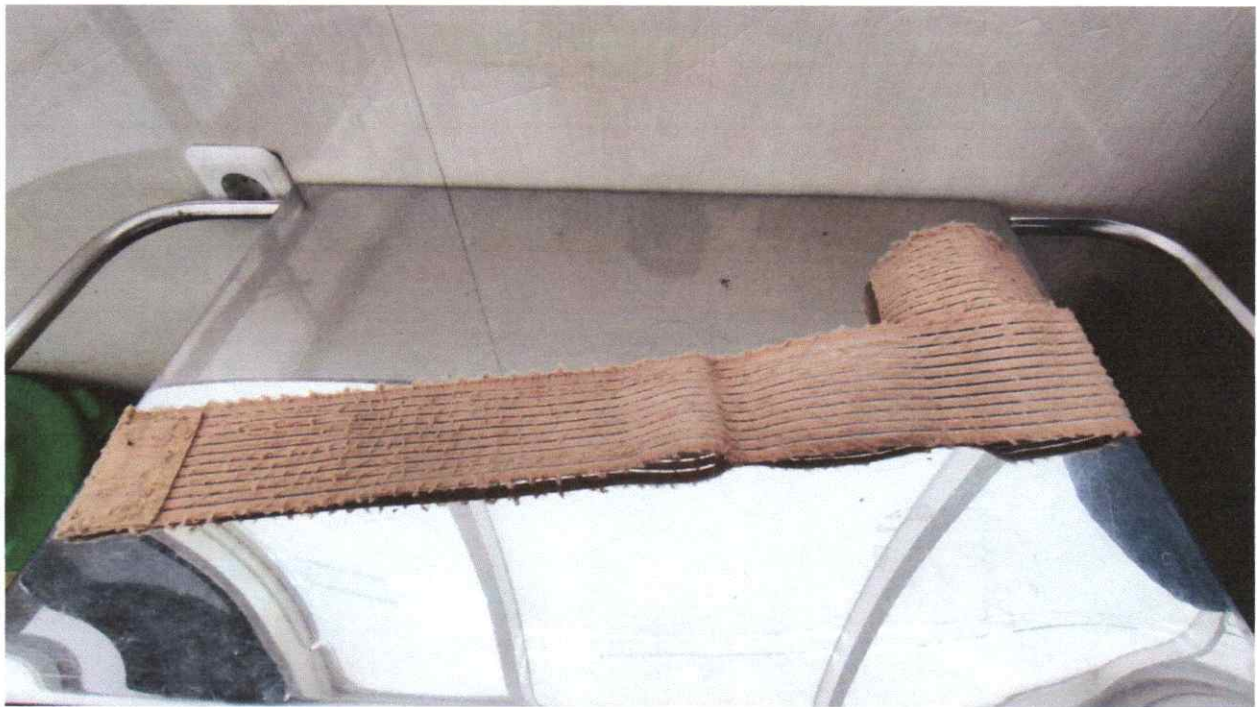

Dokumentasi Strap Electroda yang lama


DOKUMENTASI ALAT YANG DI AJUKAN

SandBag




DOKUMENTASI ALAT

Strap Electroda / Tali Pad Electroda

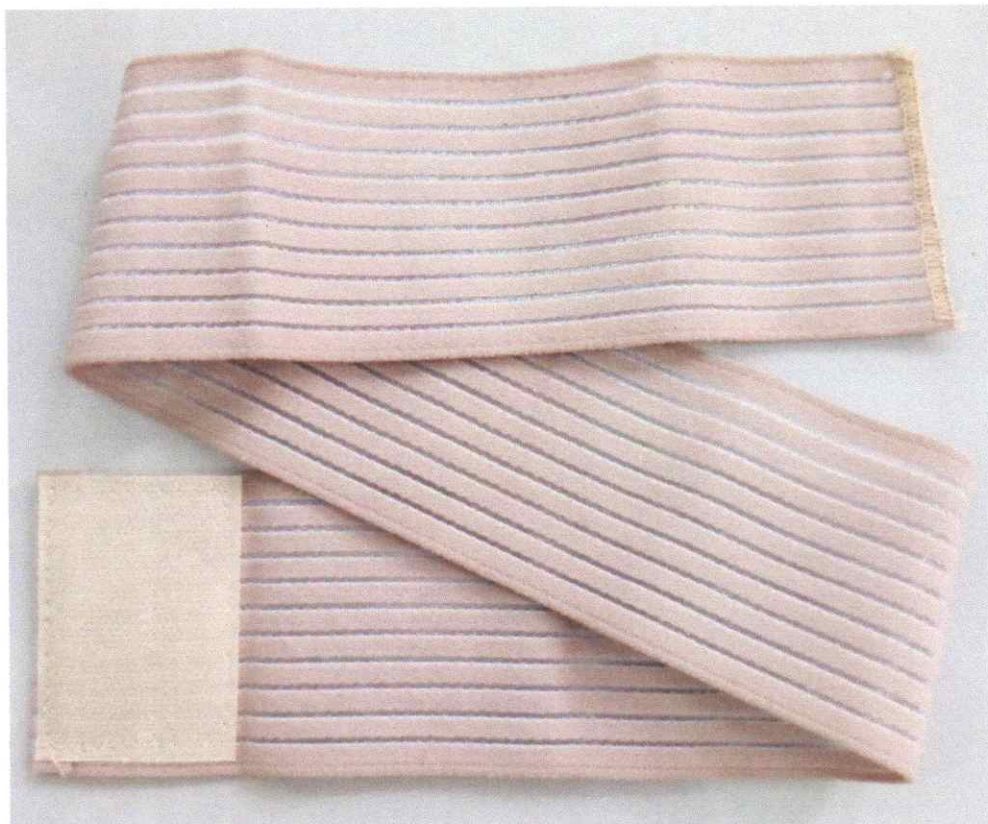

Gym Ball

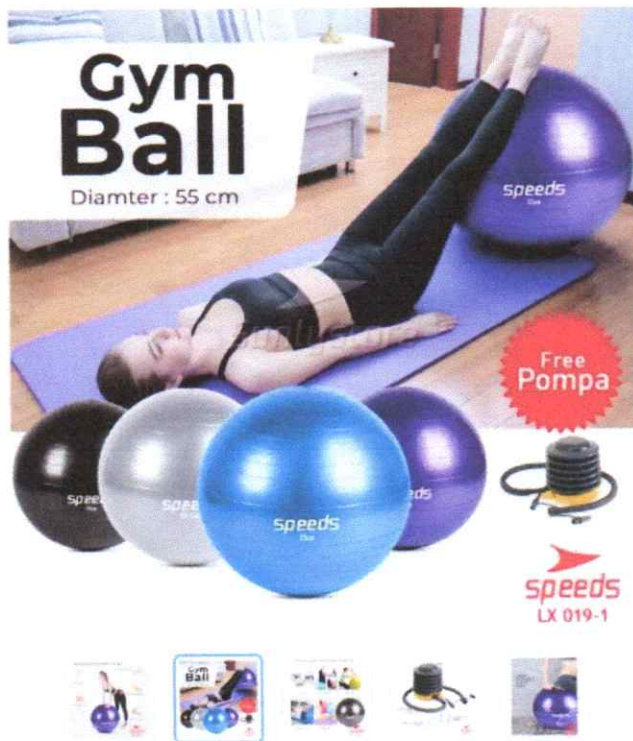

Mainan anak untuk tes sensorik dan motoric

