



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 1365/RSPHS/I-PM/IRNA 2A/XII/2024

Tanggal	7 Desember 2024		
Pengajuan Dari Unit*	IRNA 2C		
Alasan Pengajuan	Untuk kebutuhan unit IRNA 2C		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	ALKES		
	1.	SYRING PUMP	5
	2.	INFUS PUMP	5
	3.	NEBULIZER	1 (Untuk R. Kris)
	4.	MONITOR Hemodinamik	5
	5.	MONITOR TRANSPORT	1
	6.	SUCTION	1
	7.	ALAT ECG	1
	8.	Xray Lamp (Lampu Rontgen)	1
	9.	Bagging Dewasa	1
	10.	O2 TRANSPORT	1
	11.	Regulator sentral ➔ Ambil dari Pner. (2)	10
	Non Alkes		
	12.	Printer	1
	13.	Foot step	10
	14.	Tiang Infus	10
	15.	Nursecall	10
	16.	Troli Tindakan	2
	17.	Troli Untuk tempat obat	1
	18.	Kursi Roda Hitam	5
	19.	Box Sampel	1
	20.	Box Alat Kotor	1
	21.	Box Alat Bersih	1
	22.	Wireless / Telp Genggam	1
	23.	Papan Dinas	1
	24.	Kotak B3	1
	25.	Box Emergency	1
	26.	Papan Code Red	1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 2. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 3. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 4. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 5. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 6. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 7. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 8. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 9. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 10. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 11. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 12. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 13. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 14. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 15. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C	



		16. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 17. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 18. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 19. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 20. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 21. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 22. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 23. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 24. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 25. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C 26. Untuk Melengkapi Kebutuhan IRNA 2C
3.	Penempatan alat**	IRNA 2C
4.	Merk/Tipe**	1. Onemade 2. Presenius kabi infusia vp7s 3. Omron 4. Mindray 5. Mindray 6. Onemed 7. Accu check 8. Menyesuaikan Pengadaan 9. MPM 10. Tabung oksigen transport lengkap 11. Onehealth 12. Epson 13. Menyesuaikan Pengadaan 14. Menyesuaikan Pengadaan 15. Menyesuaikan Pengadaan 16. Menyesuaikan Pengadaan 17. Menyesuaikan Pengadaan 18. Menyesuaikan Pengadaan 19. Menyesuaikan Pengadaan 20. Menyesuaikan Pengadaan 21. Menyesuaikan Pengadaan 22. Menyesuaikan Pengadaan 23. Menyesuaikan Pengadaan 24. Menyesuaikan Pengadaan 25. Menyesuaikan Pengadaan 26. Menyesuaikan Pengadaan
5.	Spesifikasi**	1. Syringpump: Features of Fresenius Injectomat Agilia syringe pump: Flow rate range: 0.1- 200 ml/h (depending on the syringe capacity - up to 1200 ml/h). Flow rate accuracy: $\pm 1\%$ on mechanism; $\pm 2\%$ on syringes. Syringe capacities: 5, 10, 20, 30/35, 50/60 CC. Infusion Modes: ml/h (0.1 ml/h increments). Volume / time: Volume to infuse 0.1 to 99.9 ml / Time: 0 h 01 to 96 h 00. Volume limit: 0.1-999.9 ml (0.1 ml increments). Bolus: Manual bolus: Rate 50-1200 ml/h (50 ml/h increments).




	Drug library: Initial drug list of 50 agents adjustable with Vigilant, the IV Medication Safety Solution. Adjustment of the dilution, authorised infusion modes, default infusion modes, flow rate and bolus limits in ml/h. Pressure modes: 2 modes available: variable or 3 pre-set levels - From 100 to 900 mmHg, 50 mmHg increment. Anti-bolus system: Reduces significantly bolus after occlusion release (0.2 ml max). Dimensions (H/W/D/) : 160 x 345 x 135 mm Weight : 2150 g. Battery: NI/MH / Battery capacity minimum: 10 hours at 5 ml/h Power supply: 100 – 240 Vac / 15 VA, external power 9 Vdc by a converter. 2. Infusumpump: Display : LCD Display Size 9,4cm x 3,7cm Dimensi : 12,5cm(W) x 12,5cm(D) x 23cm(H) Berat : 2,0 Kg Batterai : Li-Ion 2000mAh, dapat bertahan selama 8 jam dengan rate 25mL/h Dengan standard IPX4, aman terhadap tetesan cairan Flow rate Range : 1mL/h s/d 1200 mL/h Operation Mode : 3 operation Mode : Rate, Time, Volume Akurasi : + 5% 3. Laju Nebulisasi 0.4ml/min mengoptimalkan durasi terapi Ukuran Partikel Uap 3µm MMAD untuk nebuliasi yang optimal Aerosol Output 0.4ml Laju Aerosol Output 0.06ml/min Kapasitas obat 7 ml meminimalisasi obat yang tersisa 4. Monitoring kondisi klinis pasien dalam kondisi klinis dalam waktu yang berbeda, Mindray uMEC-10 sudah melewati tes keamanan yang ketat. Alat ini sangat kuat dan dapat digunakan untuk waktu yang lama. • Suhu operasi di 0~40°C tidak dipengaruhi oleh lingkungan ekstrim • Proteksi jatuh 0,75m dan anti-air IPX1 • Bahan plastik yang kuat membuat lebih tahan lama dan tahan korosi/karat • Konsumsi daya rendah dan desain tanpa kipas membuat alat yang ramah lingkungan dan mengurangi kontaminasi dengan alat lain • Aksesoris Mindray sangat dapat diandalkan dengan bahan material yang berkualitas • Working temperature is 0~40°C, unaffected by extremes • 0.75m drop-protection and IPX1 water resistance • Strong plastic housing resists aging and yellowing, with high corrosion resistance • Low power consumption and fanless design makes it environmentally friendly and reduces the risk of
--	---



	cross contamination • Mindray accessories are highly reliable with quality material and production technique 5. Monitoring kondisi klinis pasien dalam kondisi klinis dalam waktu yang berbeda Mindray uMEC-10 sudah melewati tes keamanan yang ketat. Alat ini sangat kuat dan dapat digunakan untuk waktu yang lama. 6. Alat penyedot dahak/ lender. Spesifikasi Produk - Aliran tinggi, vakum tinggi, kinerja bagus, dan penumpukan vakum cepat - Autoclavable, botol plastik transparan lebih tahan lama dan lebih nyaman untuk dibersihkan. - Type :High Vacuum / High Flow - Max vacum : $\geq 0.08\text{MPa}$ (600 mmHg) - Power supply : $\sim 220\text{V} + 10\%$ 50 Hz - Power input : 110 VA - Waktu kerja : 30 menit - Laju aliran : $\geq 20\text{ L/min}$ - Kapasitas tabung : 1000 mL - Kebisingan : $\leq 60\text{dB(A)}$ 7. Alat ECG : Kabel EKG (4mm, konektor pisang, AHA) 01.57.471017 - 1 Bio Protech Resting Tab Elektroda - 100 Unomedical 10-Lead Klip Universal - 10 Recording Paper (Roll, 80mm * 20m) - 1 Kertas Roller - 1 Kabel Listrik (USA Rumah Sakit Grade) - 1 Baterai Litium yang dapat Diisi Ulang (2200mAh) M21R-064114-1 Fuse (T400mA, USA standar) - 2 User Manual - 1 Kartu Referensi Cepat - 1 SPESIFIKASI ECG EDAN SE-3 (Color Screen/Monochrome Screen), 3-channel ECG 8. Tergantung pengadaan 9. Bagging : Baging scale Type RPS ; Model, RPS 50A ; Kapasitas Tas, 50 kg ; Ketelitian, 20 gr ; Error, $\pm 0.10^\circ\text{uF.S}$; Kemampuan Menimbang, 300 Kantong / jam. 10.Tergantung pengadaan 11.Tergantung pengadaan 12.Printer :Dimensi: 375 x 578 x 253 sentimeter,Berat: 3,9 kilogram, Teknologi: Inkjet, Resolusi cetak maksimum: 5.760 x 1.440 dpi, Kecepatan cetak: 33 ppm hitam; warna 15ppm, Resolusi pemindaian maksimum: 9.600 x 9.600 dpi, Resolusi salinan maksimum: 360 x 360 dpi,Jumlah salinan: 1 – 20 tanpa PC, Konektivitas standar: USB 13.Tergantung pengadaan 14.Tergantung pengadaan 15.Tergantung pengadaan 16.Tergantung pengadaan 17.Tergantung pengadaan
--	---

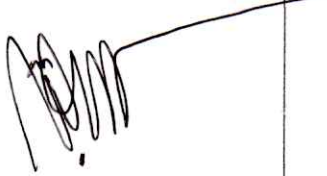

		18.Tergantung pengadaan 19.Tergantung pengadaan 20.Tergantung pengadaan 21.Tergantung pengadaan 22.Kisaran Frekuensi 1,92 GHz - 1,93 GHz, Jumlah kanal 60 Kanal 23.Tergantung pengadaan 24.Tergantung pengadaan 25.Tergantung pengadaan 26.Tergantung pengadaan		
Yang Mengajukan	PLT Wakil Kabid Yanmed	PLT Wakil Kabid Jangmed	Direktur RS	
 (Ns. Anis Pumamasari. S. Kep)	 (Ns. Angela Wensi Flora, S.Kep)	 (Rizqita J.E. Rahmanda., Amd. PK., SKM)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono. M.MRS., CPPD)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



DOKUMENTASI

1.



4.




2.



3.



5.

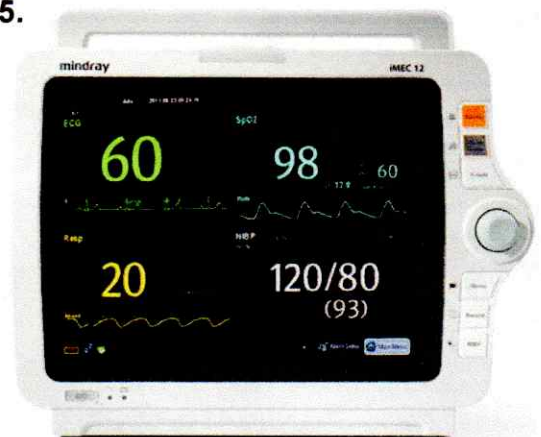


6.



7.



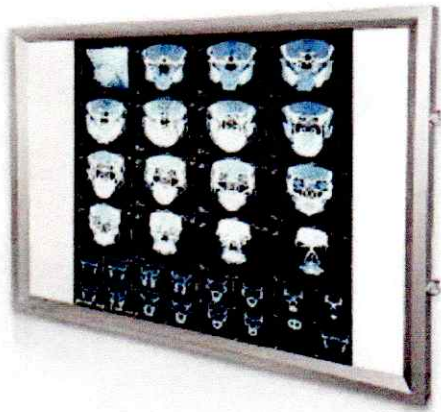

8 .



9.

10 .

PAKET TABUNG OKSIGEN 1 M³ + ISI



11 .



12.



Specification
Dimension : 50 x 50 x 45 cm
Konstruksi : Pipa Kotak 2 x 2 cm
Papan 2 trap
Finishing : Coating
Accessoris : 4 buah karet penutup

13.



14.

Patient Call



15.




16.



17.

No. Reg Kemenkes :
FR.03.04/IVA/04340/2023

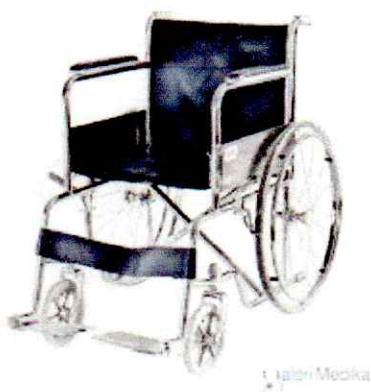

18.



19.




20.



21.



22.

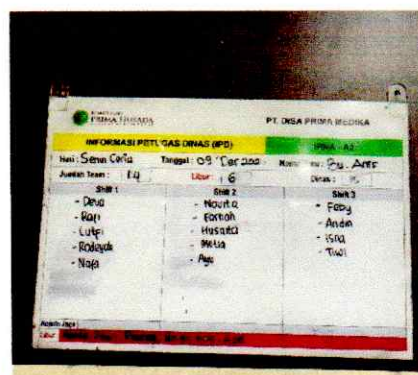

23.



LEMARI BOX BESI B3 UNTUK MENYIMPAN BAHAN - BAHAN B3



Spesifikasi

- Ukuran : 412 x 129 x 197cm
- Material : Besi
- Finishing cat coating
- 2 spon
- 1 handle dapat di adjust tinggi turun
- Dapat di pesan ukuran khusus

Information Call Us

- 081310045700, 081324972709
- 082881743883, 081380545127
- primahusa@gmail.com
- 021-8513346, 021-8601863
- 021-86604702, 021-86604809

24. Follow & Like [@repackablex.com](#), [@pt.bumimataritama](#), [@pt.bumimataritama](#)



25.



26.