

Malang, 05 Agustus 2026

Nomor : 390/I-PNJ/DIR/VIII/2026
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Peralatan Medis, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan ditemukan hasil yang tidak akurat pada alat medis ARK merk Topcon tipe KR800 serial number 4765679 di poli mata dengan hasil bacaan yang tidak sesuai dengan standart, maka kami mengajukan pengecekan pada pihak ke-3 yaitu PT. Topcon.

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang




dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Sekretariat RS
2. Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Penunjang Medis
4. Kepala Bagian Umum
5. Kains IRJA
6. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI

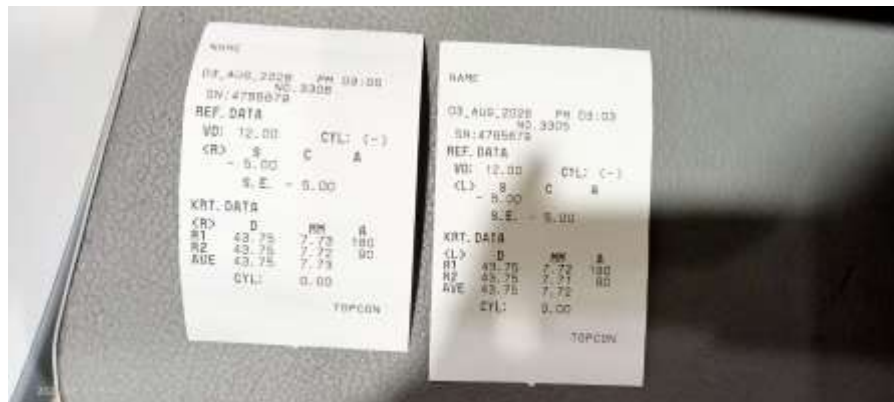

LAMPIRAN
LAPORAN PERBAIKAN ARK INTERNAL

TANGGAL	URAIAN
30 Juli 2026	Menerima keluhan dari user bahwa hasil pengukuran ARK tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.
31 Juli 2026	Mencari phantom di gudang alkes
03 Agustus 2026	Melakukan kalibrasi ARK menggunakan phantom sesuai arahan vendor. Hasil kalibrasi menunjukkan nilai ARK sesuai dengan hasil refraksi pada phantom yaitu -5, sehingga hasil kalibrasi dinyatakan masih akurat. Hasil kalibrasi telah dilaporkan kepada vendor.
05 Agustus 2026	Menerima kembali keluhan dari user bahwa hasil pengukuran alat masih belum sesuai.