

BERITA ACARA KERUSAKAN


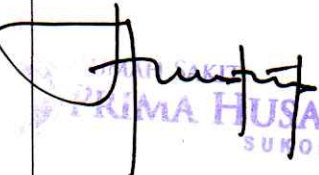
NOMOR : 745/RSPHS/ I-BAC/ IPSRS/VI /2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 27 Bulan Mei Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Ventilator
Merk/Type Alat	:	Mindray / Synovent E5 Sn : EEC 14035301
Ruang/Unit	:	Perinatologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Inspiration O2 tidak lolos kalibrasi,sehingga Oksigen dan Tekanan Kompresor tidak bisa masuk ke pasien.
Analisa	:	1. Mainboard air inspiration limb eror 2. Mainboard O2 inspiration limb
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 27 Mei 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang	Direktur RSPHS
	18/5 			
(Sulyanto Amd TekMed)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Kes	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 745-1 / RSPHB / 1-PM / IPSRS / 01 / 2024

Tanggal	27 Mei 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Mainboard air inspiration limb	1 unit	0	
	2.	Mainboard O2 inspiration limb	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Mainboard air inspiration limb untuk membaca besarnya tekanan udara kompresor. 2. Mainboard O2 inspiration limb untuk membaca besarnya tekanan oksigen yang masuk ke tubuh pasien.			
3.	Penempatan alat**	1. Mainboard air inspiration limb berada di dalam alat ventilator mindray / synovent E5 2. Mainboard O2 inspiration limb berada di dalam alat ventilator mindray / synovent E5			
4.	Merk/Tipe**	1. Mainboard air inspiration limb merk Mindray / Synovent E5 2. Mainboard O2 inspiration limb merk Mindray / Synovent E5			
5.	Spesifikasi**	1. Mainboard air inspiration limb sesuai pengadaan PT 2. Mainboard O2 inspiration limb sesuai pengadaan PT			
Yang Mengajukan		Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur
 (Sulyanto,Amd TekMed)		 (Restu Kurniawati, S.KM)	 Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Ke depan Mohon ditambahkan tanggal identifikasi barang masuk.					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



Dokumentasi

