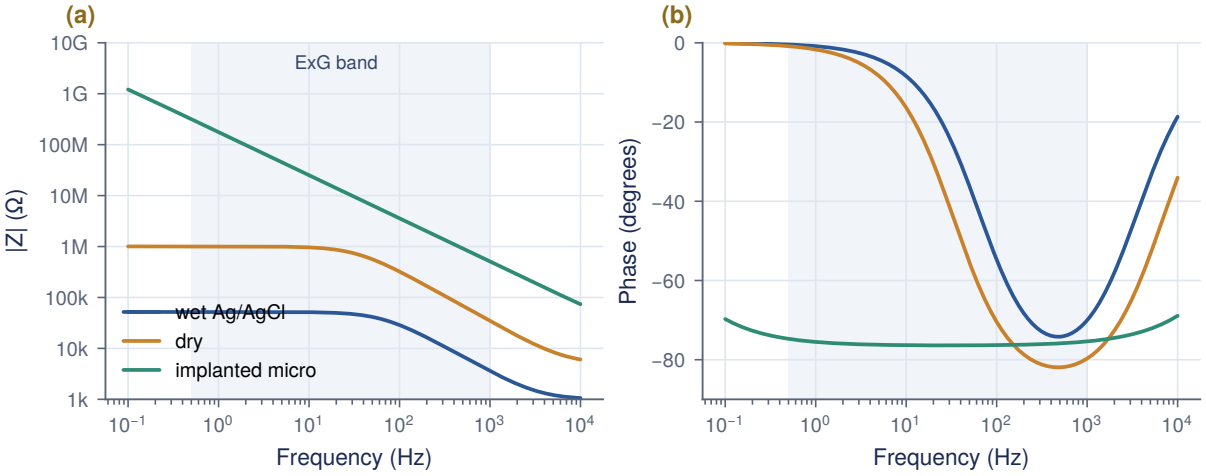
(a)
10G
1G
100M
10M
1M
100k
10k
1k
|Z| (Ω)
ExG band
wet Ag/AgCl
dry
implanted micro
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Frequency (Hz)
(b)
0
−20
−40
−60
−80
Phase (degrees)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Frequency (Hz)