


MANUEL D'UTILISATION

# GMC Radiation Monitor

---

## Module complémentaire Home Assistant - Version 8.3.3

Des explications claires avec captures, exemples et listes de contrôle

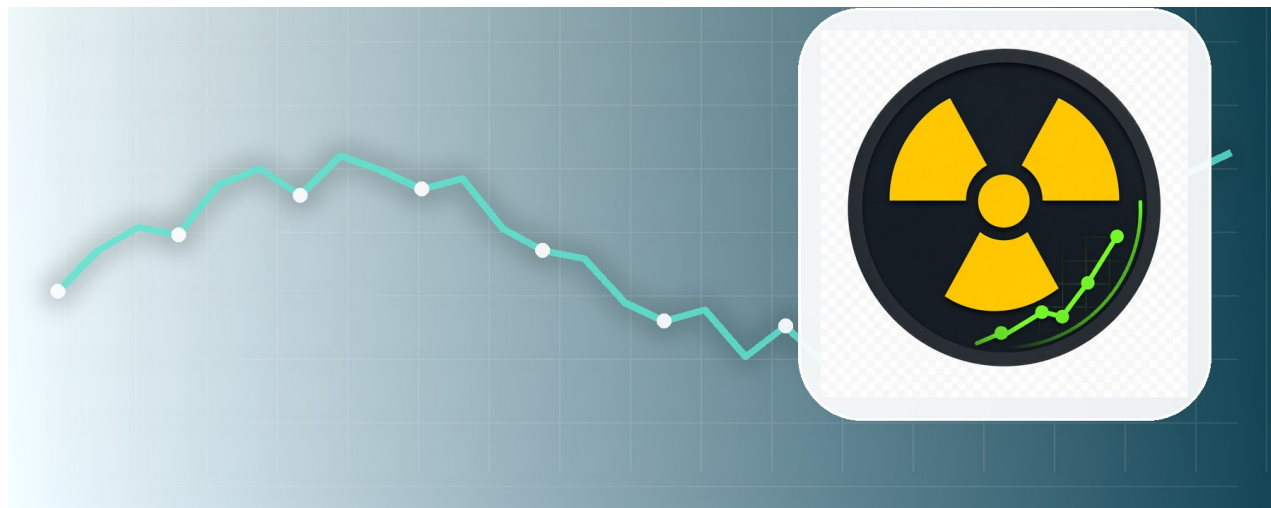

**Pour débutants, utilisateurs et administrateurs**

Édition de juillet 2026

# À propos de ce manuel

Ce manuel explique simplement le module GMC Radiation Monitor. Il couvre l'installation, l'utilisation quotidienne, l'analyse, l'historique, les rapports, les sauvegardes et des exemples de capteurs personnalisés.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>Données d'exemple</b><br>Toutes les captures et valeurs sont des données de démonstration. Les noms d'appareils, identifiants d'entités, numéros de série, valeurs d'étalonnage et identifiants GMCMap doivent être adaptés à votre installation.            |
| ! | <b>Information de sécurité importante</b><br>Le module sert à la surveillance et à la domotique. Ce n'est pas un instrument étalonné de radioprotection et il ne remplace ni les mesures officielles, ni un avis professionnel, ni les consignes des autorités. |

## Comment utiliser ce manuel

- Nouvelle installation : lire d'abord les chapitres 1 à 4.
- Usage quotidien : les chapitres 4 à 9 expliquent le tableau de bord.
- Valeurs inhabituelles ou erreurs : consulter les chapitres 2 et 12.
- Administration : les chapitres 8 à 11 couvrent automatisation, exports, sauvegardes et intégrations.

# Sommaire

Module complémentaire Home Assistant - Version 8.3.2

| Sommaire                                      | Page |
|-----------------------------------------------|------|
| 1. Démarrage rapide                           | 4    |
| 2. Sécurité et bases de la mesure             | 5    |
| 3. Installation et premier démarrage          | 6    |
| 4. Vue d'ensemble du tableau de bord          | 7    |
| 5. Vues et appareils                          | 8    |
| 6. Évaluation intelligente et analyse         | 9    |
| 7. Historique et notes d'événements           | 10   |
| 8. Flux de travail et notifications           | 11   |
| 9. Rapports, exports et sauvegardes           | 12   |
| 10. Exemples de configuration                 | 13   |
| 11. GMCTMap, Home Assistant et MQTT           | 14   |
| 12. Dépannage, glossaire et liste de contrôle | 15   |

# 1. Démarrage rapide

Suivez ces étapes pour obtenir un premier tableau de bord clair sans modifier les réglages avancés.

1. Reliez le compteur GMC compatible à l'hôte Home Assistant par USB.
2. Installez et démarrez le module, puis ouvrez l'interface Web.
3. Vérifiez que l'appareil est en ligne et que la valeur CPM se met à jour.
4. Choisissez d'abord Résumé. Passez à Analyse seulement si nécessaire.
5. Laissez le système collecter des mesures avant d'évaluer les tendances ou la référence locale.

!

## Données d'exemple

Une nouvelle installation a besoin de temps pour apprendre le fond local habituel. Les variations brèves sont normales.

## 2. Sécurité et bases de la mesure

CPM signifie coups par minute. La valeur dépend du tube détecteur, du modèle et de l'environnement. Comparez surtout un appareil à son propre historique et aux seuils configurés.

- Les seuils absolus et l'analyse du fond local répondent à des questions différentes.
- Une carte verte du fond local n'annule pas une alerte absolue.
- Un pic isolé doit être vérifié, mais une hausse durable est plus importante.
- Éloignez-vous d'une source inconnue et suivez les consignes locales en cas de danger réel.

!

### Information de sécurité importante

Ne recopiez jamais un facteur d'étalonnage ou un seuil d'exemple sans vérifier la documentation de l'appareil et l'usage prévu.

### 3. Installation et premier démarrage

Le module détecte automatiquement les périphériques série pris en charge. Les chemins stables sont privilégiés pour faciliter la reconnexion après redémarrage.

1. Installez le paquet et examinez la configuration d'exemple.
2. Adaptez les noms, entités de capteurs et réglages GMCMAP facultatifs.
3. Démarrez le module et consultez le journal de détection.
4. Ouvrez le tableau de bord et vérifiez le résumé d'état.
5. Créez une sauvegarde gérée avant une modification importante.

!

#### Info

Si aucun appareil n'apparaît, vérifiez le câble USB, l'alimentation, les droits de l'hôte et les conflits sur le port série.

## 4. Vue d'ensemble du tableau de bord

La partie supérieure fournit l'aperçu le plus rapide : emplacement, liens, choix de vue, résumé d'état et navigation.

The screenshot displays the 'Surveillance du rayonnement GMC' dashboard. At the top, there are links for 'Emplacement Home Assistant' (marked as unavailable), 'Geiger Counter World Map' (gmcmap.com), and the 'Manuel d'utilisation' (PDF, Version 8.0.8 - Français). Below this is a 'Vue' section with a description and three buttons: 'Résumé' (selected), 'Analyse', and 'Vue experte'. The main area features six status cards: 'Devices' (All 2 known GMC devices are connected), 'Latest accepted value: 19 CPM' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Last successful storage' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Discarded CPM peaks: 0' (Unconfirmed values since bridge start), 'Mesures stockées: 2,688' (Mesures enregistrées pour tous les appareils), and 'Database: ok' (0.51 MiB). A navigation bar below these cards includes 'Devices', 'Intelligence', 'Analyse', 'History', 'Flux de travail', 'Reports', and an 'Expand all' button. The bottom section, 'Appareils GMC connectés', shows two device cards. The first card for 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) shows a 'Dernière mesure' of 19 CPM, 'No active device warnings', and fields for 'NUMÉRO DE SÉRIE' (GMC320-DEMO), 'PORT SÉRIE' (—), 'DÉBIT EN BAUDS', and 'INTERVALLE DE MESURE'. The second card for 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO) shows a 'Dernière mesure' of 25 CPM, 'No active device warnings', and similar fields. A yellow tooltip on the right says 'Données d'exemple pour ce manuel'.

4. Vue d'ensemble du tableau de bord

- Le lien World Map ouvre GMCMaP. Le lien du manuel utilise la langue du tableau de bord.
- Résumé, Analyse et Vue experte règlent le niveau de détail et les outils affichés.
- Le résumé indique connexion, dernière valeur acceptée, stockage et état de la base.
- La navigation mène directement aux appareils, analyses, historique, flux et rapports.

## 5. Vues et appareils

Chaque appareil possède sa carte avec disponibilité, dernière valeur, alertes, identité, connexion série et options propres.

The screenshot displays the 'Devices' tab of the GMC Radiation Monitor interface. It shows two device cards side-by-side. The left card is for 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) and the right card is for 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO). Both cards indicate they are 'En ligne' (Online). The 'Dernière mesure' (Last measurement) is 19 CPM for the left and 25 CPM for the right. Below this, a green bar states 'No active device warnings'. Each card has a table of technical specifications: Numéro de série, Port série, Débit en bauds, Intervalle de mesure, CPM par MSV/h, Profil de l'appareil, Fonctions de l'appareil, Mesures enregistrées pour cet appareil, Dernière mise à jour, and Tension de la batterie. The left card also includes a section for 'Envoi public vers GMCMAP' with details about the last transmission. A yellow tooltip at the bottom right of the right card reads 'Données d'exemple pour ce manuel'.

### 5. Vues et appareils

- Utilisez des noms clairs indiquant la pièce ou l'usage.
- Vérifiez l'état en ligne avant d'interpréter une valeur absente ou ancienne.
- Les alertes de l'appareil sont plus importantes que les couleurs décoratives.
- N'ouvrez les détails techniques que pour diagnostiquer connexion ou configuration.

!


#### Tip

La vue choisie est mémorisée dans le navigateur. Chaque ordinateur peut donc utiliser un niveau différent.



## 6. Évaluation intelligente et analyse

L'analyse combine seuils absolus, fond local, tendances, qualité des données et informations environnementales facultatives afin d'expliquer une valeur normale ou inhabituelle.

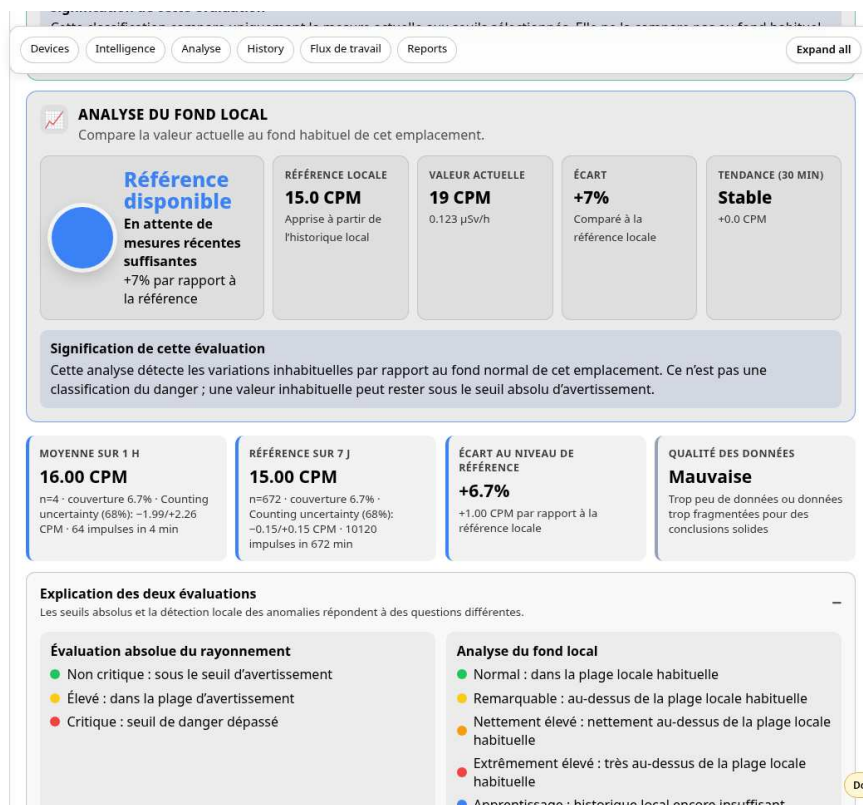

### 6. Évaluation intelligente et analyse

- Résumé est recommandé au quotidien.
- Analyse ajoute les explications, tendances et comparaisons au fond local.
- Vue experte affiche diagnostics bruts, qualité et exports supplémentaires.
- Lisez la recommandation avec les cartes associées ; ne vous fiez pas à un seul nombre.

!

#### Info

« Sans particularité » signifie que la valeur correspond au profil local appris. Ce n'est pas une déclaration générale d'absence de danger.

## 7. Historique et notes d'événements

L'historique montre l'évolution dans le temps. Les notes expliquent ventilation, maintenance, déplacement ou autres circonstances.

The screenshot displays the software interface for the GMC Radiation Monitor. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analyse', 'History', 'Flux de travail', and 'Reports'. An 'Expand all' button is on the right. Below this, the 'Notes d'événement' section is active, with a subtitle 'Documenter la ventilation, un déplacement, la maintenance ou une cause inconnue'. It contains fields for 'Début' (mm/dd/yyyy, --:-- --), 'Fin' (mm/dd/yyyy, --:-- --), 'Catégorie' (Fenêtre ouverte), and 'État' (Note). A large text area for 'Note' is provided, followed by a blue button 'Ajouter une note d'événement'. Below this, a message states 'Aucune annotation n'a encore été ajoutée.' The 'Explorateur d'historique' section below it has the subtitle 'Valeurs CPM acceptées avec marqueurs d'événements dans une période librement choisie'. It includes date pickers for 'Historique du' (07/16/2026) and 'Historique au' (07/17/2026), a checkbox for 'Afficher les valeurs brutes rejetées', and a blue button 'Afficher la période'. A line graph shows CPM fluctuations over time. The graph's minimum is 11.0 CPM and maximum is 19.0 CPM. A yellow tooltip on the right says 'Données d'exemple pour ce manuel'.

7. Historique et notes d'événements

1. Choisissez l'appareil et la période.
2. Comparez le graphique à la référence et aux notes.
3. Ajoutez une note après déplacement, changement de câble ou modification de la pièce.
4. Comparez des périodes pour distinguer un changement durable d'un événement bref.

!

### Tip

De bonnes notes facilitent fortement l'analyse ultérieure. Utilisez des descriptions courtes et des horaires précis.

## 8. Flux de travail et notifications

Les flux automatisent les tâches courantes sans modifier la mesure : notifications, rapports planifiés et comparaison de périodes.

Seuil hors ligne en minutes: Seuil de données récentes en: Délai entre notifications en:

Devices Intelligence Analyse History Flux de travail Reports Expand all

☒ Activer les rapports planifiés ☐ Rapports ZIP quotidiens ☒ Rapports ZIP hebdomadaires ☒ Synthèses JSON mensuelles

Heure du rapport: 6 Sauvegardes gérées à conserver: 7

Enregistrer les paramètres de flux de travail

**Comparer des périodes**  
Comparer deux plages de dates librement choisies

Appareil: Basement GMC-320R

Première période du: 07/04/2026 Première période au: 07/11/2026 Deuxième période du: 07/11/2026 Deuxième période au: 07/17/2026

Comparer

| Moyenne de la première période              | Moyenne de la deuxième période              | Différence des moyennes | Différence des médianes | Indication statistique                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 15.30 CPM<br>672 mesures · couverture 6.7 % | 15.00 CPM<br>621 mesures · couverture 6.2 % | -0.29 CPM<br>-1.90 %    | 0.00 CPM                | -3.33<br>Différence divisée par l'erreur standard combinée |

La comparaison n'est qu'indicative car la couverture des données est faible

**Autotest du système**  
Diagnostics supplémentaires non affichés dans l'aperçu d'état

|                                                               |                                                                                 |                                                                     |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schéma de base de données</b><br>Version de schéma 8 sur 8 | <b>API Home Assistant</b><br>L'API Home Assistant est actuellement indisponible | <b>Fuseau horaire</b><br>Le fuseau horaire Europe/Berlin est valide | <b>Espace libre</b><br>8796093021636 Mio sont disponibles |
| <b>Traductions</b>                                            | <b>Configuration de</b>                                                         | <b>Sauvegardes gérées</b>                                           |                                                           |

Données d'exemple pour ce manuel

### 8. Flux de travail et notifications

- Activez uniquement les notifications qu'une personne recevra et traitera.
- Testez le seuil hors ligne avec un appareil non critique.
- Choisissez une heure où Home Assistant fonctionne habituellement.
- Les sections repliées mémorisent leur état dans le navigateur.


!

### Information de sécurité importante

L'automatisation est une aide. Elle ne garantit pas la livraison et ne doit pas être l'unique mesure de sécurité.

## 9. Rapports, exports et sauvegardes

Les rapports fournissent des synthèses lisibles et des exports techniques. Les sauvegardes gérées protègent la base et les paramètres du module.

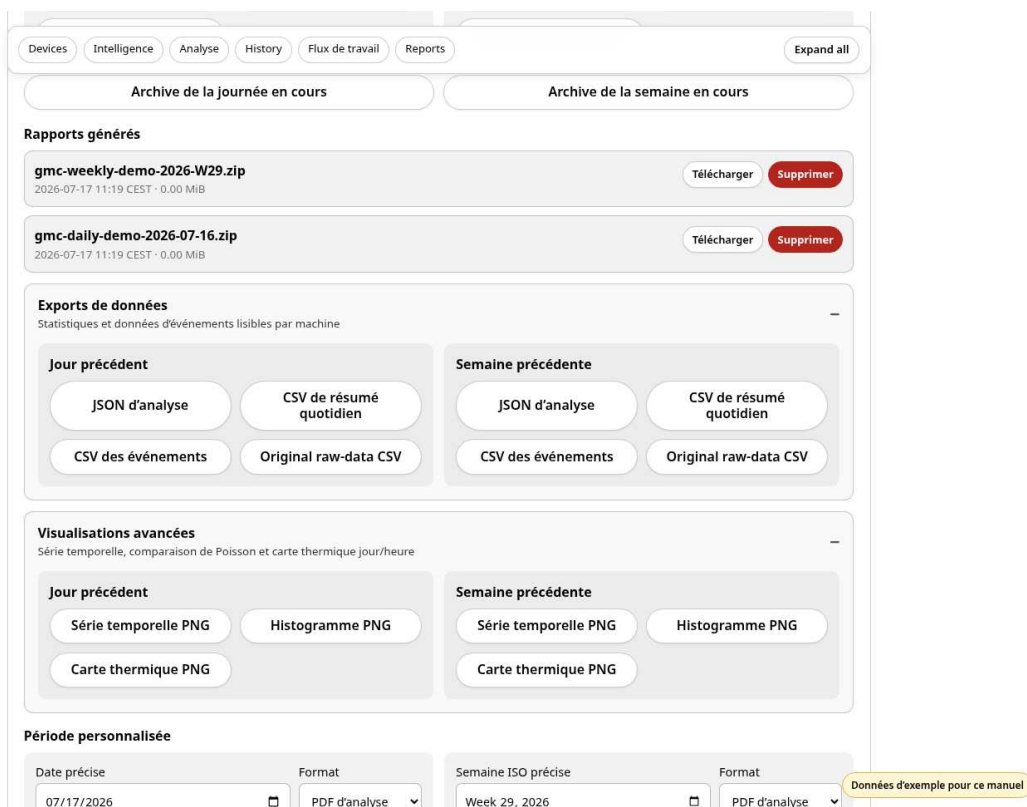

### 9. Rapports, exports et sauvegardes

- Utilisez « Mesures au format CSV » pour les valeurs filtrées par qualité.
- Utilisez les données brutes uniquement pour un diagnostic expert.
- Les rapports ZIP regroupent plusieurs fichiers.
- Supprimez un rapport seulement après avoir confirmé qu'aucune copie n'est nécessaire.
- Créez une sauvegarde avant une mise à jour ou un changement majeur.

!

#### Info

Une sauvegarde n'est utile que si elle peut être retrouvée et restaurée. Documentez son emplacement et sa conservation.

## 10. Exemples de configuration

La configuration fournie est volontairement un exemple pour des capteurs individuels. Remplacez les entités et valeurs par celles de votre installation.

```
devices:
  - name: "Compteur de cave"
    serial_number: "VOTRE-NUMERO"
    external_temperature_entity: "sensor.temperature_cave"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Paris"
```

- Utilisez des identifiants d'entités Home Assistant valides.
- Gardez des numéros de série uniques.
- Considérez l'étalonnage comme une donnée propre à l'appareil.
- Redémarrez le module après un changement qui affecte la détection.

!

### Données d'exemple

Toutes les captures et valeurs sont des données de démonstration. Les noms d'appareils, identifiants d'entités, numéros de série, valeurs d'étalonnage et identifiants GMCMap doivent être adaptés à votre installation.

# 11. GMCTMap, Home Assistant et MQTT

La publication GMCTMap, les entités MQTT et les capteurs Home Assistant sont facultatifs. Configurez-les seulement si vous comprenez où vont les données.

- GMCTMap peut publier des mesures sur la carte publique. Vérifiez confidentialité et emplacement.
- MQTT expose valeurs, disponibilité et analyses à Home Assistant.
- Utilisez les automatisations pour le confort, mais conservez le tableau de bord et les rapports pour le diagnostic.
- Protégez clés API et identifiants ; ne les publiez pas dans des captures ou tickets.

!

## Tip

Commencez par la surveillance locale. Ajoutez la publication externe lorsque l'installation est stable.

l'appareil, le fuseau horaire, la période et l'heure de génération. Les archives ZIP contiennent en plus le JSON d'analyse, les

Devices Intelligence Analyse History Flux de travail Reports Expand all

L'enregistrement gyroscopique est désactivé. Conservation de l'historique : 120 jours. Les périodes quotidiennes sont des jours calendaires locaux ; les périodes hebdomadaires sont des semaines ISO du lundi au dimanche.

### Gestion de l'historique

ZIP de l'historique complet JSON de diagnostic

Sauvegardes gérées

Créer, inspecter, comparer, télécharger et nettoyer les instantanés SQLite locaux

Créer une sauvegarde gérée

Comparaison des sauvegardes les plus récentes

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 comparé à gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3 : +0 mesures, +0 mesures brutes

| gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3      | Télécharger | Supprimer |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements |             |           |
| gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3      | Télécharger | Supprimer |
| 2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements |             |           |

### Restaurer l'historique

La restauration est désactivée par défaut.

Activez « Autoriser la restauration » dans la configuration de l'application et redémarrez uniquement lorsqu'une restauration est prévue.

### Delete history

Deletion is disabled by default.

Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Données d'exemple pour ce manuel

## 11. GMCTMap, Home Assistant et MQTT

## 12. Dépannage, glossaire et liste de contrôle

La plupart des problèmes se résolvent en vérifiant, dans l'ordre, le résumé d'état, la carte de l'appareil, le journal et l'autotest.

| Problem         | Action                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aucun appareil  | Vérifiez USB, alimentation, droits et conflits de port.         |
| Valeur ancienne | Vérifiez état en ligne, intervalle et journal récent.           |
| Pic inattendu   | Comparez historique, notes et qualité des données.              |
| Aucun rapport   | Vérifiez flux, fuseau horaire, stockage et espace libre.        |
| Manuel absent   | Réinstallez le paquet complet 8.3.2 puis actualisez le tableau. |

### Glossary

| Term             | Meaning                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| CPM              | Coups par minute indiqués par le détecteur.         |
| Référence        | Plage normale apprise pour cet appareil et ce lieu. |
| Tendance         | Direction des mesures récentes.                     |
| Données brutes   | Enregistrements non filtrés pour analyse technique. |
| Sauvegarde gérée | Sauvegarde créée avec gestion de conservation.      |

### Final check

- ☐ Appareil en ligne et valeur récente
- ☐ Aucune alerte active
- ☐ Base de données correcte
- ☐ Fuseau horaire correct
- ☐ Sauvegarde récente
- ☐ Chemin de notification testé

# Addendum de la version 8.3.3

---

Cette version étend la vue des appareils et la configuration métrologique des détecteurs à un ou deux tubes Geiger-Müller.

## Détecteur et étalonnage dans l'interface principale

- La carte de l'appareil affiche directement le modèle du tube, le facteur de conversion et l'état d'étalonnage.
- Les vues analyse et expert ajoutent temps mort, modèle de correction, limite CPM fiable, incertitudes et référence.

## Profils à deux tubes du GMC-500+

- M4011 et SI-3BG peuvent disposer de facteurs, temps morts et plages fiables séparés.
- Le mode separate utilise les deux canaux; le mode curve applique une courbe d'étalonnage par morceaux.
- Sans étalonnage SI-3BG, l'application n'utilise pas le facteur M4011 pour produire une dose trompeuse.

Remarque : les valeurs par défaut sont des valeurs de travail et ne remplacent pas un certificat d'étalonnage traçable.