
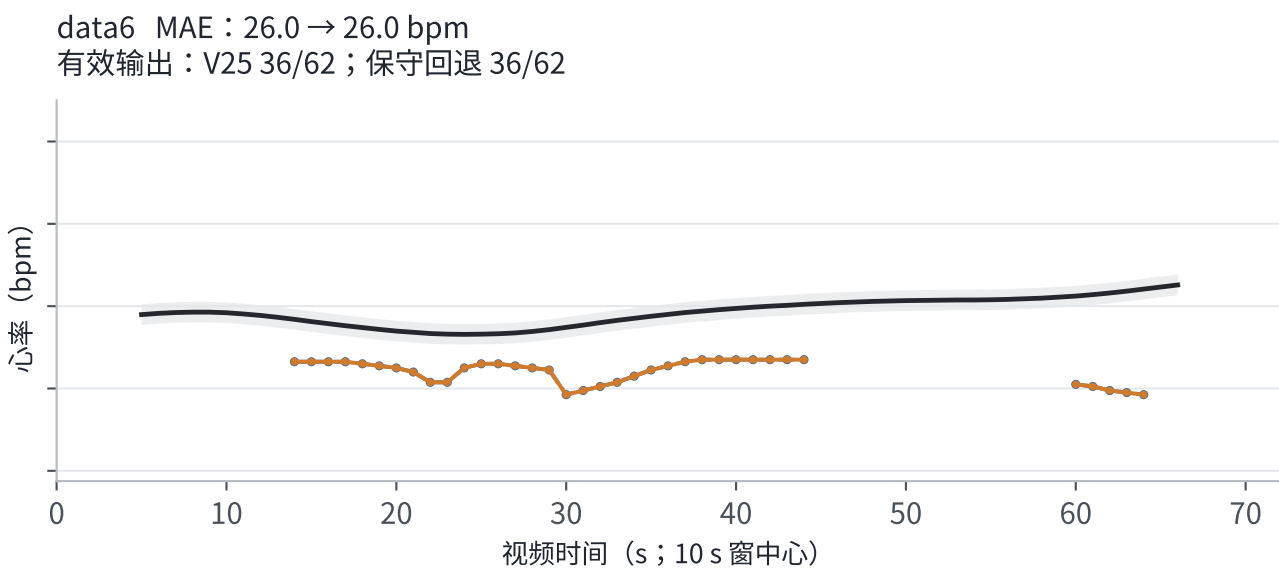
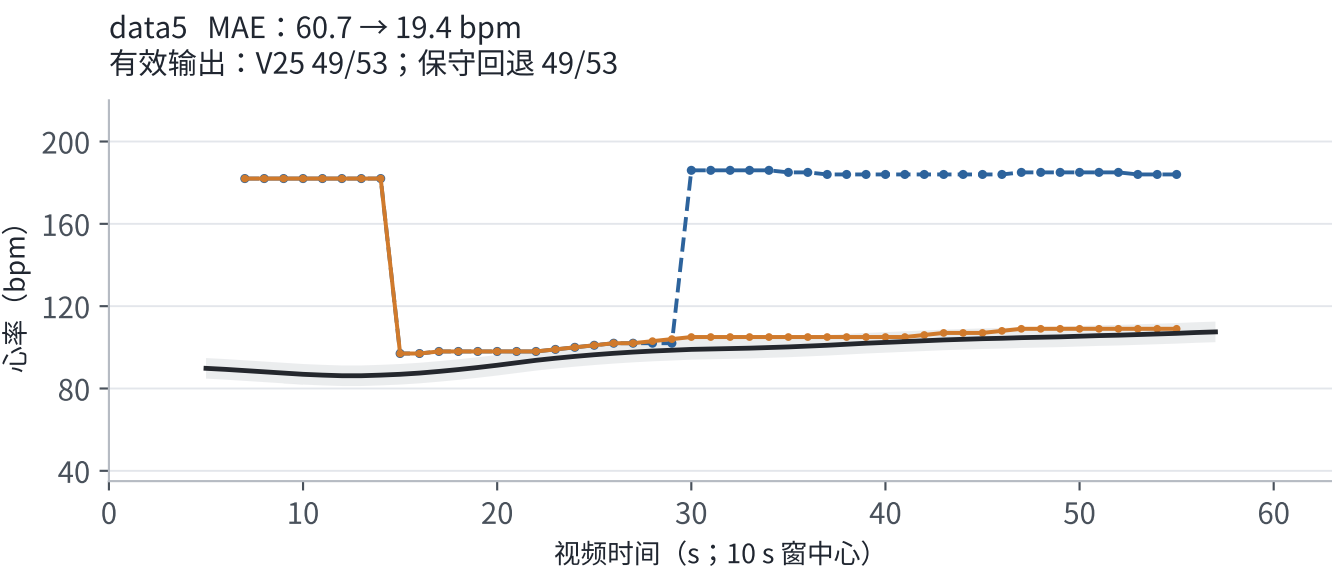
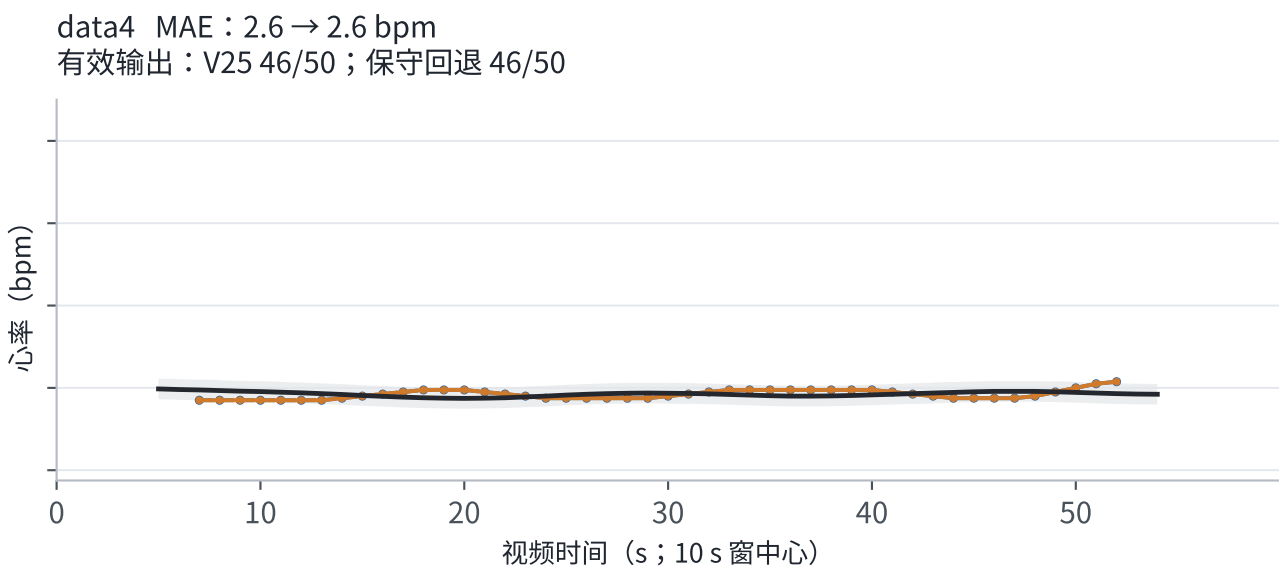
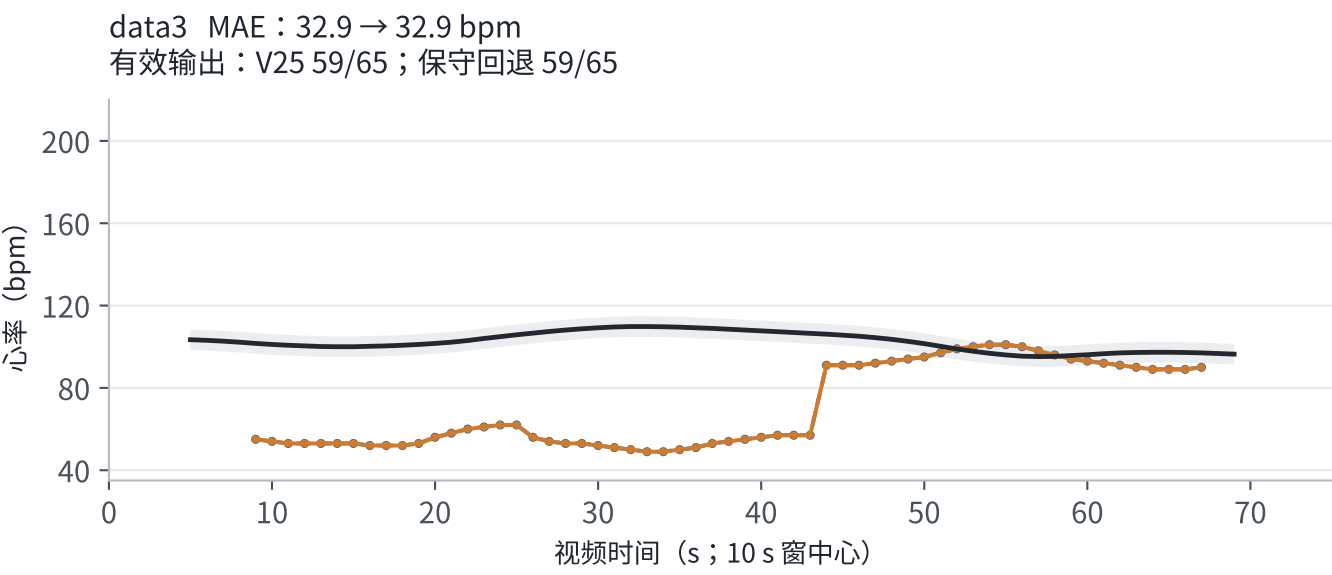
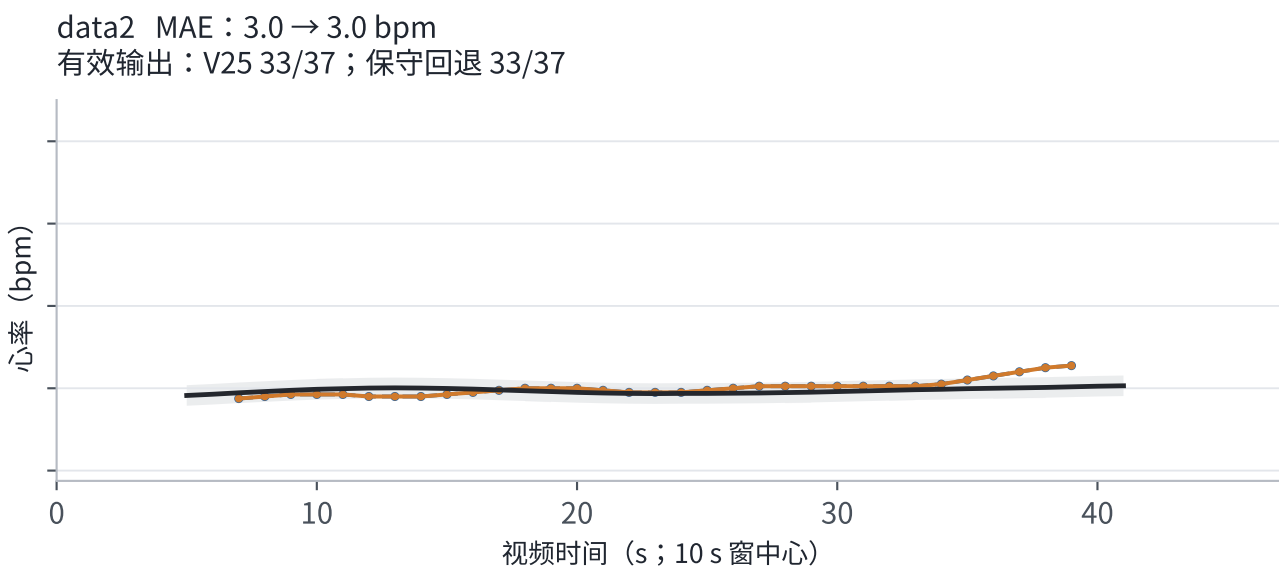


固定对照：V25／保守回退／Polar 设备心率 | 本轮开发汇总

— Polar 设备 HR（固定参考） -.- V25 — 保守回退 候选

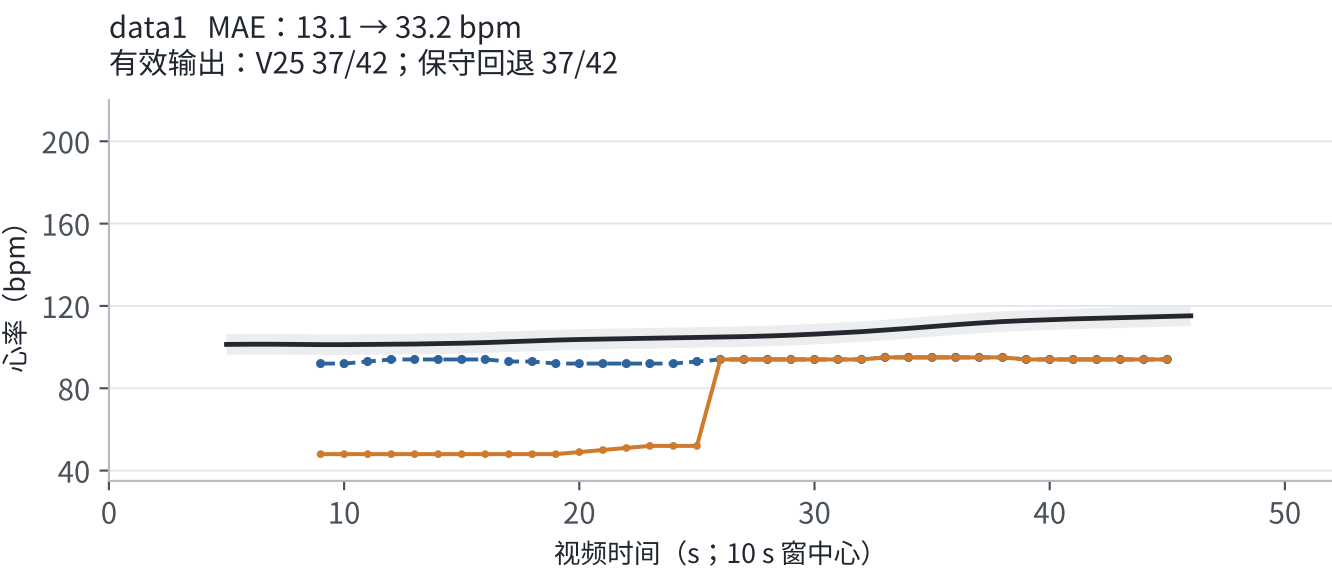

灰带为参考 ± 5 bpm 的误差容限，并非置信区间。缺失预测保持断线；六段使用同一候选。
图中展示不构成升级推荐；参考采用原时间戳估计同步，所有候选均需满足逐片保护条件。