
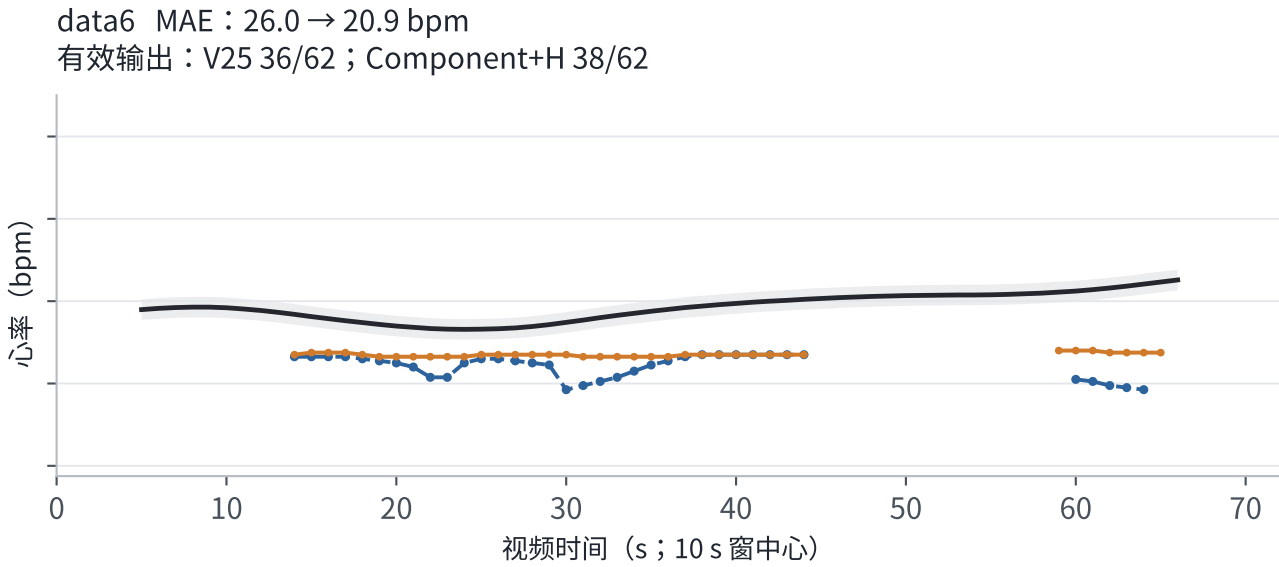
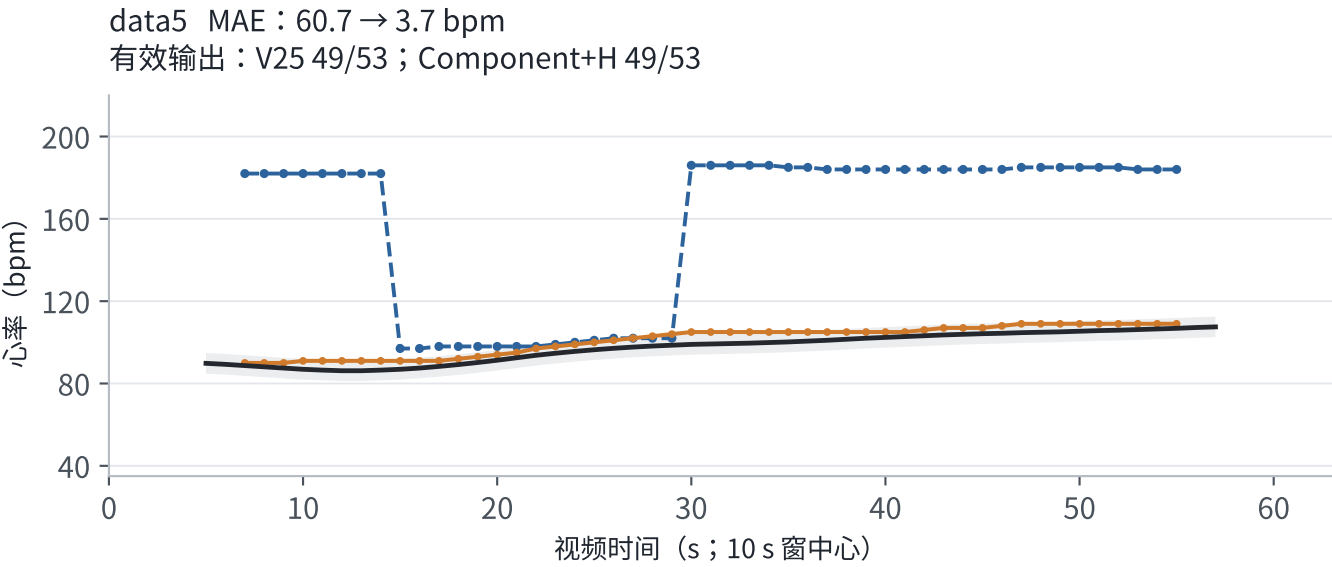
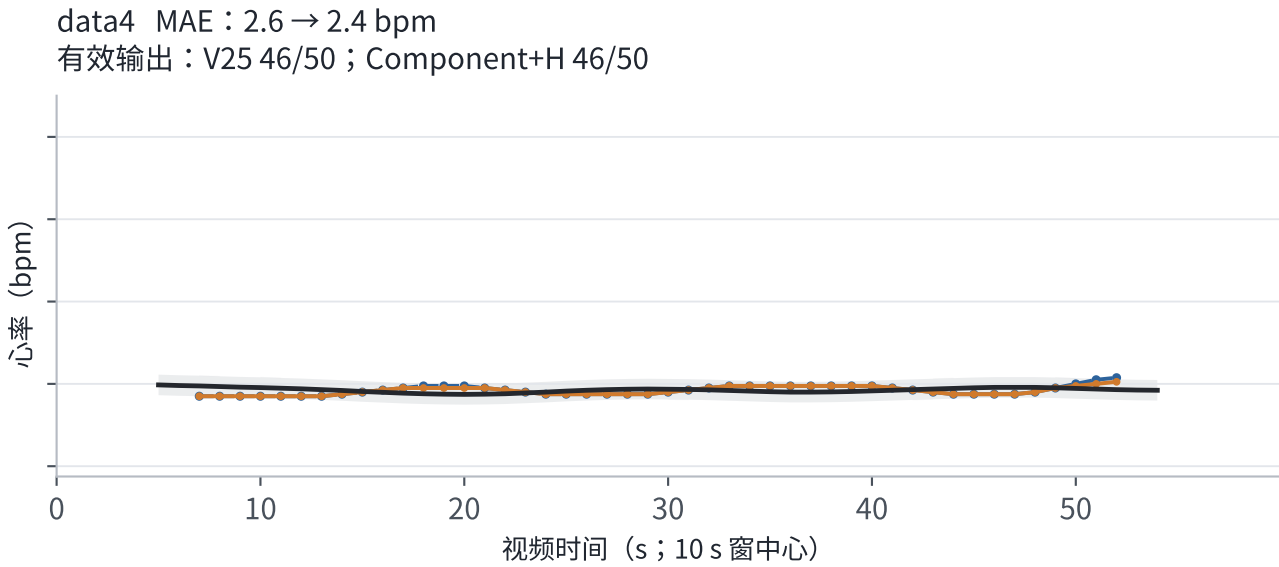
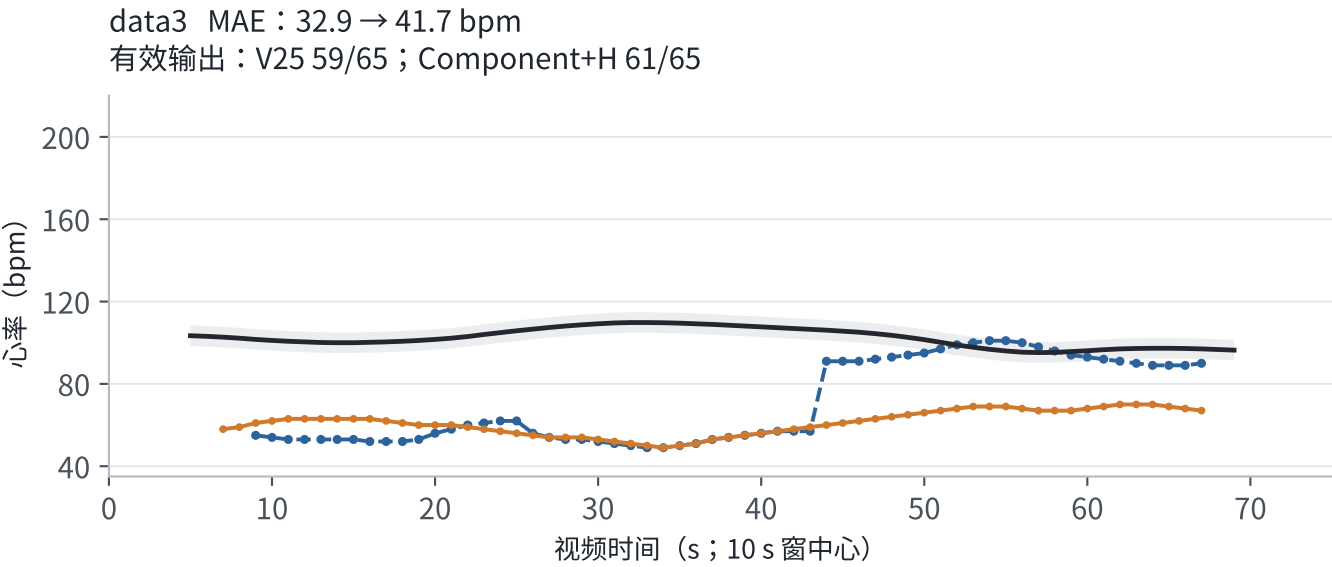
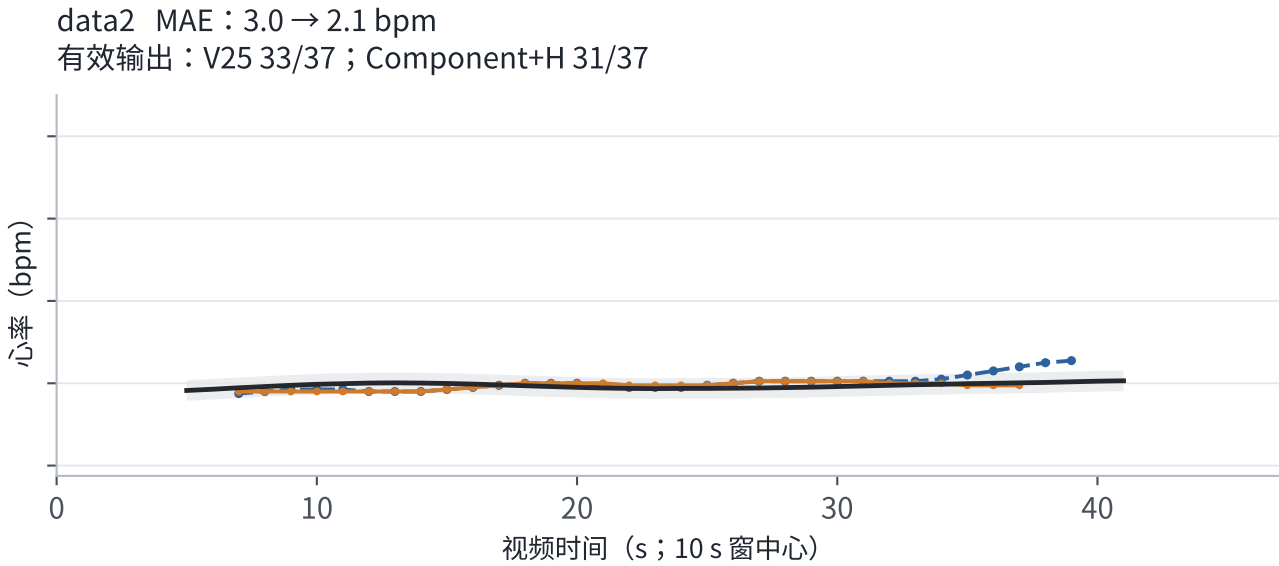


固定对照：V25／Component+H／Polar 设备心率 | 本轮开发汇总

— Polar 设备 HR（固定参考） - - V25 — Component+H 候选

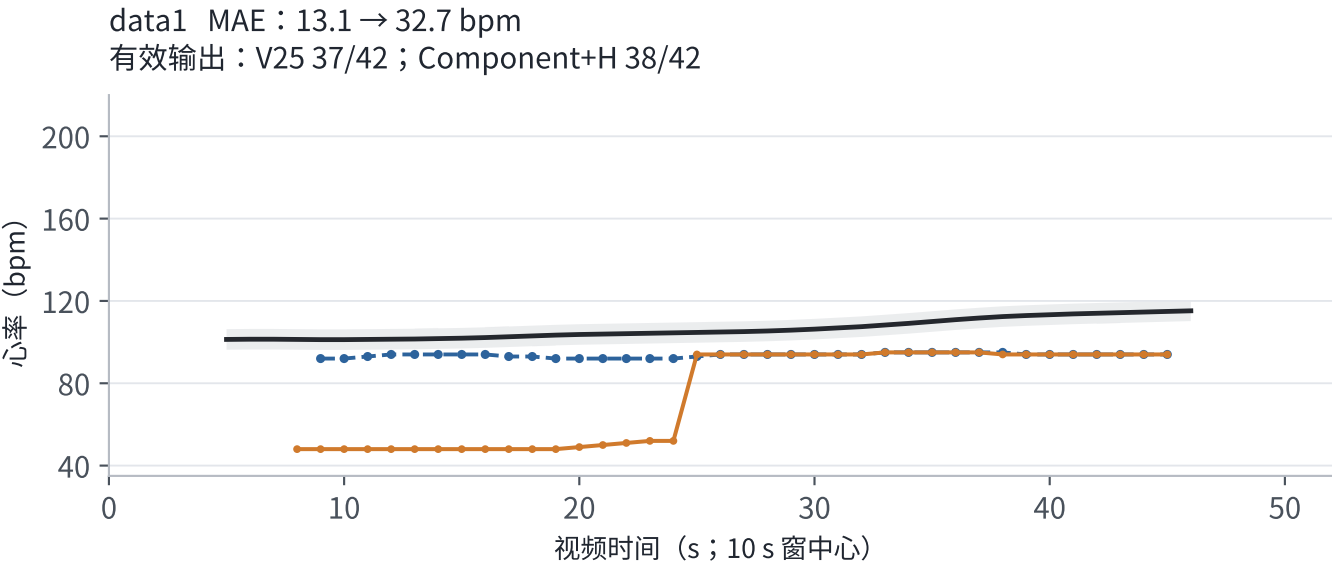

灰带为参考 ±5 bpm 的误差容限，并非置信区间。缺失预测保持断线；没有按视频选最优方法。
参考为 Polar 设备通知均值，采用原文件时间戳估计同步；曲线一致性不等于 ECG 验证或 PPG 形态恢复。