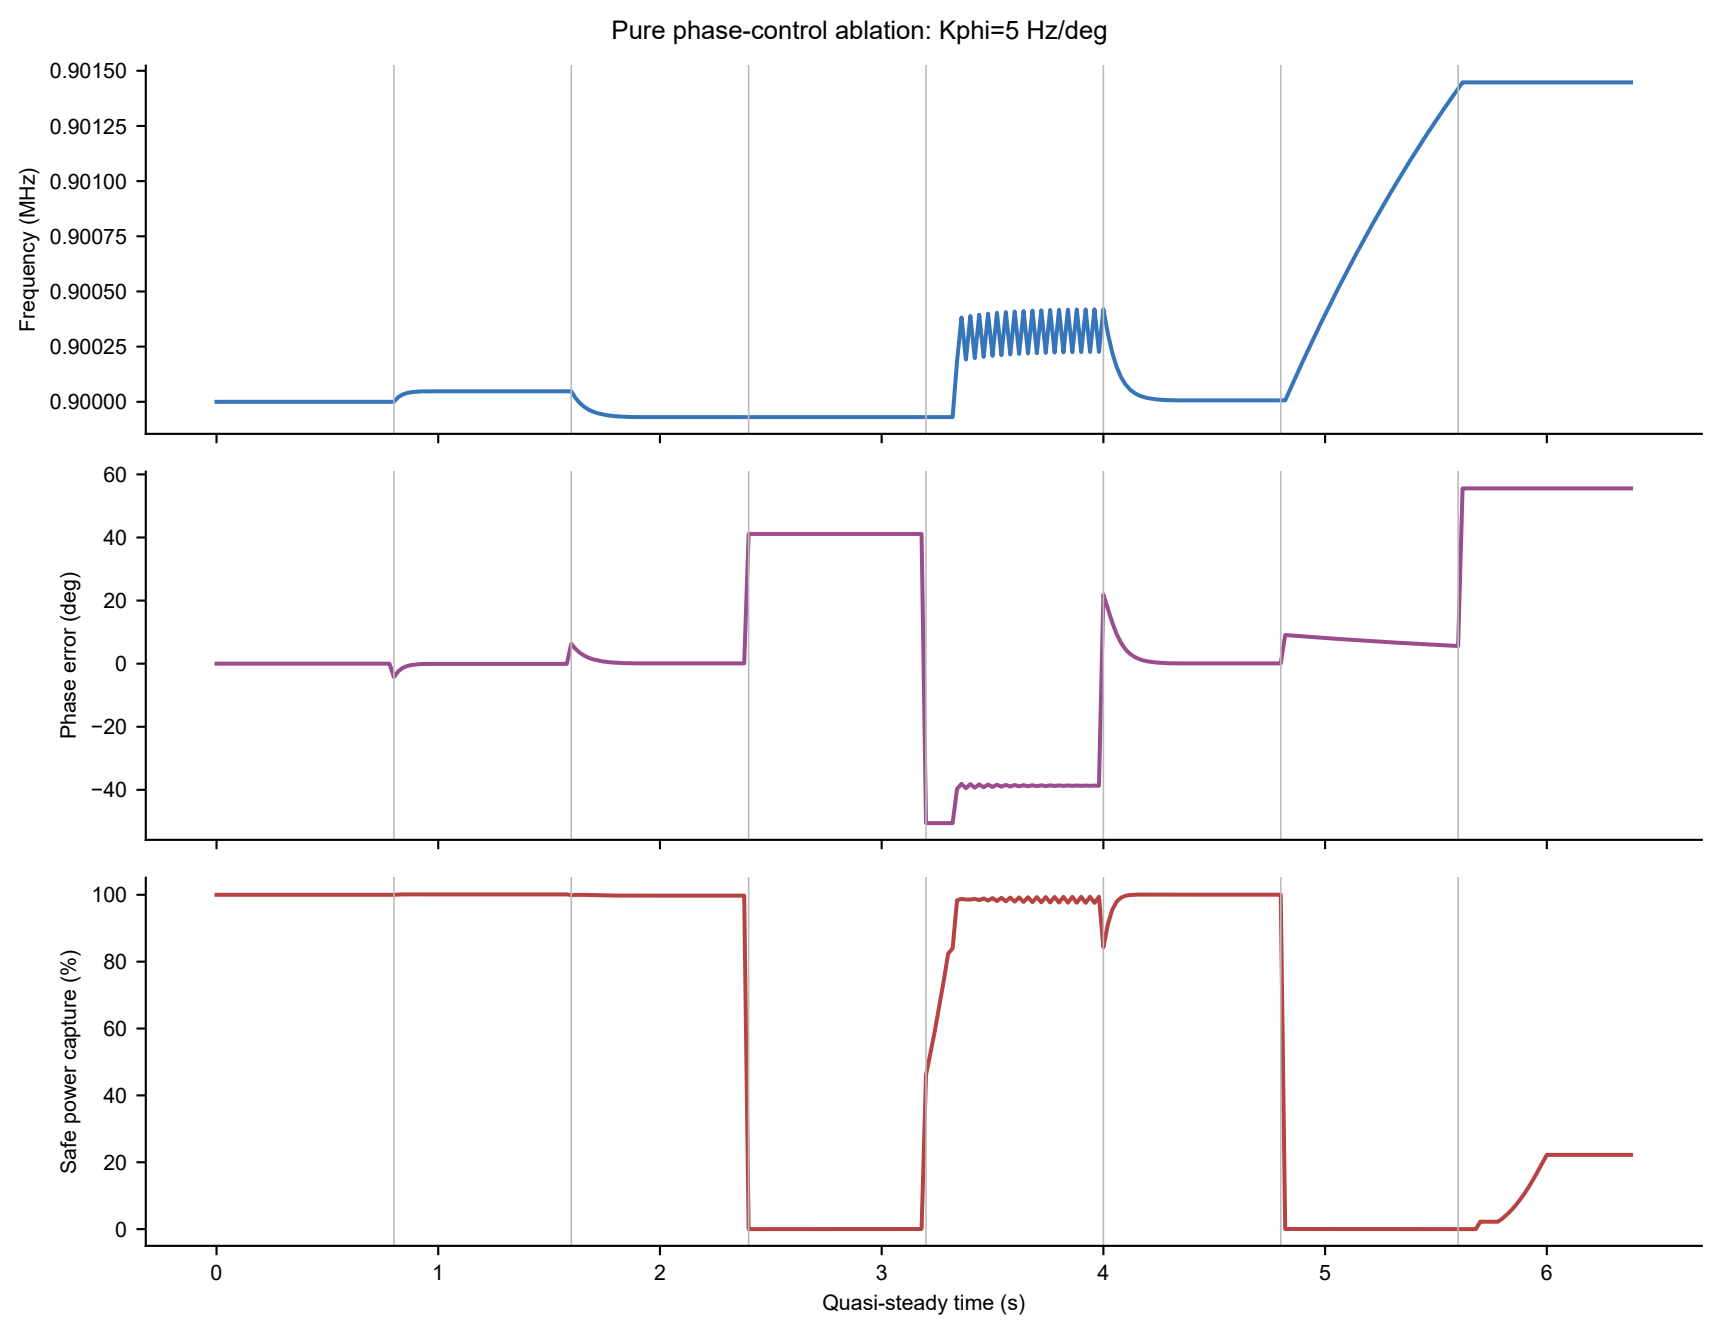
Pure phase-control ablation: Kphi=5 Hz/deg
Frequency (MHz)
0.90150
0.90125
0.90100
0.90075
0.90050
0.90025
0.90000
Phase error (deg)
60
40
20
0
−20
−40
Safe power capture (%)
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
6
Quasi-steady time (s)